


尺寸:2200\*400\*90mm

工艺:1.5mm厚度304不锈钢,刨槽折弯造型箱体烤漆,正面用UV打印信息部分(螺杆与牌面连接处可拆卸翻更换、翻新,内容可单体更换、翻新),中间主题部分双面贴3mm亚克力立体喷漆字;


安装方式:圆管吊杆,内螺杆连接固定,角钢固定件,拉爆与现场混凝土楼板连接。

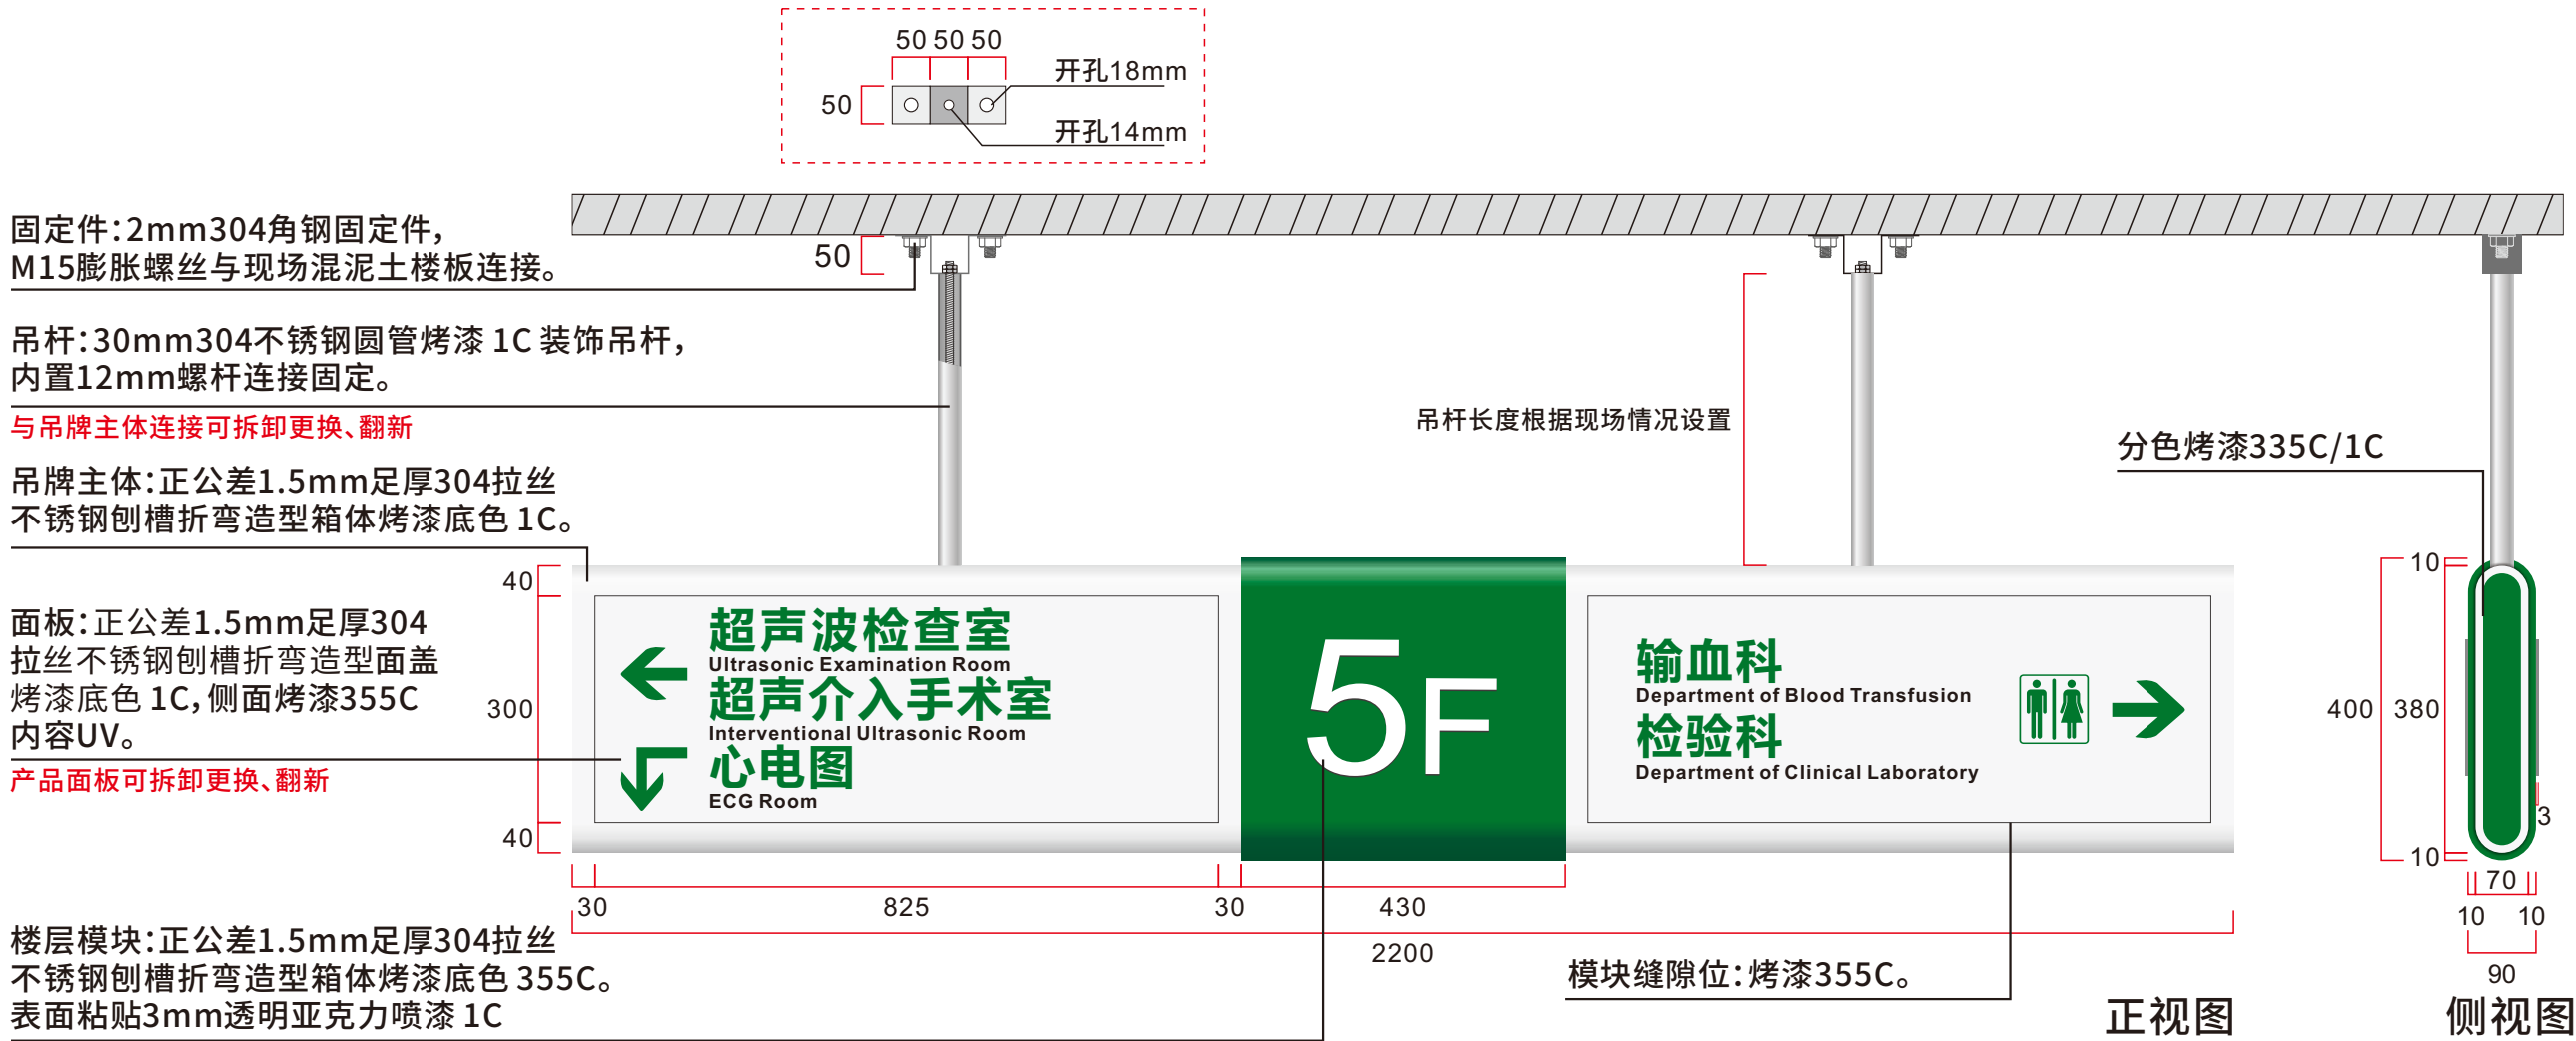

尺寸:1200\*240\*50mm

工艺:1.5mm厚度304不锈钢,刨槽折弯造型箱体烤漆,正面用UV打印信息部分(螺杆与牌面连接处可拆卸,内容不可单体更换、翻新);

**安装方式:**圆管吊杆,内螺杆连接固定,角钢固定件,拉爆与现场混凝土楼板连接。

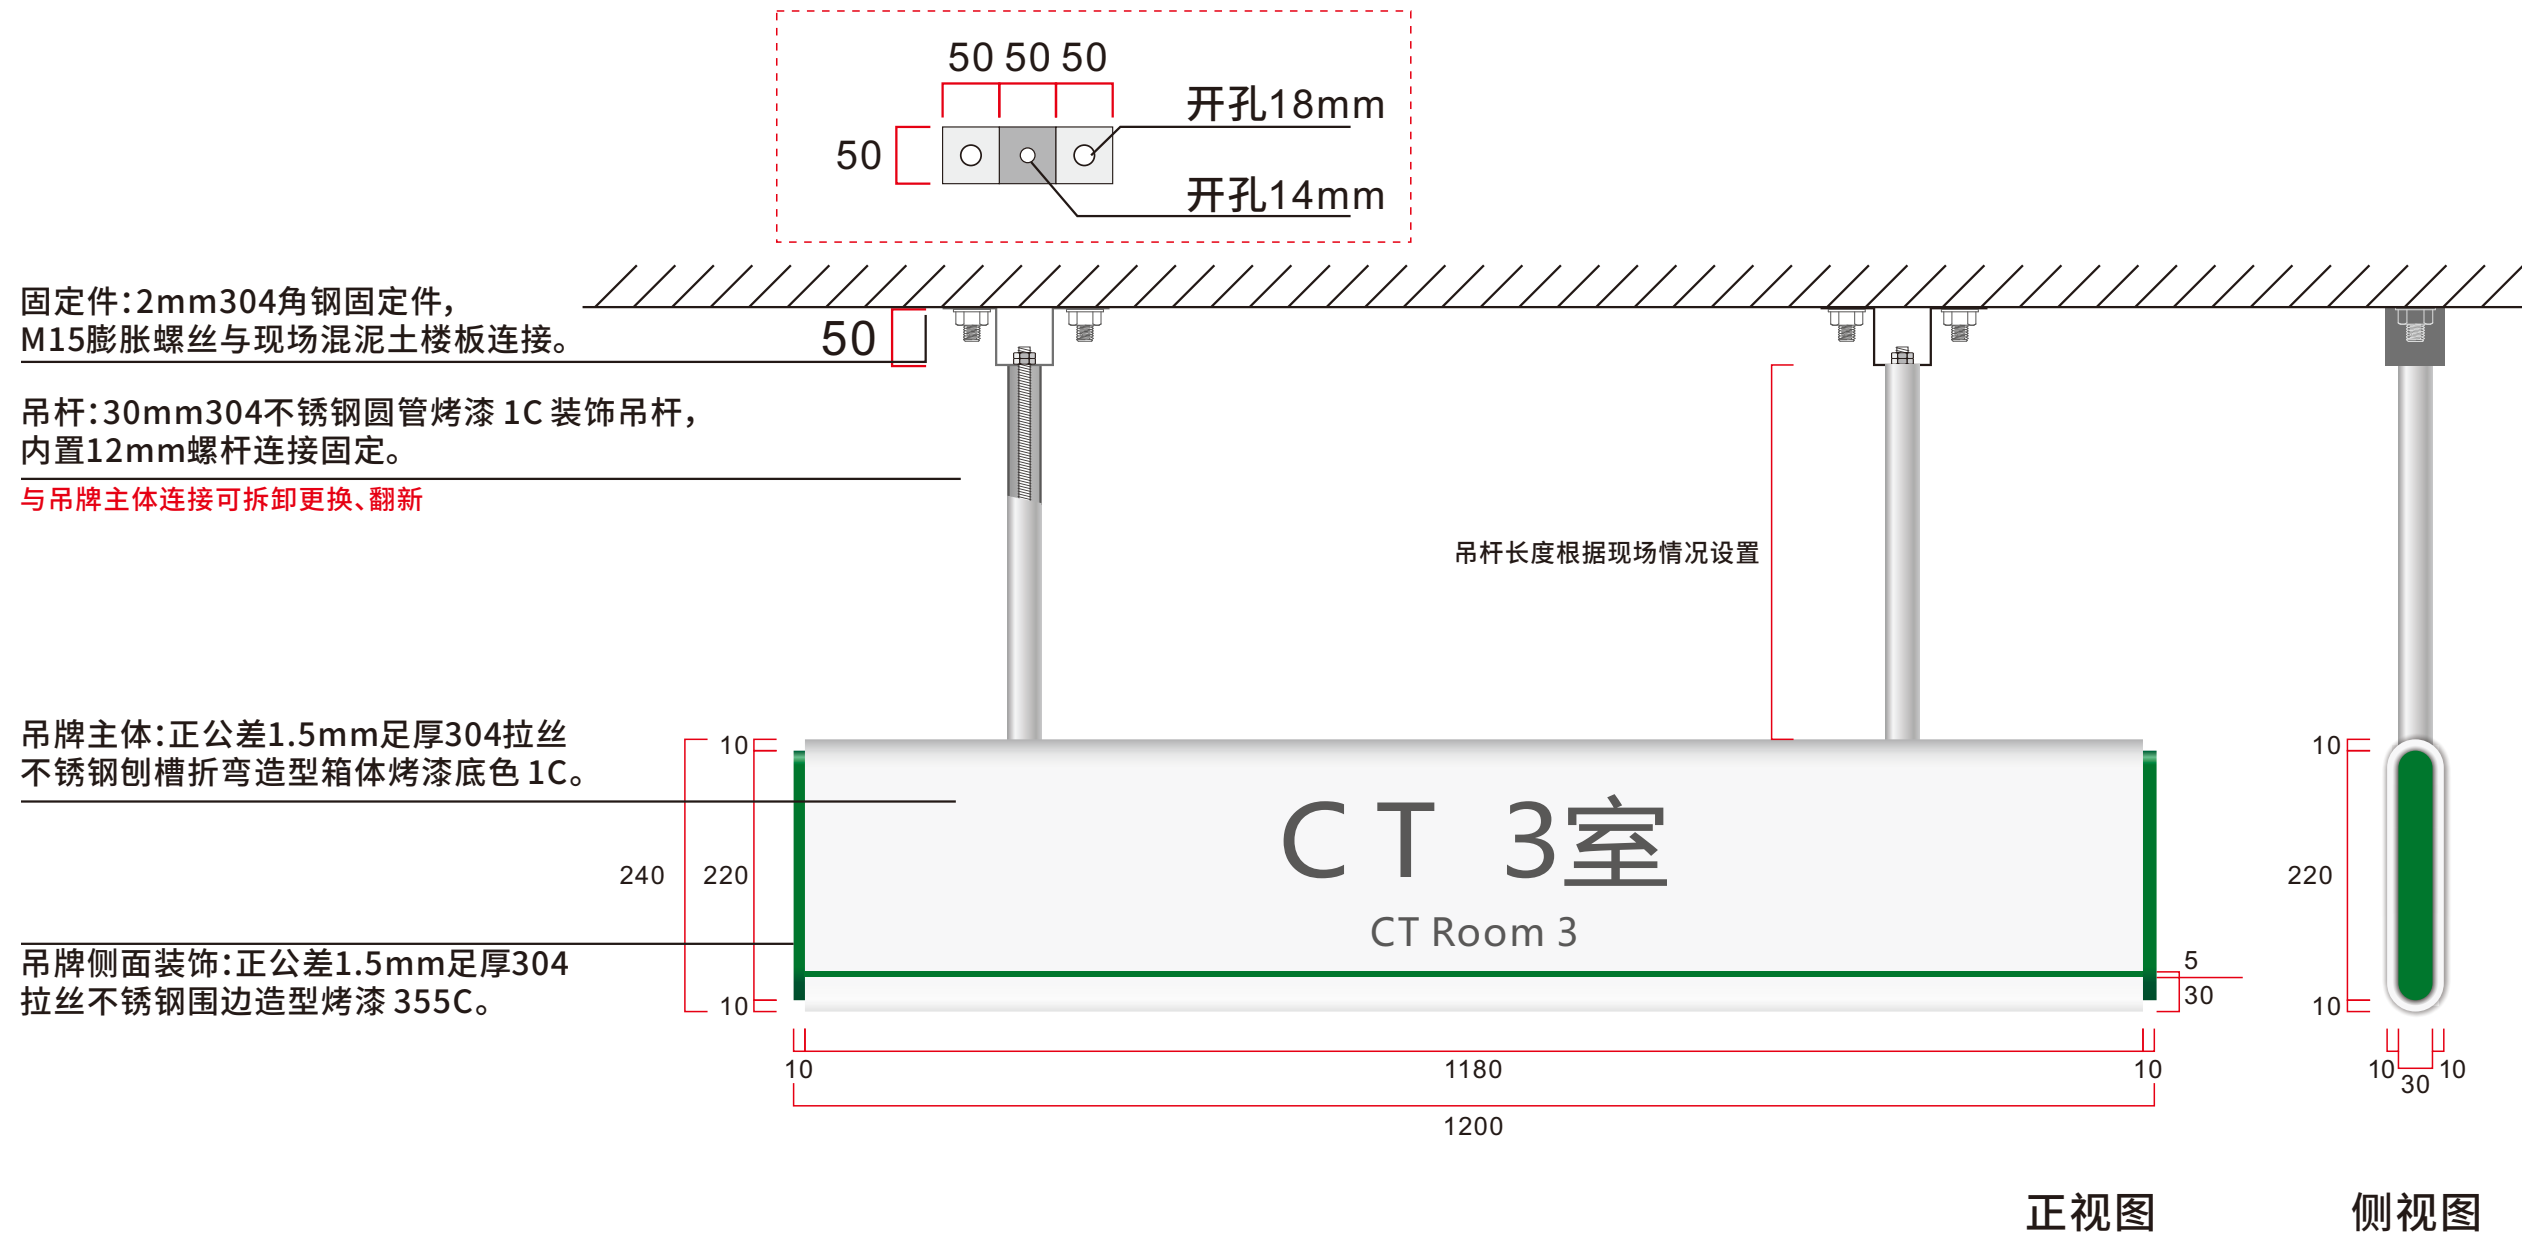

单位:mm

**出图日期**

## 设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:450\*200\*20mm  
 产品工艺:1.2mm厚度304不锈钢,刨槽折弯造型箱体,所有表面烤漆,正面UV打印信息部分(或有机造型卡槽,可更换水条打印信息),  
 房号5mm立体喷漆字;牌面:内有机造型卡槽,面有机激光雕刻镂空,热弯造型烤漆,PVC水条UV打印信息;  
 安装方式:反面葫芦孔挂装,两边透明玻璃胶封边。

- 5mm瓷白亚克力激光切割粘贴在底板上。
- 1.2mm不锈钢折弯焊接,烤漆355C。
- 底纹UV 349C(参考以往标准)
- 病床信息内容UV 白色
- 3mm透明亚克力激光切割热弯弧面,表面烤漆 1C,文字UV355C。
- 可替换信息牌 (110\*30\*1mm)  
材质:1mm透明亚克力背面UV
- 内部用2mm亚克力做中间层,底板用5mm瓷白板做底层。
- 信息内容UV 355C

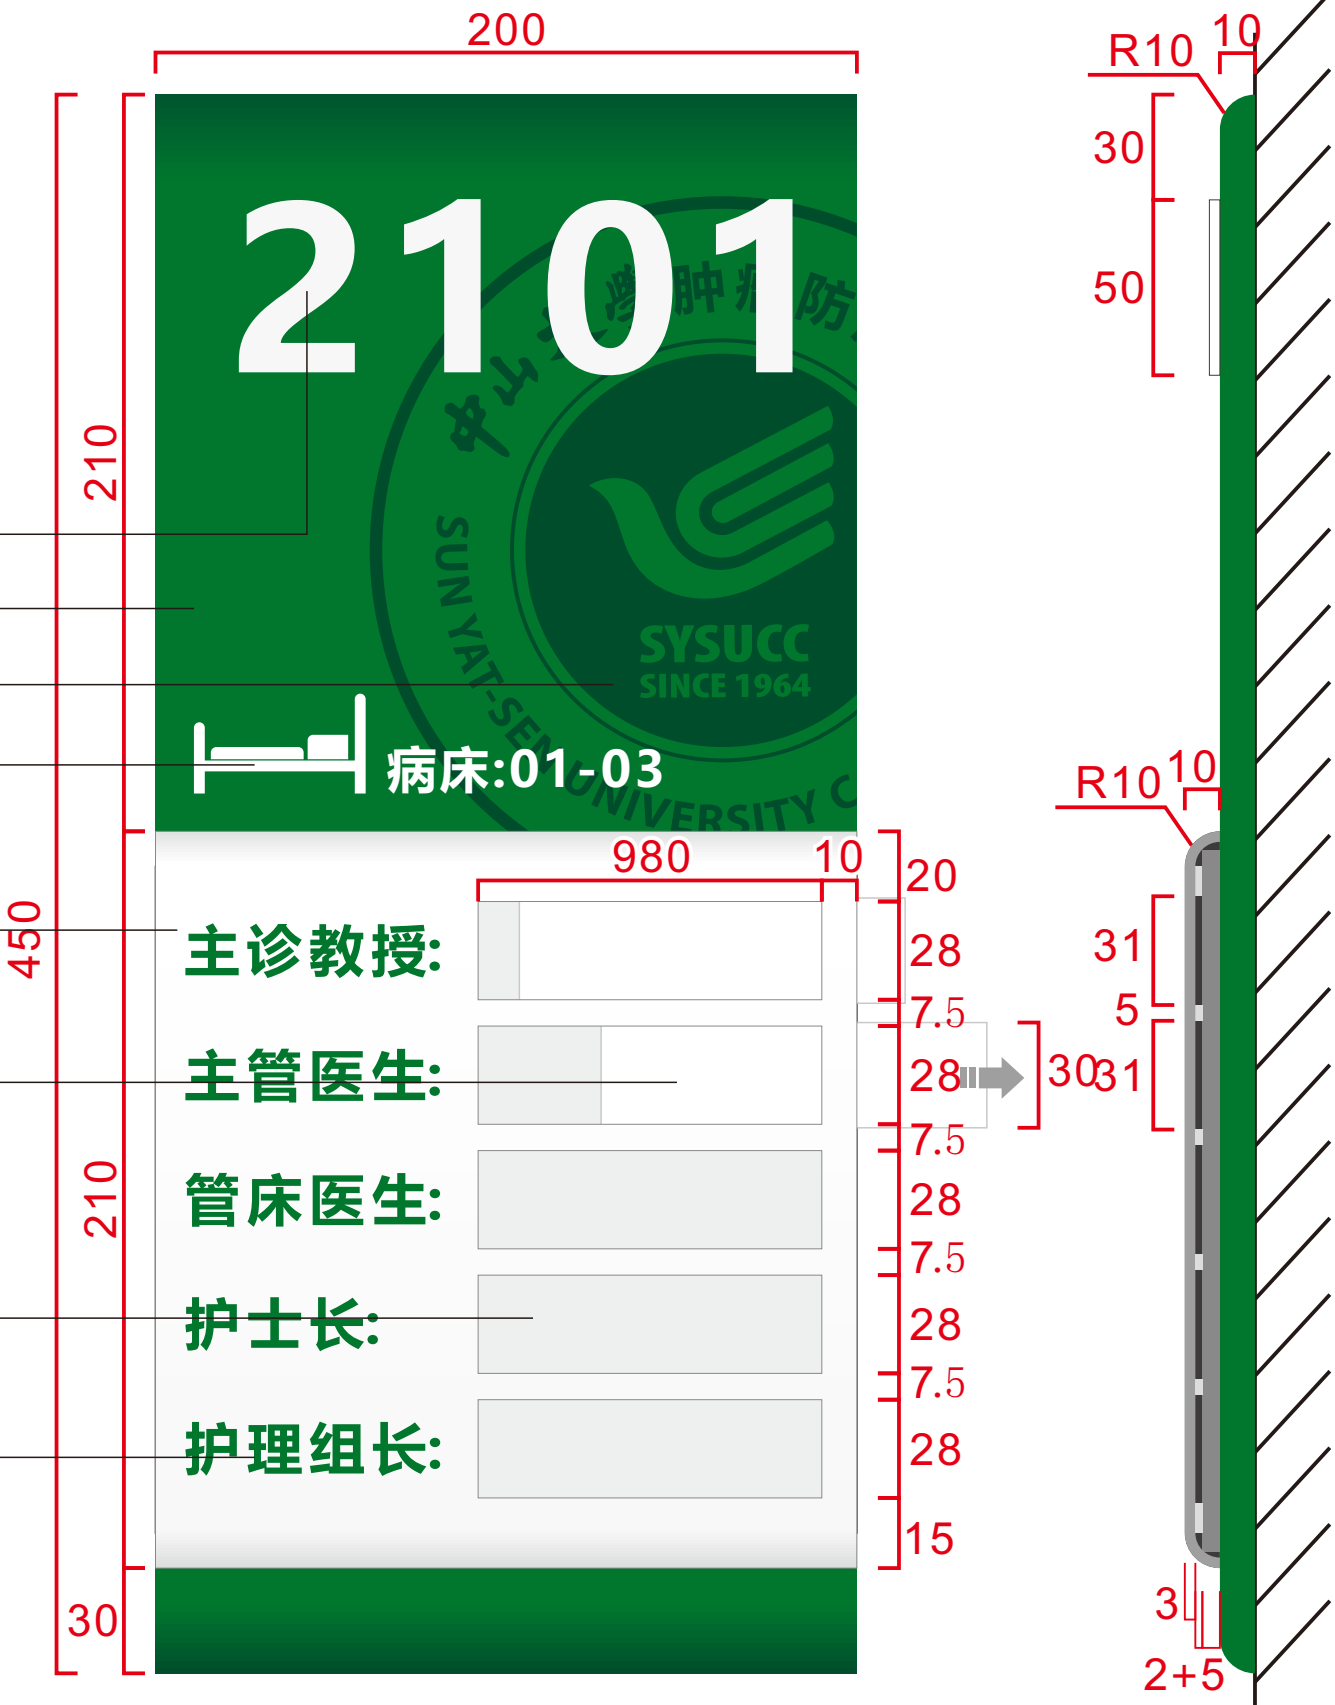

标识设计·方案

制作单号

A3

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

病房门牌

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

  
SYSUCC  
SINCE 1964  
中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center



尺寸:1450\*600\*20mm  
 产品工艺:1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体,所有表面烤漆,正面UV打印信息部分(或有机造型卡槽,可更换水条打印信息),  
 楼层号5mm立体喷漆字;牌面:内有机造型卡槽,面有机激光雕刻镂空,热弯造型烤漆,PVC水条UV打印信息;  
 安装方式:反面葫芦孔挂装,两边透明玻璃胶封边。

1.2mm不锈钢折弯焊接做葫芦孔,  
 烤漆355C。


5mm瓷白亚克力激光切割粘贴在底板上。

信息内容UV 1C ,底纹UV 349C。

5mm透明亚克力激光切割热弯弧面,  
 表面烤漆1C。

可替换信息牌(285\*33\*2mm)  
 材质:2mm透明亚克力背面UV内容文字80K,底色UV 1C。

内部用3mm亚克力做中间层,  
 底板用2mm瓷白板做底层。

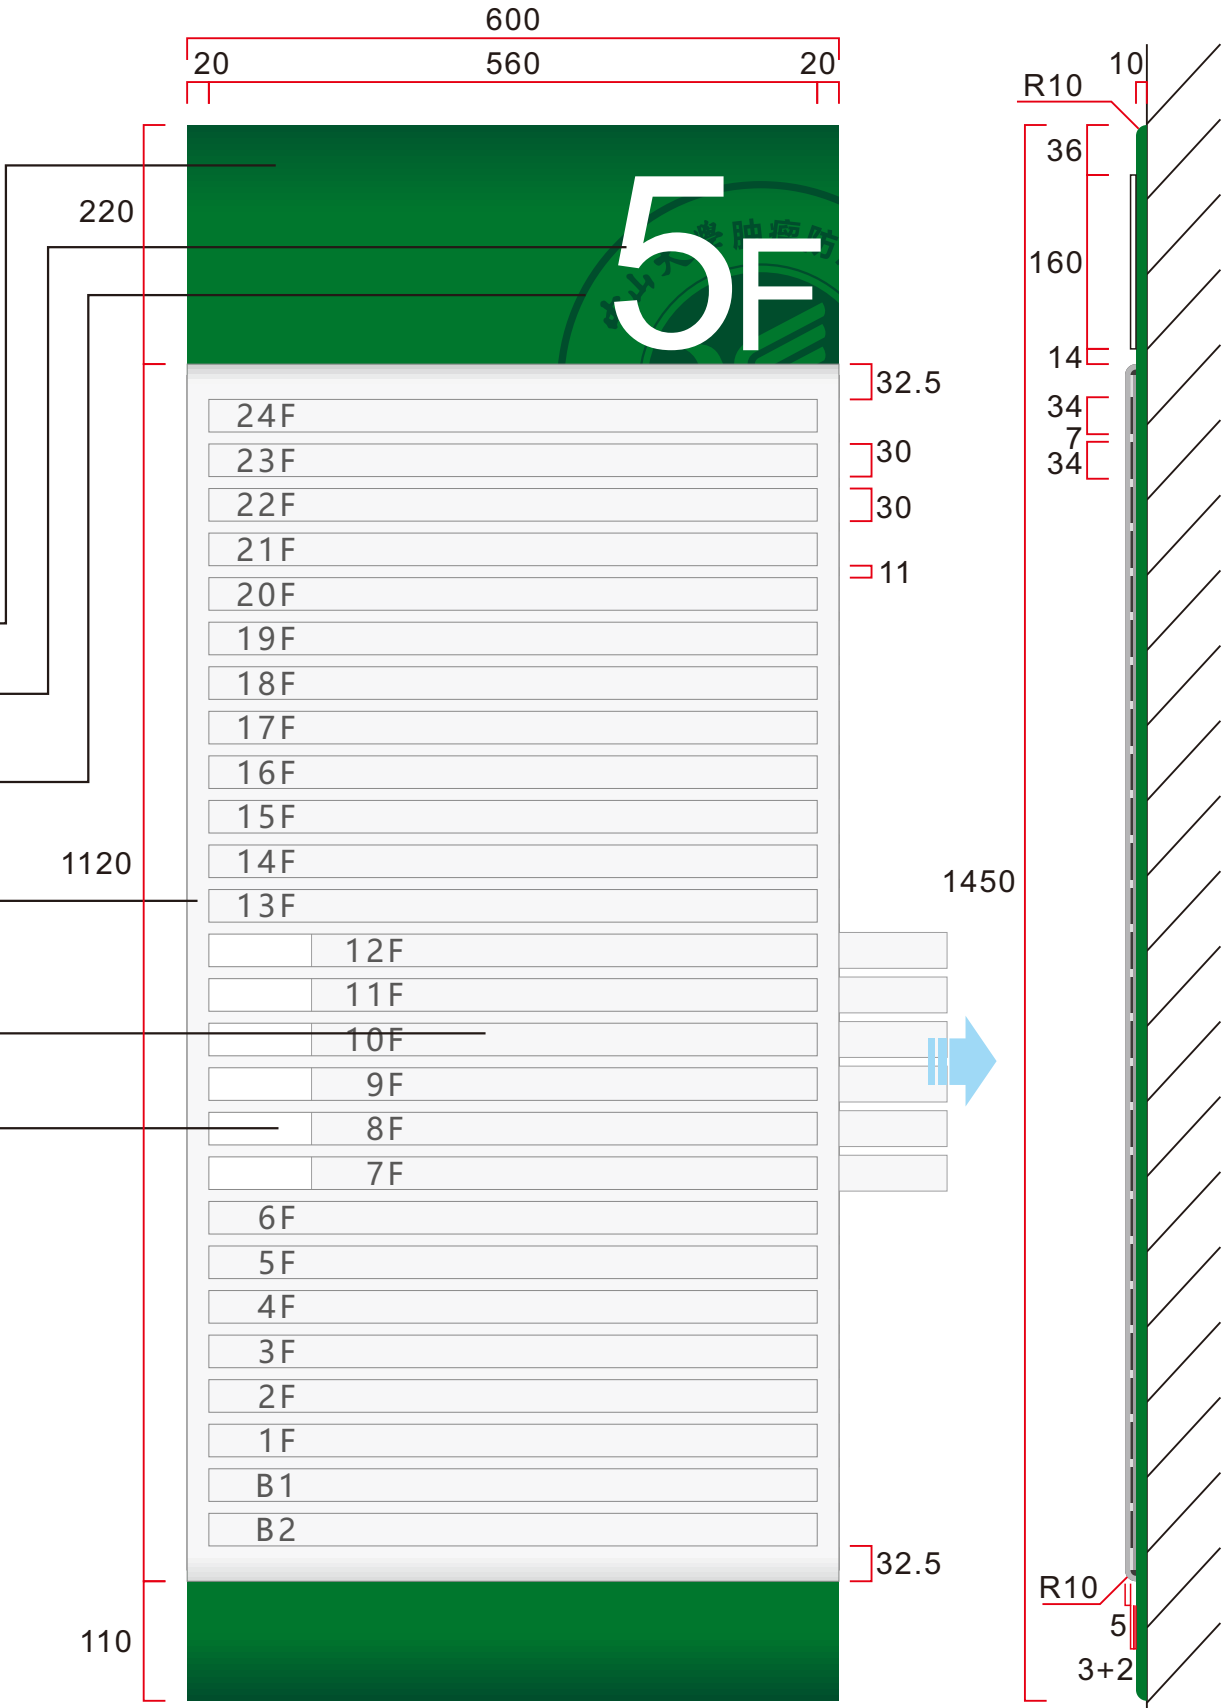

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

标识设计·方案

制作单号

A5

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

电梯、步梯楼层总索引

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

  
中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:380\*120\*10mm  
工艺:1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体, 烤漆, 正面UV打印信息部分;  
安装方式:葫芦孔挂装或双面胶及玻璃胶组合粘贴。

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

普通办公室门牌

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

1.2mm不锈钢折弯焊接, 烤漆1C

文字内容UV 80K

5mm亚克力激光切割粘贴在2侧

分色烤漆355C

UV 355C

黄埔院区管理办公室  
Management Office of Huangpu Campus

R10

6

2

21

10

370

380

5

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:630\*550\*20mm  
工艺:1.2mm厚度304不锈钢创槽折弯造型箱体, 烤漆, 正面UV打印信息部分;  
安装方式:葫芦孔挂装。





尺寸:900\*200\*11.6mm

工艺:1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体,所有表面烤漆,绿色区域面贴5mm立体喷漆字(或箭头),烤漆;牌面:2mm铝板折弯

造型,烤漆,正面UV打印信息部分;


安装方式:葫芦孔挂装,两边透明玻璃胶封边。

面板:正公差1.2mm足厚304  
拉丝不锈钢刨槽造型烤漆,烤  
漆1C表面涂层厚度≥40微米,  
三涂三烤后作烘干处理。

信息内容正面UV打印。

背面做葫芦孔挂码,高度平齐  
亚克力表面

面贴5mm立体喷漆字(或箭头)

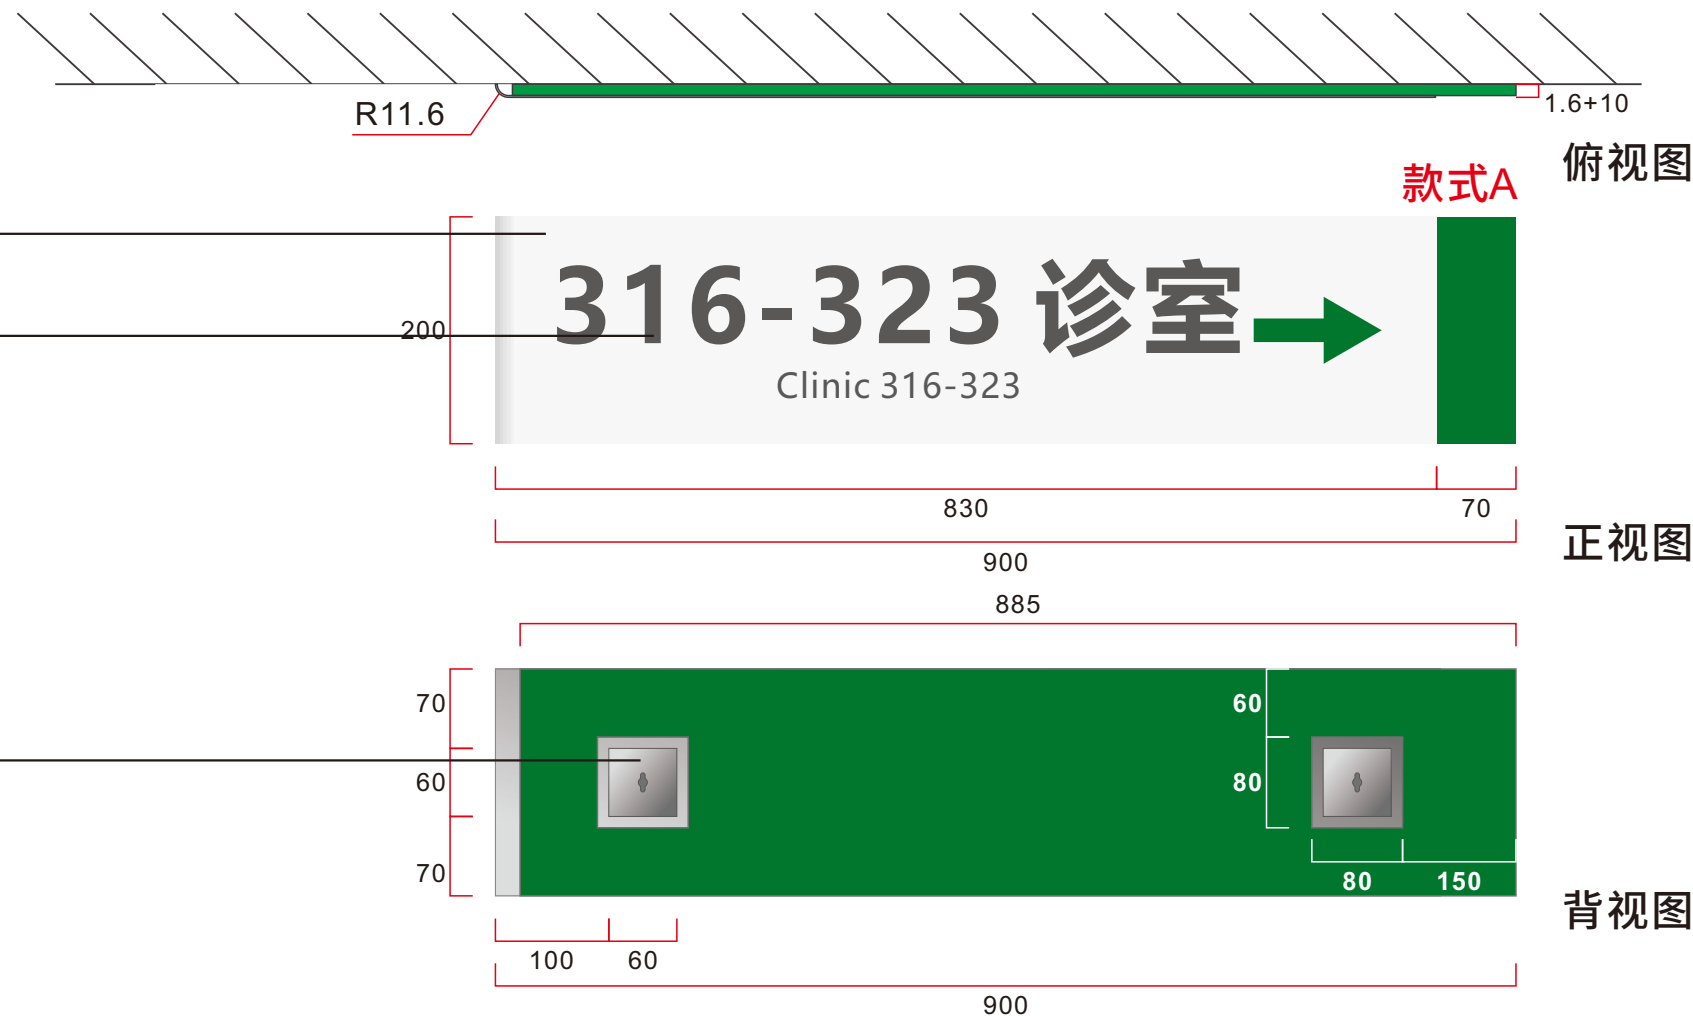

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期

尺寸:D=120mm正三角形, 高度380mm

工艺:采用5mm透明亚克力热弯成盒子表面分色喷漆355C;

上下用。正面UV打印信息部分。

安装:背面开葫芦孔, 现场挂装。四周玻璃胶封边。

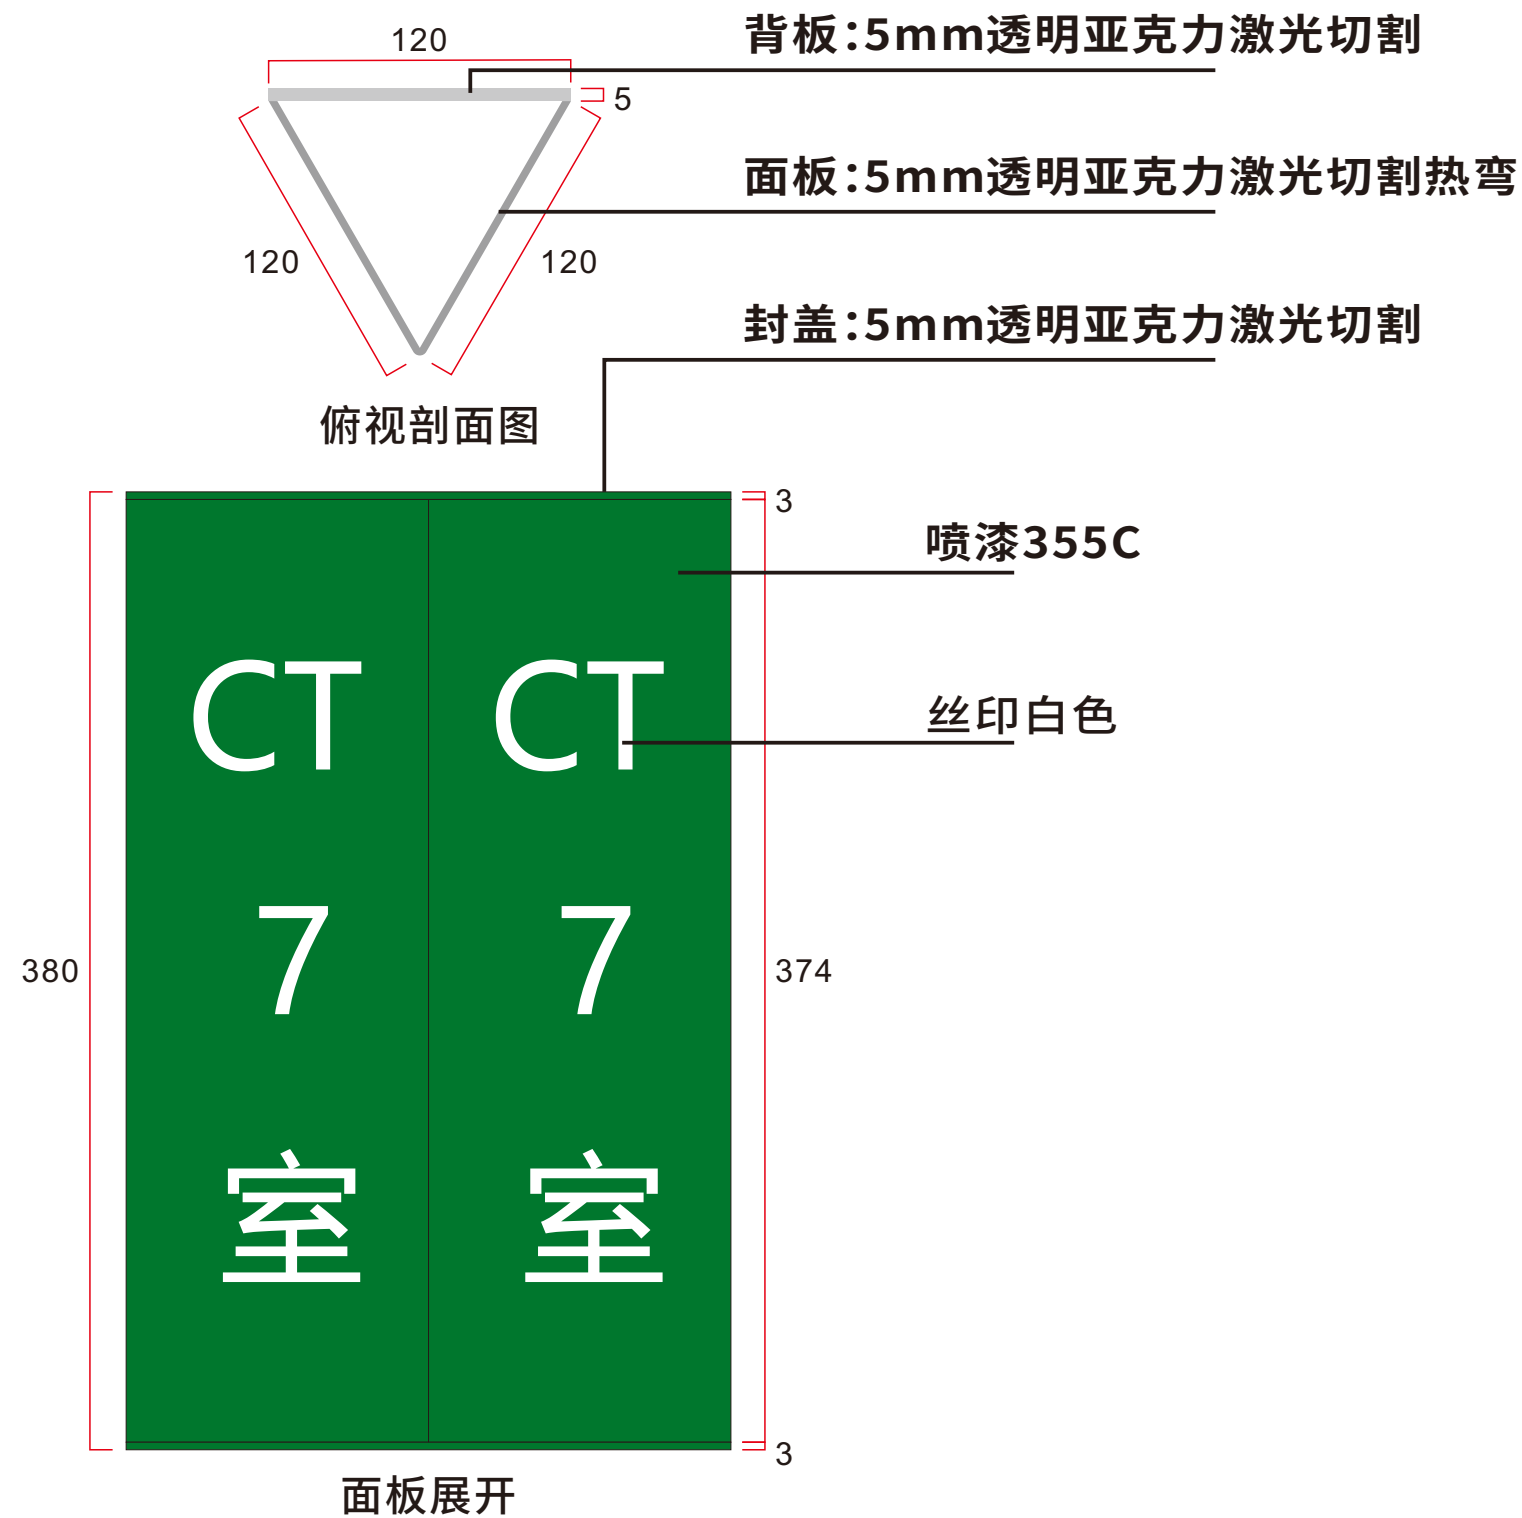

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:D=120mm正三角形,高度380mm

工艺:采用5mm透明亚克力热弯成盒子表面分色喷漆355C、白色;


正面用3mm瓷白亚克力激光切割图形符号粘贴。正面UV打印信息部分。

安装:背面PVC板垫平,现场免钉胶固定安装。四周玻璃胶封边。

背板:10mmPVC板表面粘贴LED发光模组,侧面上螺丝固定

面板:5mm透明亚克力激光切割热弯


封盖:5mm透明亚克力激光切割

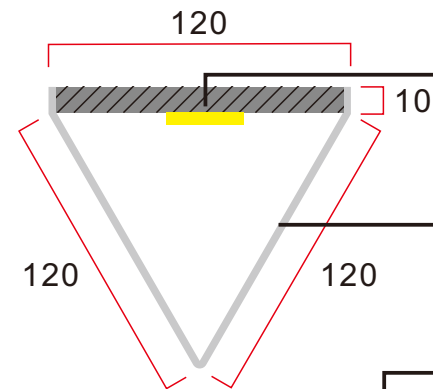

俯视图剖面图

喷漆355C

白色即时贴粘贴  
喷漆后揭开,  
夜晚发白光

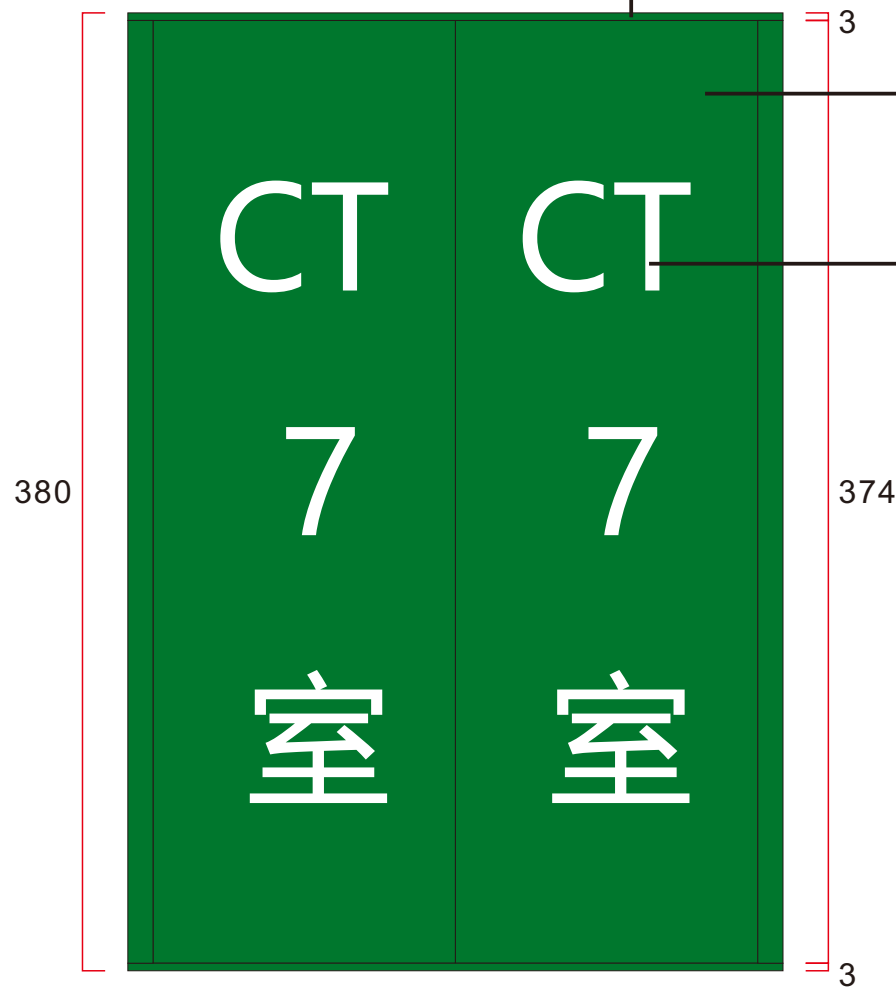

面板展开



日间效果



夜间效果

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核


分管院长审核

完工日期




SYSUCC  
SINCE 1964  
中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:400\*560mm  
工艺:面板5mm透明亚克力激光切割磨2mm斜边抛光。中间夹户外写真光膜。  
底板3mm透明亚克力。距边30mm开直径11.4mm孔  
安装:配d16广告钉,附墙安装。

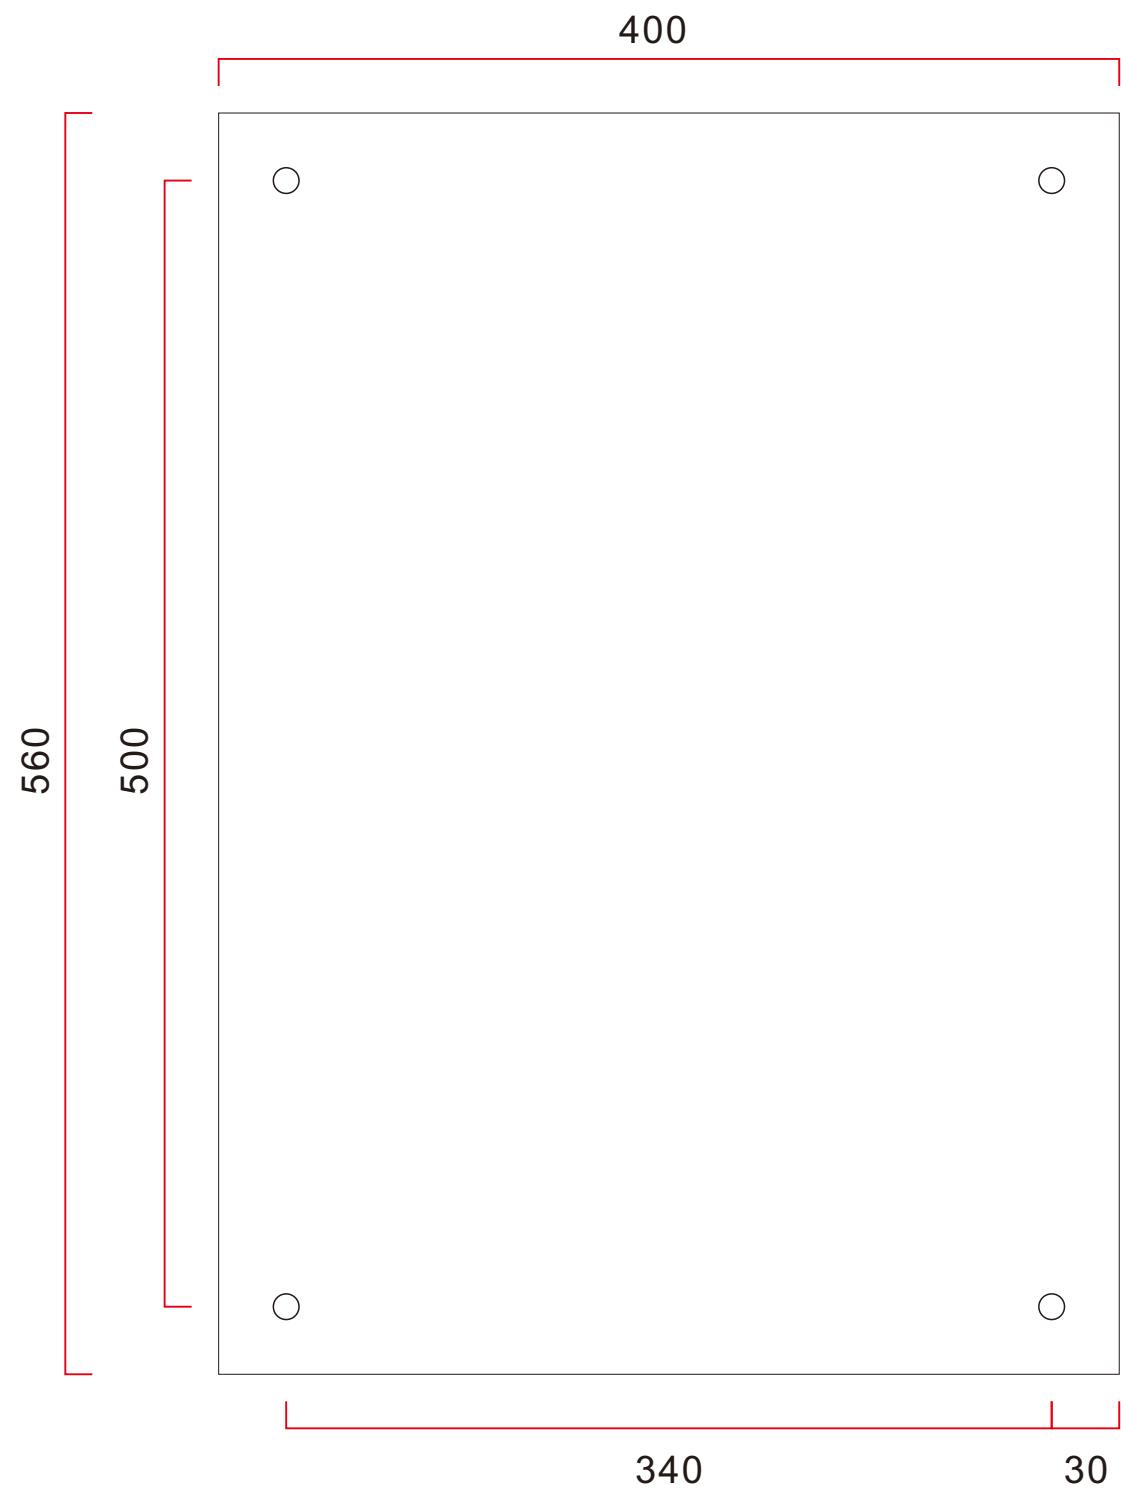

正视图

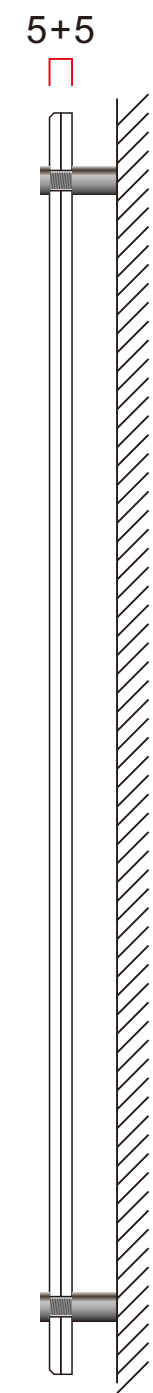

右视图

| 标识设计·方案 |              |
|---------|--------------|
| 制作单号    | A11          |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称    | 亚克力夹画类产品     |
| 工序负责    | 结构设计         |
| 外加工     |              |
| 五金      |              |
| 喷漆      |              |
| 标识 A    | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印      |              |
| 标识 B    | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源     |              |
| 合同项目    |              |
| 产品单价    |              |
| 产品数量    |              |
| 产品总价    |              |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

尺寸:700\*600mm


工艺:1.2mm厚度304不锈钢结构,刨槽造型箱体,所有表面烤漆,烤漆,UV打印信息

部分,箱体面贴透明有机盒(数量根据需求指定);

**安装方式:**反面两个葫芦孔挂装,两边透明玻璃胶封边。

尺寸:38\*70mm

工艺:1mm透明亚克力激光切割正反面喷漆

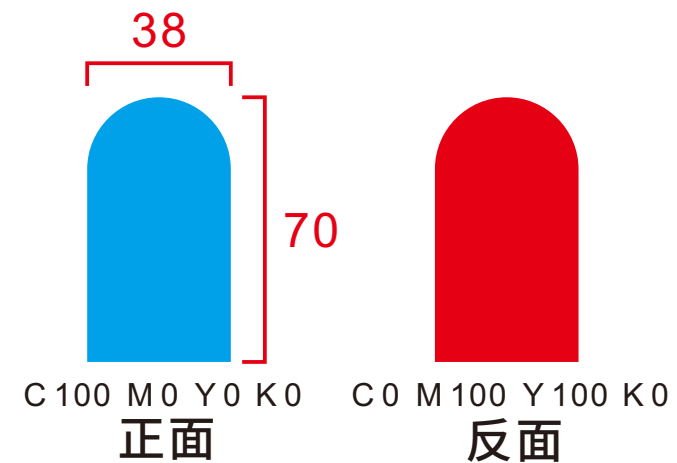

面板:用正公差1.2mm足厚 304拉丝不锈钢围边造型烤漆,烤漆表面涂层厚度 $\geq 40$ 微米,三涂三烤后作烘干处理;信息内容部分正面UV。

447C  
355C

355C

1mm透明亚克力激光  
切割正反面喷漆(见右)

亚克力激光粘贴在表面  
面层:2mm透明亚克力  
中间层:3mm透明亚克力  
底层:1mm瓷白亚克力

背架：  
采用30\*20mm #304不锈钢方管结构

单位:mm

**出图日期**

## 设计

使用科室审核

主管科室审核


主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:2440\*1250mm  
工艺:1.5mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型烤漆底盒,UV打印标题部分;箱体:1.5mm电解板烤漆底板,烤漆,框边内不锈钢支架,  
面不锈钢刨槽造型烤漆,8mm钢化青波饰面,箱体左右两侧内置气压顶;  
安装方式:拉爆与现场墙体固定。

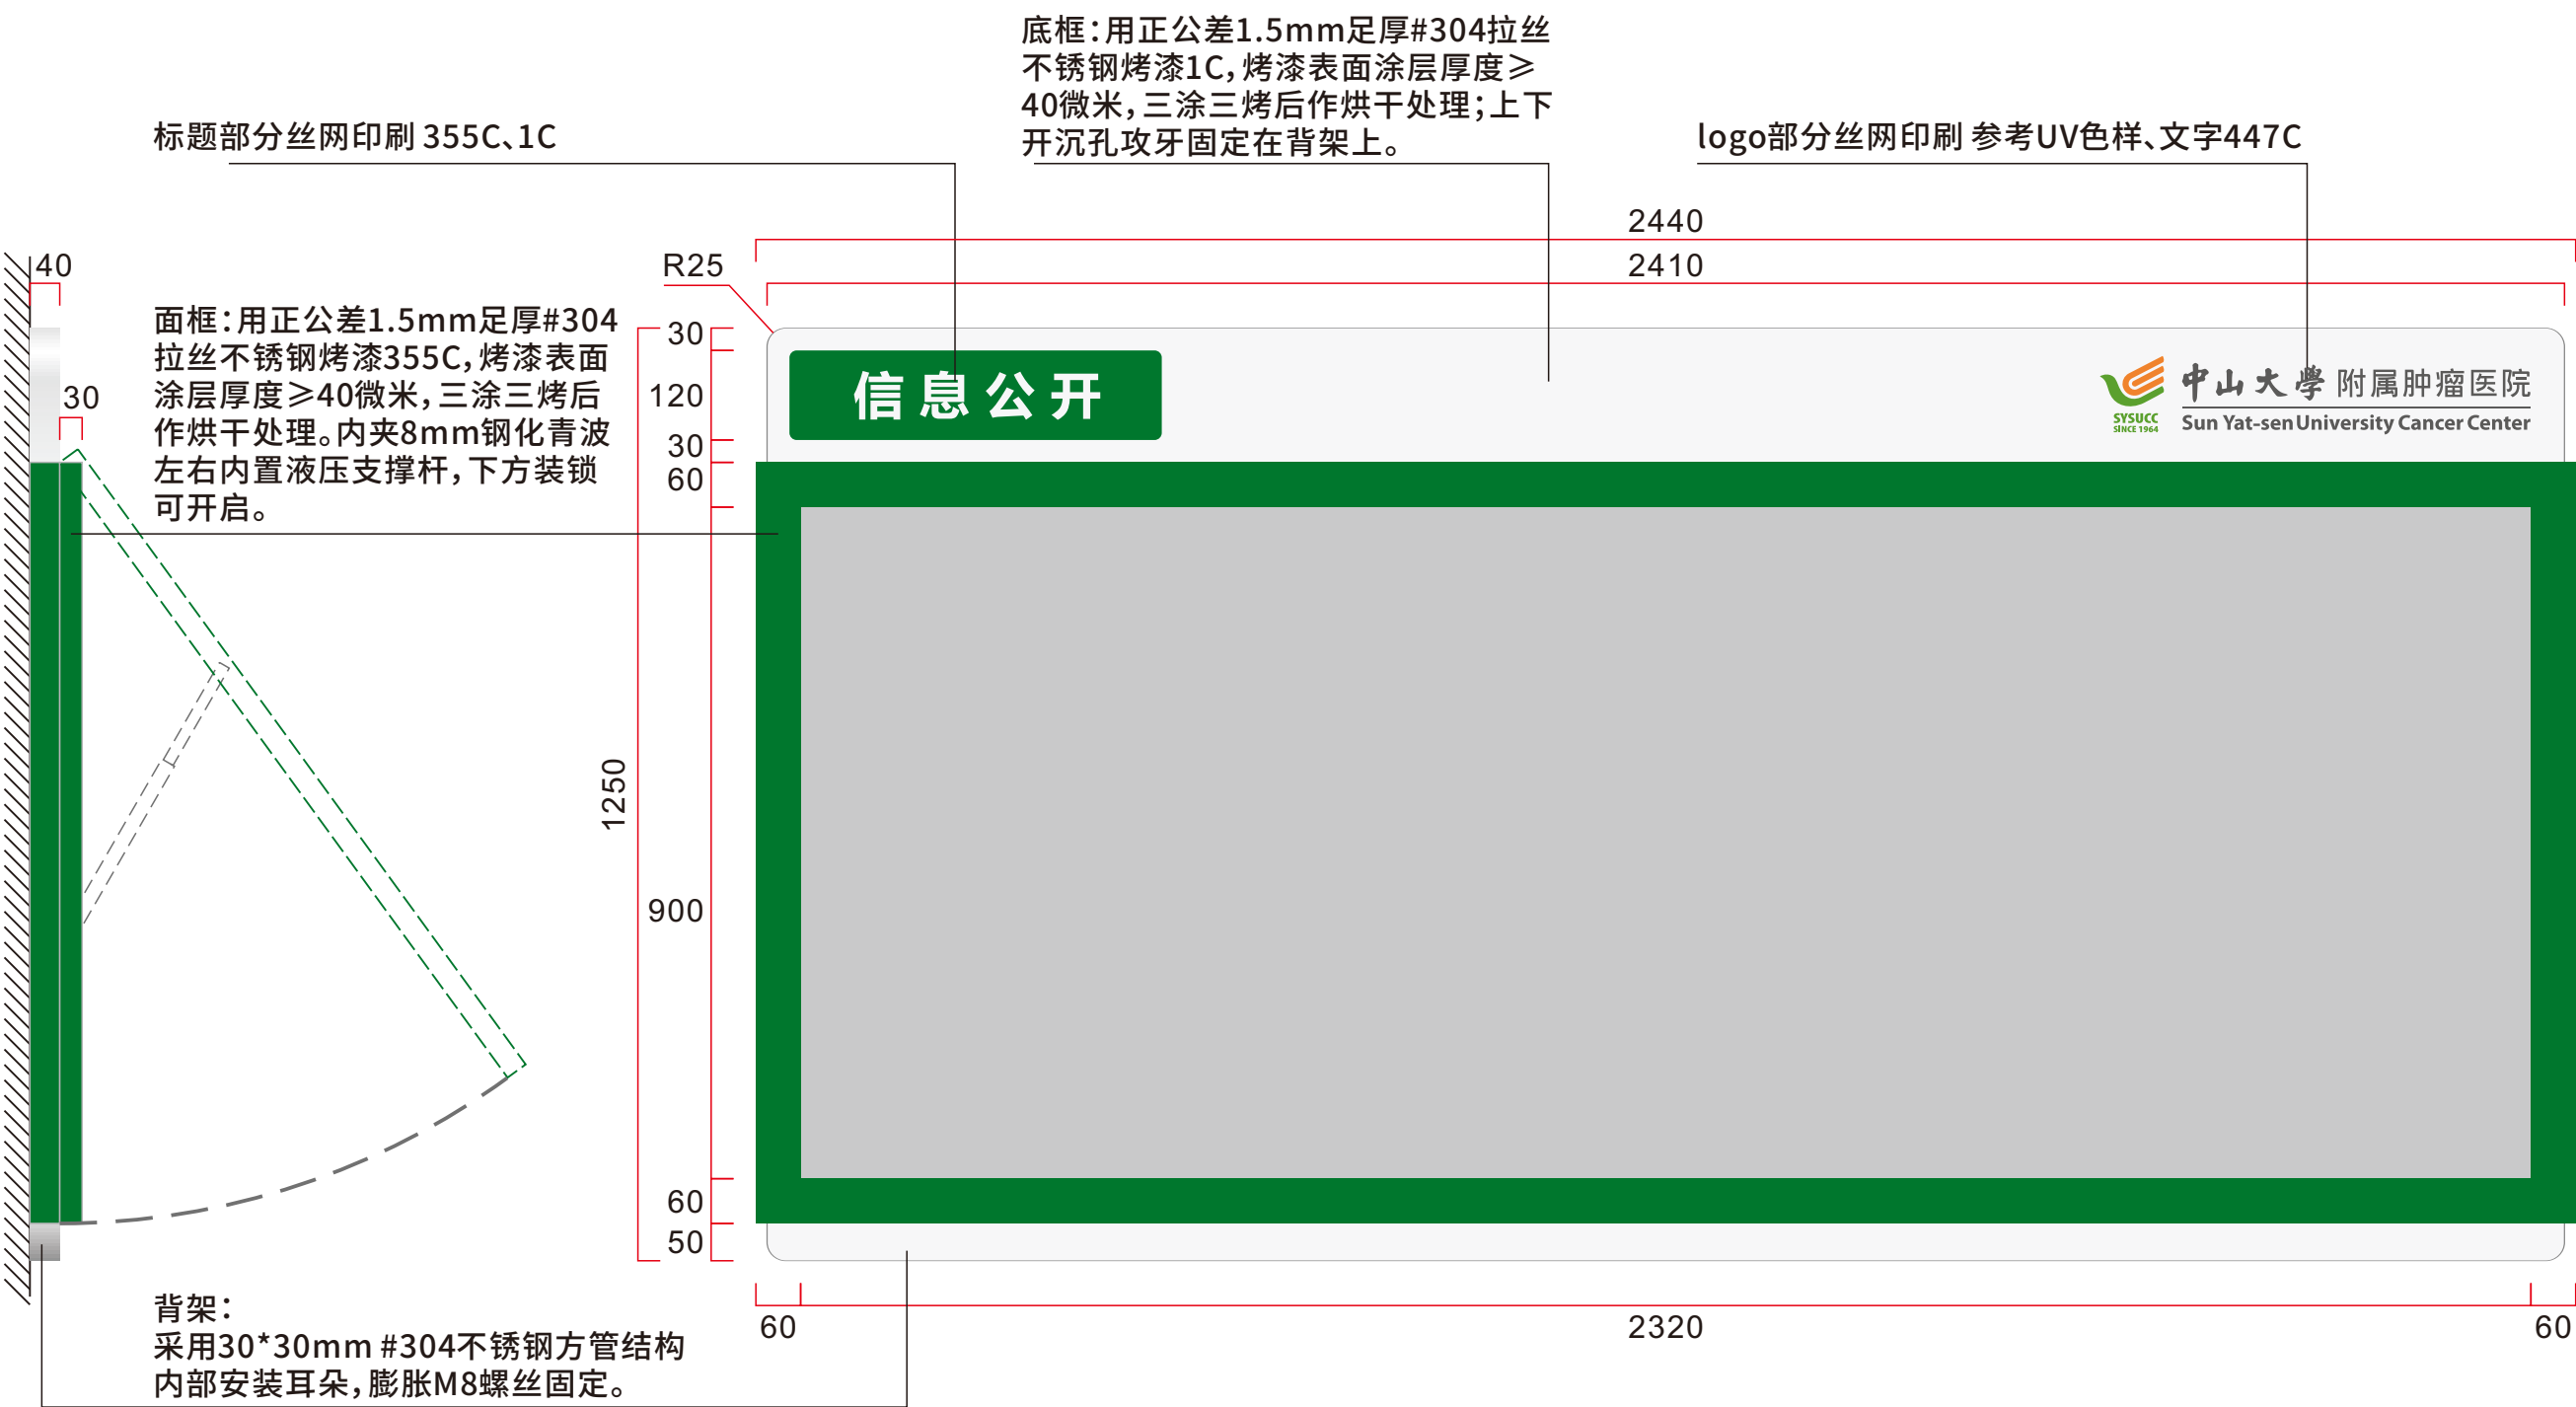

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核


主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:1200\*1000mm  
工艺:1.5mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型烤漆底盒,打印标题部分;箱体:1.5mm电解板烤漆底板,烤漆,框边内不锈钢支架,  
面不锈钢刨槽造型烤漆,绿色网足10mm软木板;  
安装方式:拉爆与现场墙体固定。

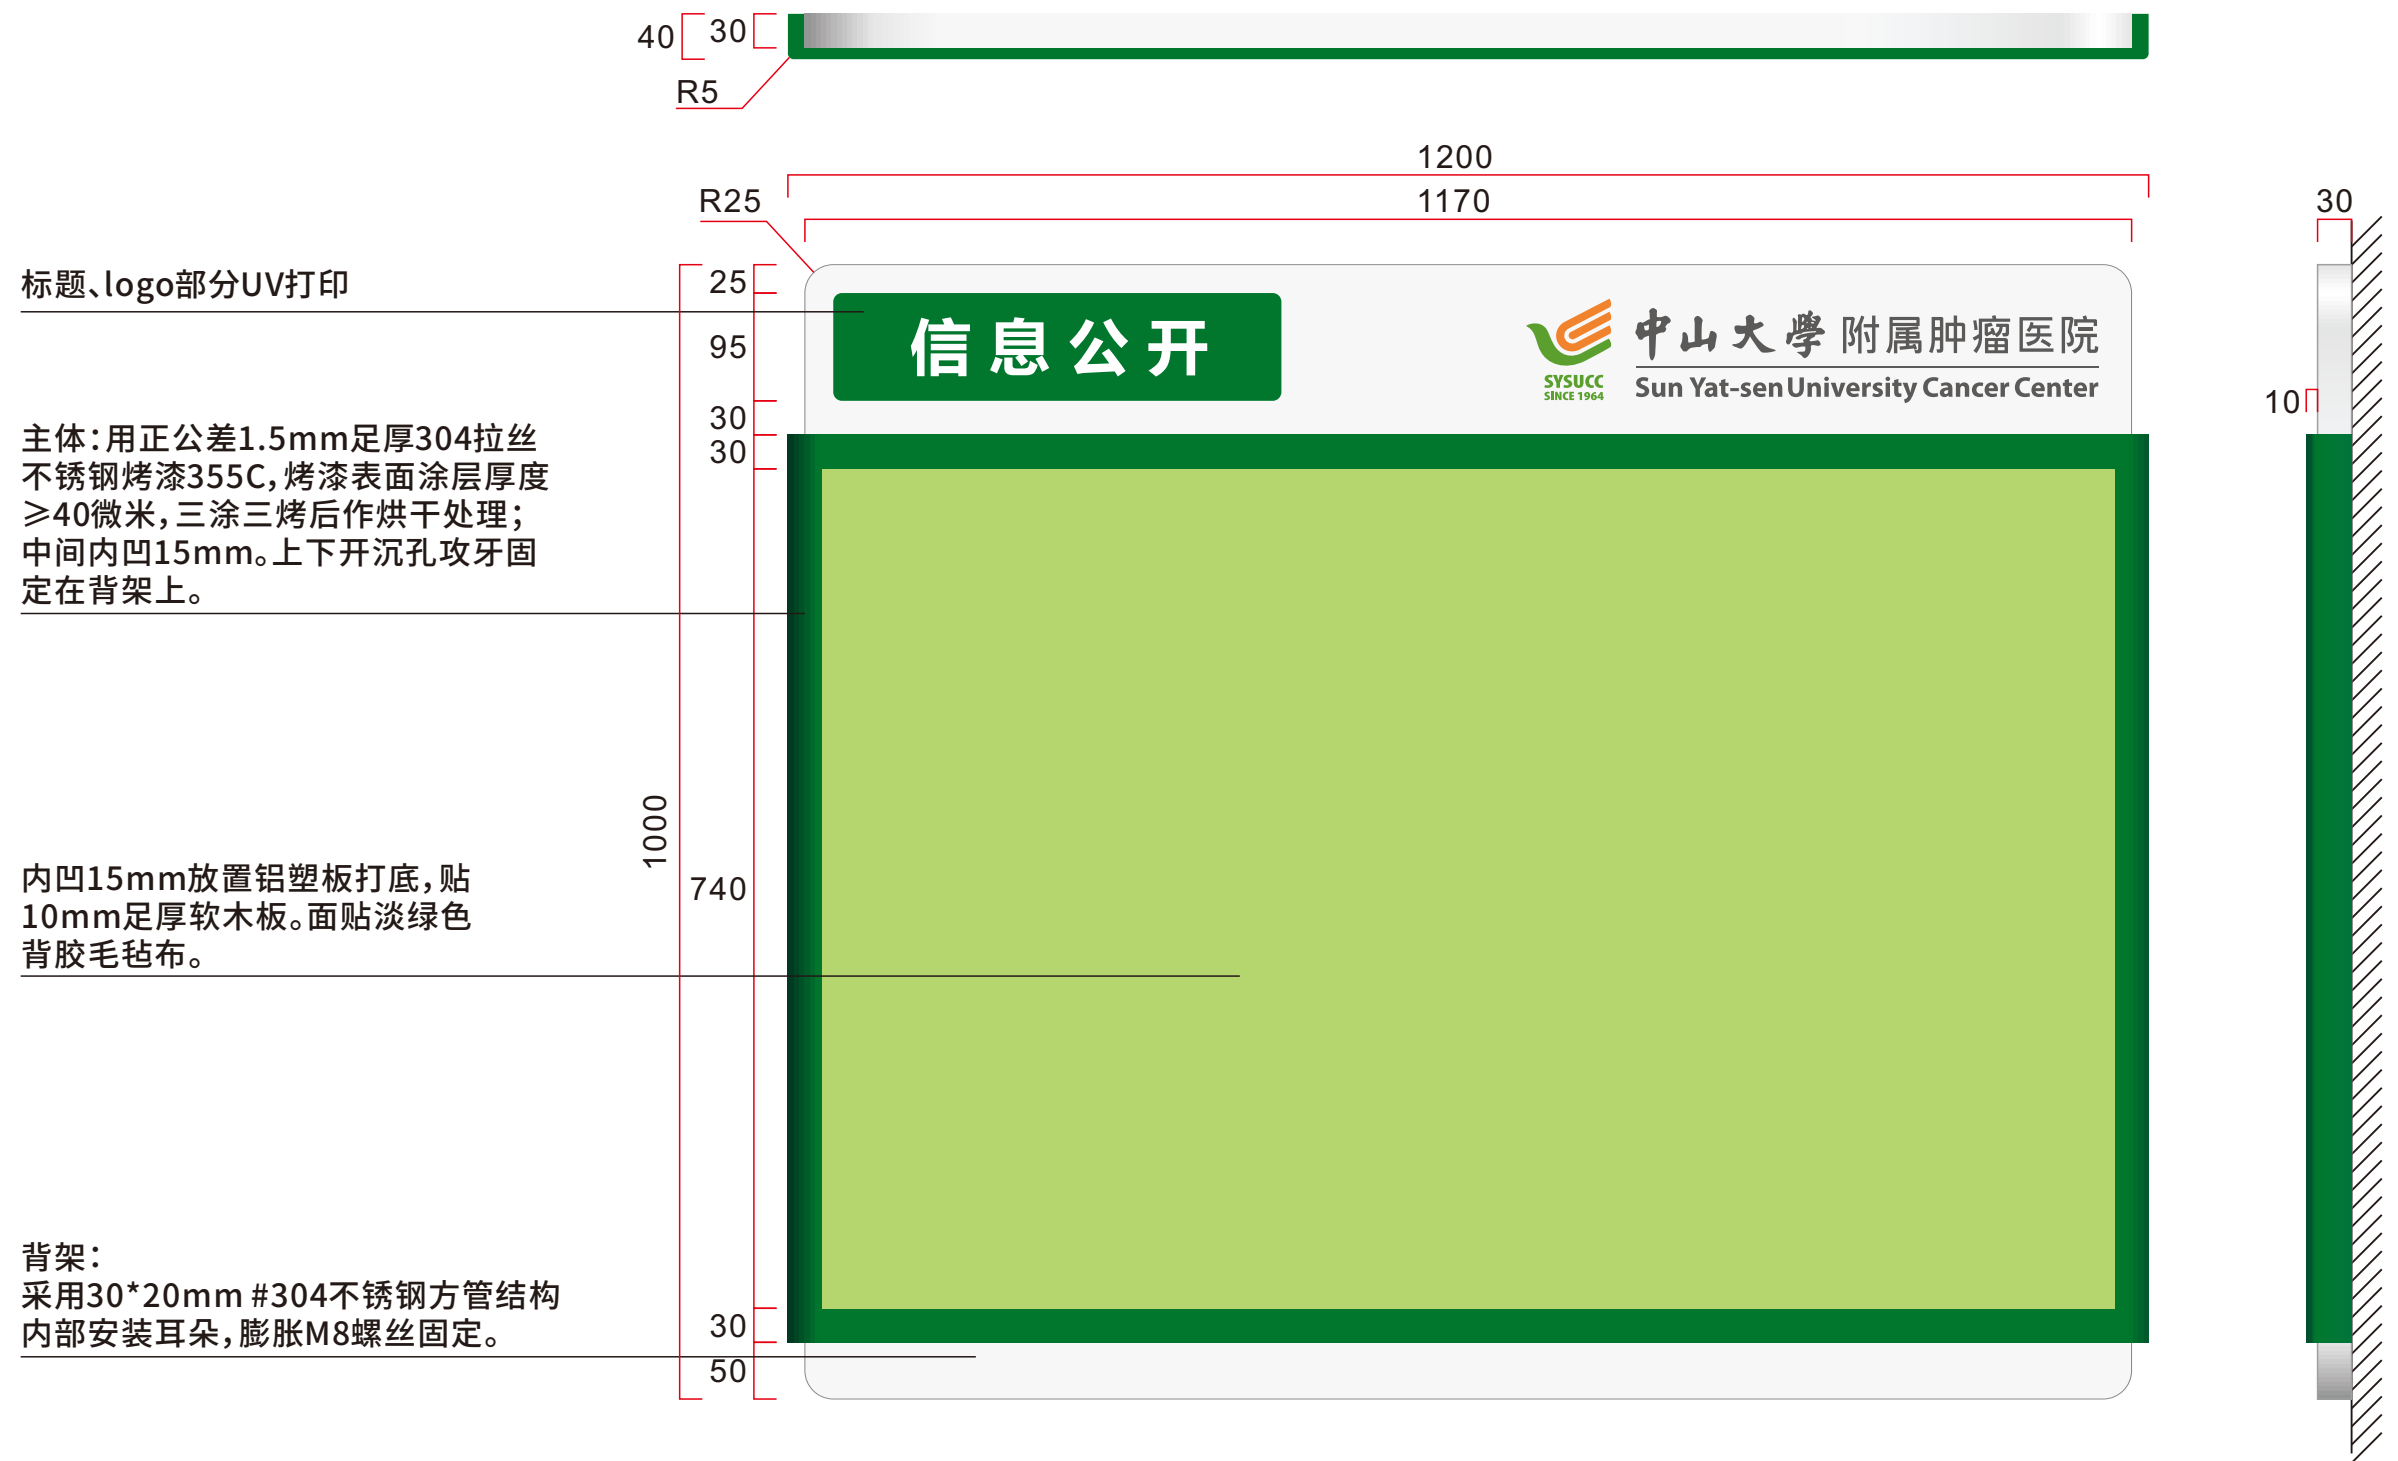

标题、logo部分UV打印

主体:用正公差1.5mm足厚304拉丝  
不锈钢烤漆355C,烤漆表面涂层厚度  
≥40微米,三涂三烤后作烘干处理;  
中间内凹15mm。上下开沉孔攻牙固  
定在背架上。

内凹15mm放置铝塑板打底,贴  
10mm足厚软木板。面贴淡绿色  
背胶毛毡布。

背架:  
采用30\*20mm #304不锈钢方管结构  
内部安装耳朵,膨胀M8螺丝固定。

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

标识设计·方案

制作单号

A14

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

信息公开栏

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A  
(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B  
(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价




SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:2000\*510\*250mm  
工艺:如图

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色A-01，油漆掺入银粉，漆面细闪银效果，面罩抗指纹光油。
- B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色C-01，面罩抗指纹光油。
- C** 铝型材组装面板区域。
- D** 平面图方形区域透明贴背胶。
- E** 版面信息丝网印刷标准色C-01。
- F** 辅助图形丝网印刷标准色C-02。

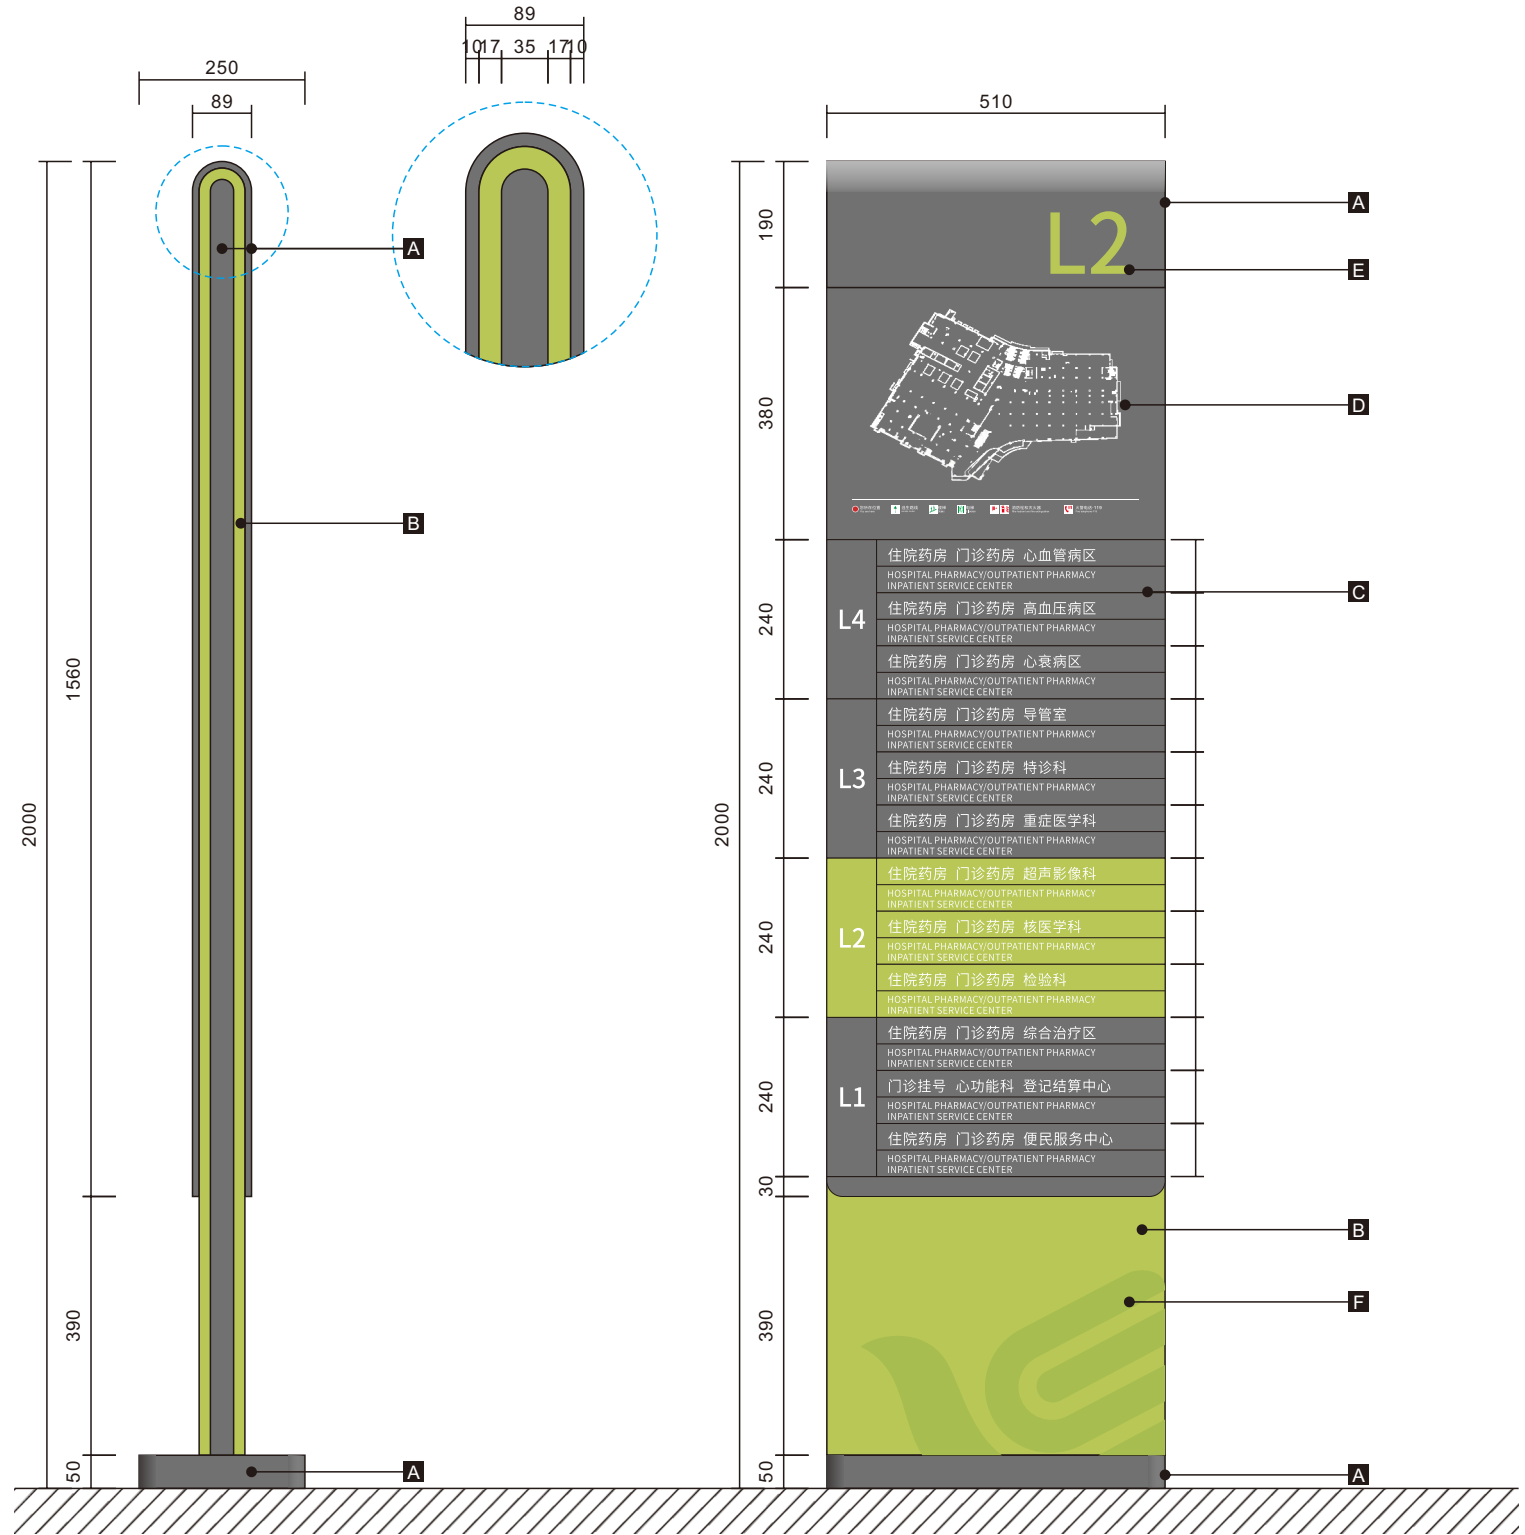


项目名称  
中大附属肿瘤医院  
图纸名称

| 扶梯索引 |              |
|------|--------------|
| 工序负责 | 结构设计         |
| 外加工  |              |
| 五金   |              |
| 喷漆   |              |
| 标识A  | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印   |              |
| 标识B  | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源  |              |
| 合同项目 |              |
| 产品单价 |              |
| 产品数量 |              |
| 产品总价 |              |

尺寸:如图

工艺:如图

- A 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色C-01/E-01，面罩抗指纹光油。
- B 表面氟碳烤漆标准色A-01/D，面罩抗指纹光油。
- C 铝型材（M40/M50面板配合MG05小明轨和BG35L型边轨） 组装面板区域。
- D 平面图方形区域超透透明背胶UV。
- E 版面信息丝网印刷标准色C-01/E-01。
- F 辅助图形丝网印刷标准色C-02/E-02。
- G 区域分段烤漆标准色C-01/E-01，面罩抗指纹光油，文字内容丝网印刷白色/K80。

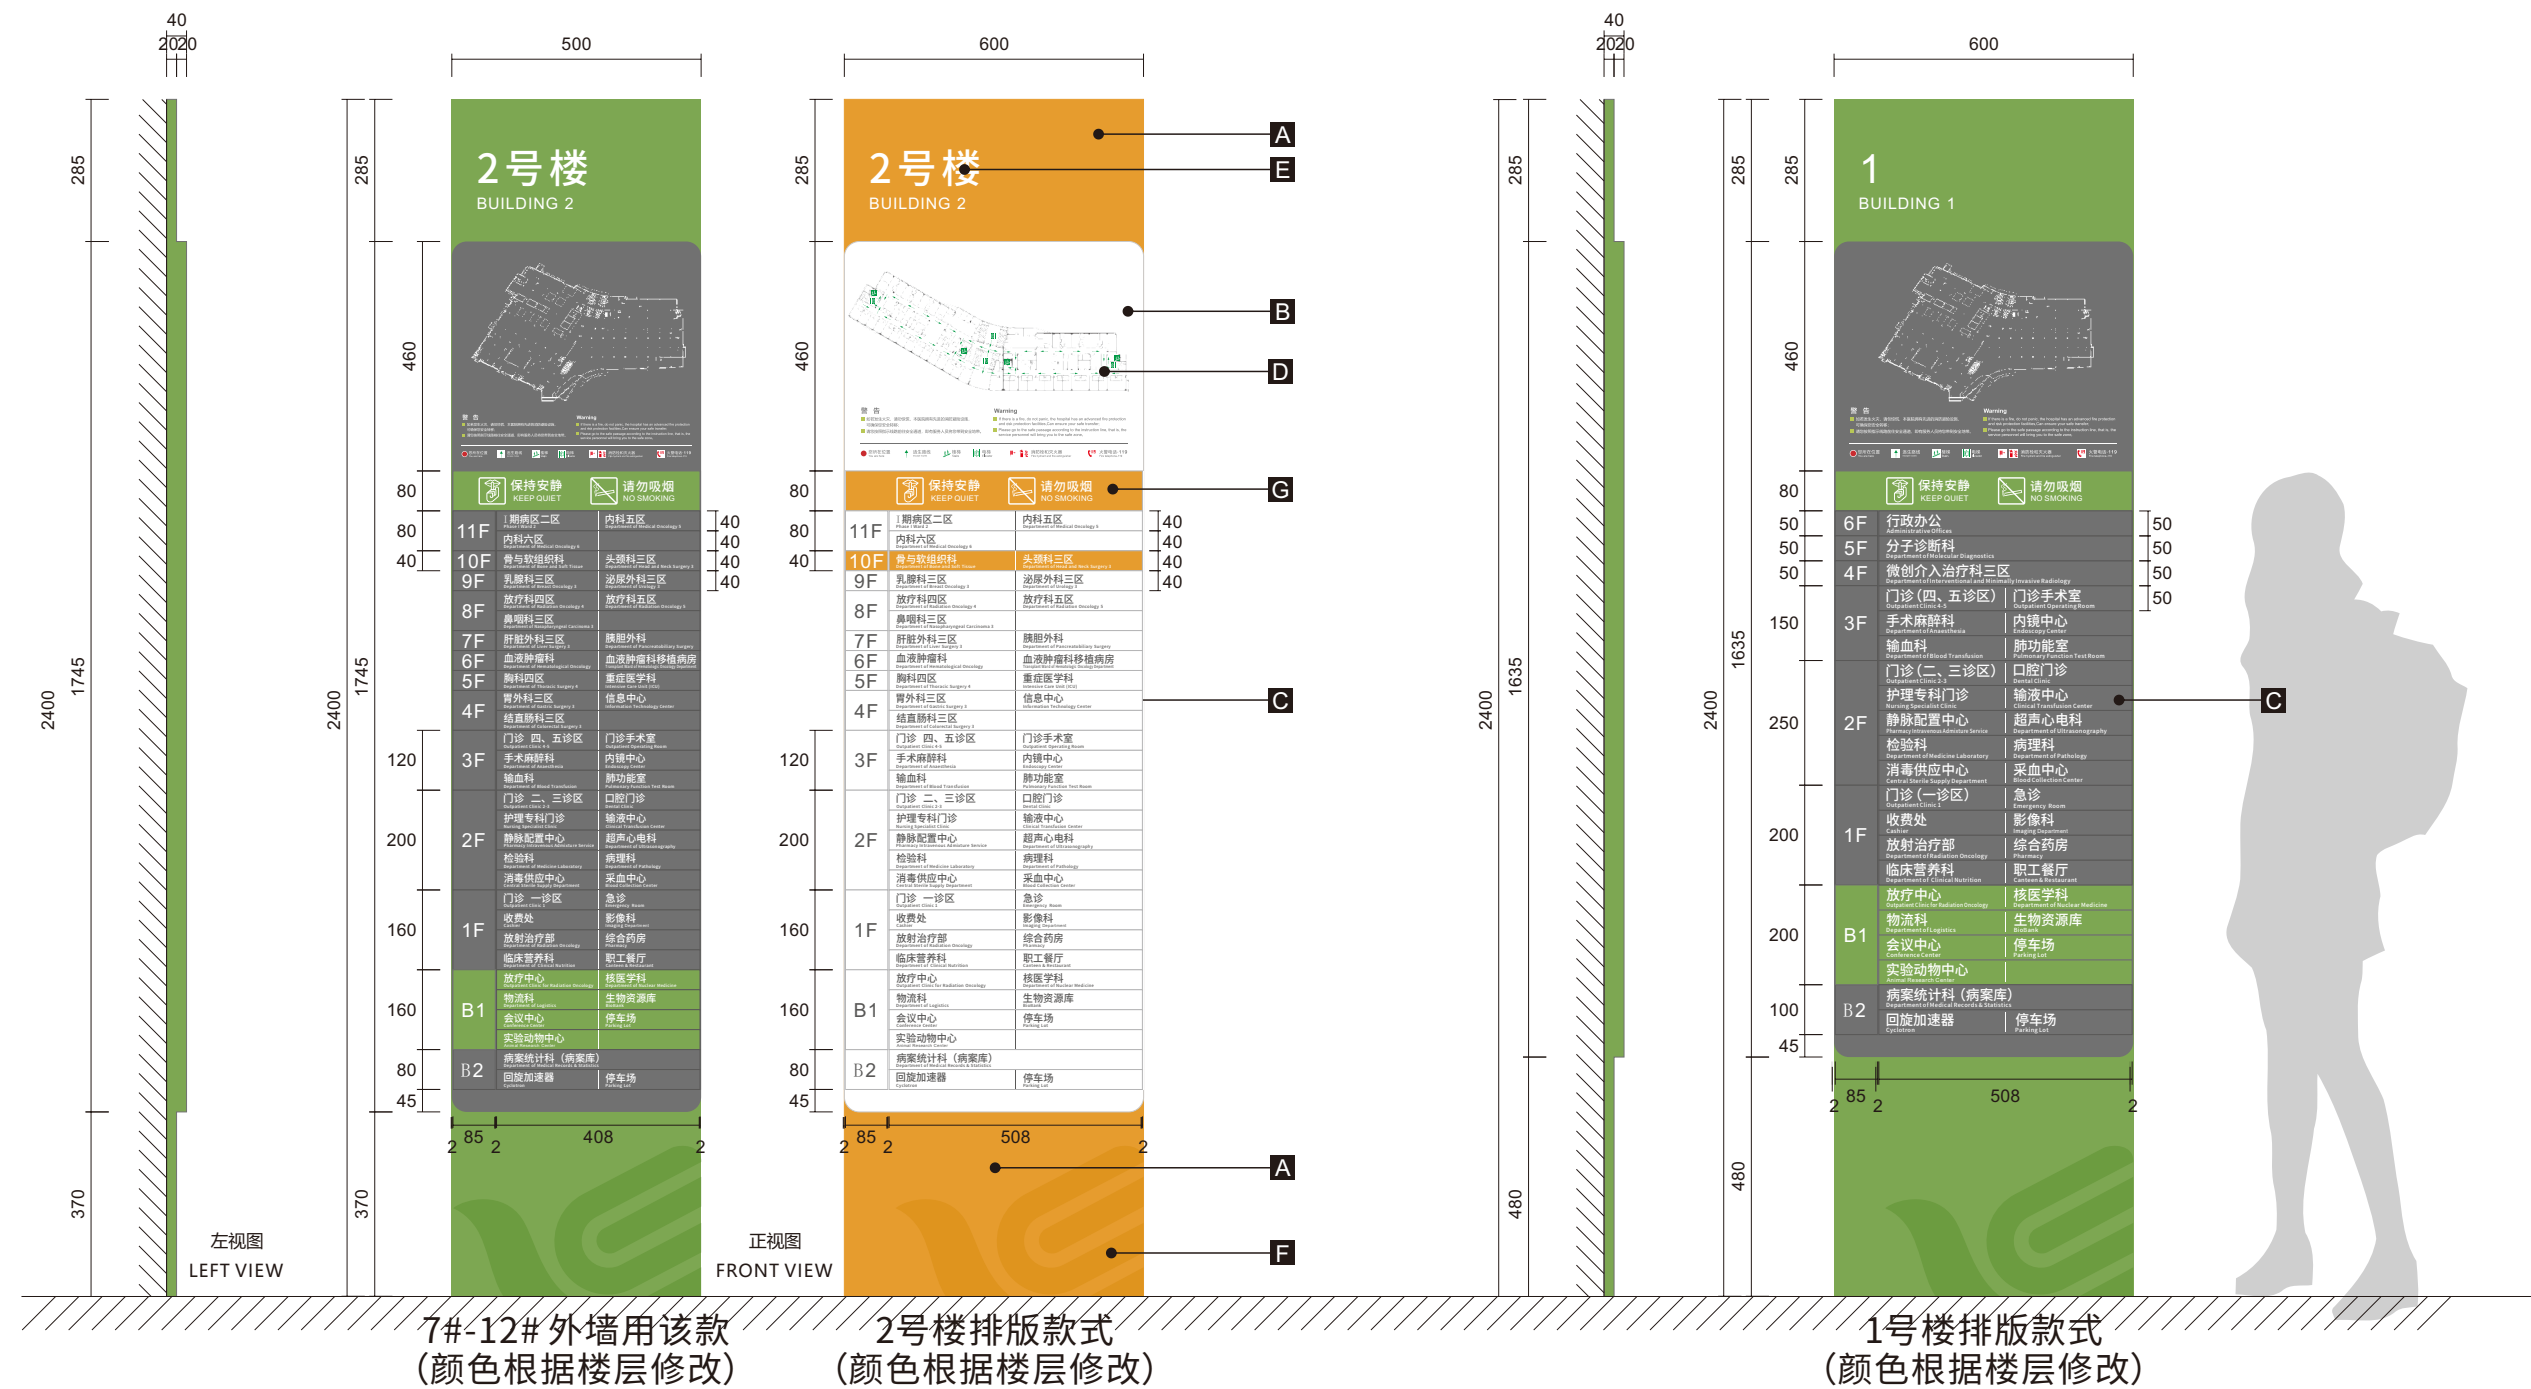

单位:mm

出图日期

设 计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:如图  
工艺:如图

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗指纹光油。
- B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色A-01,面罩抗指纹光油。
- C** 版面信息激光切割镂空背衬乳白透光板及对应色彩灯片,箱体内置LED光源。
- D** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗指纹光油。
- E** 不锈钢圆通焊制吊杆,表面氟碳烤漆标准色A-01,面罩抗指纹光油。



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:如图

工艺:如图

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型, 表面氟碳烤漆标准色C-01, 面罩抗指纹光油。
- B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型, 表面氟碳烤漆标准色A-01, 面罩抗指纹光油。
- C** 正面用UV打印信息部分。
- 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型, 表面氟碳烤漆标准色C-01, 面罩抗指纹光油。
- D**
- 不锈钢圆通焊制吊杆, 表面氟碳烤漆标准色A-01, 面罩抗指纹光油。
- E**

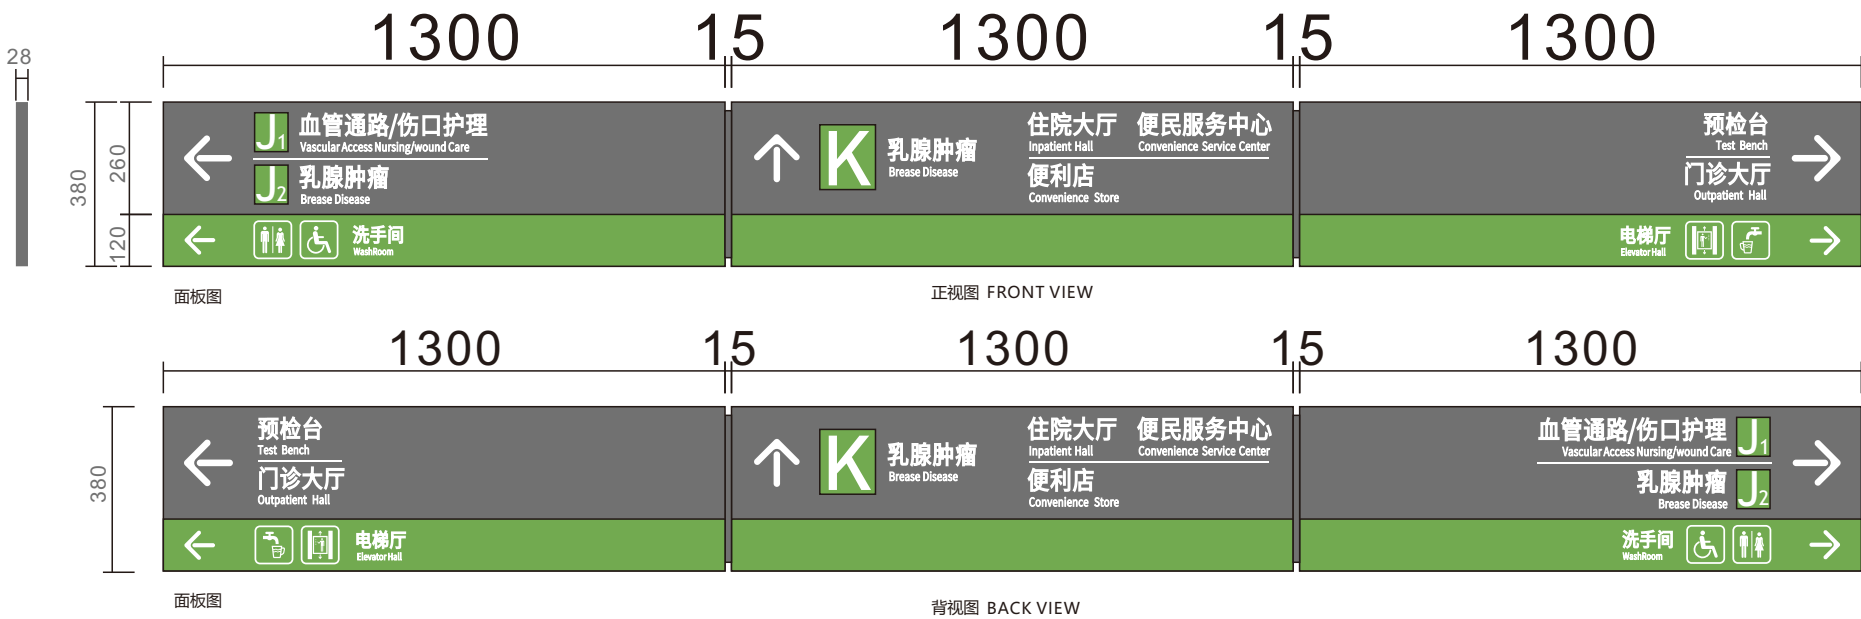

标识设计·方案

制作单号

B4

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

分流指示吊牌B

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:如图  
工艺:如图

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面及侧面四周氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗指纹光油。
- B** 表面氟碳烤漆标准色A-01,面罩抗指纹光油。
- C** 版面信息激光切割镂空背衬乳白透光板及对应色彩灯片,箱体内置LED光源。
- D** 内容丝网印刷。

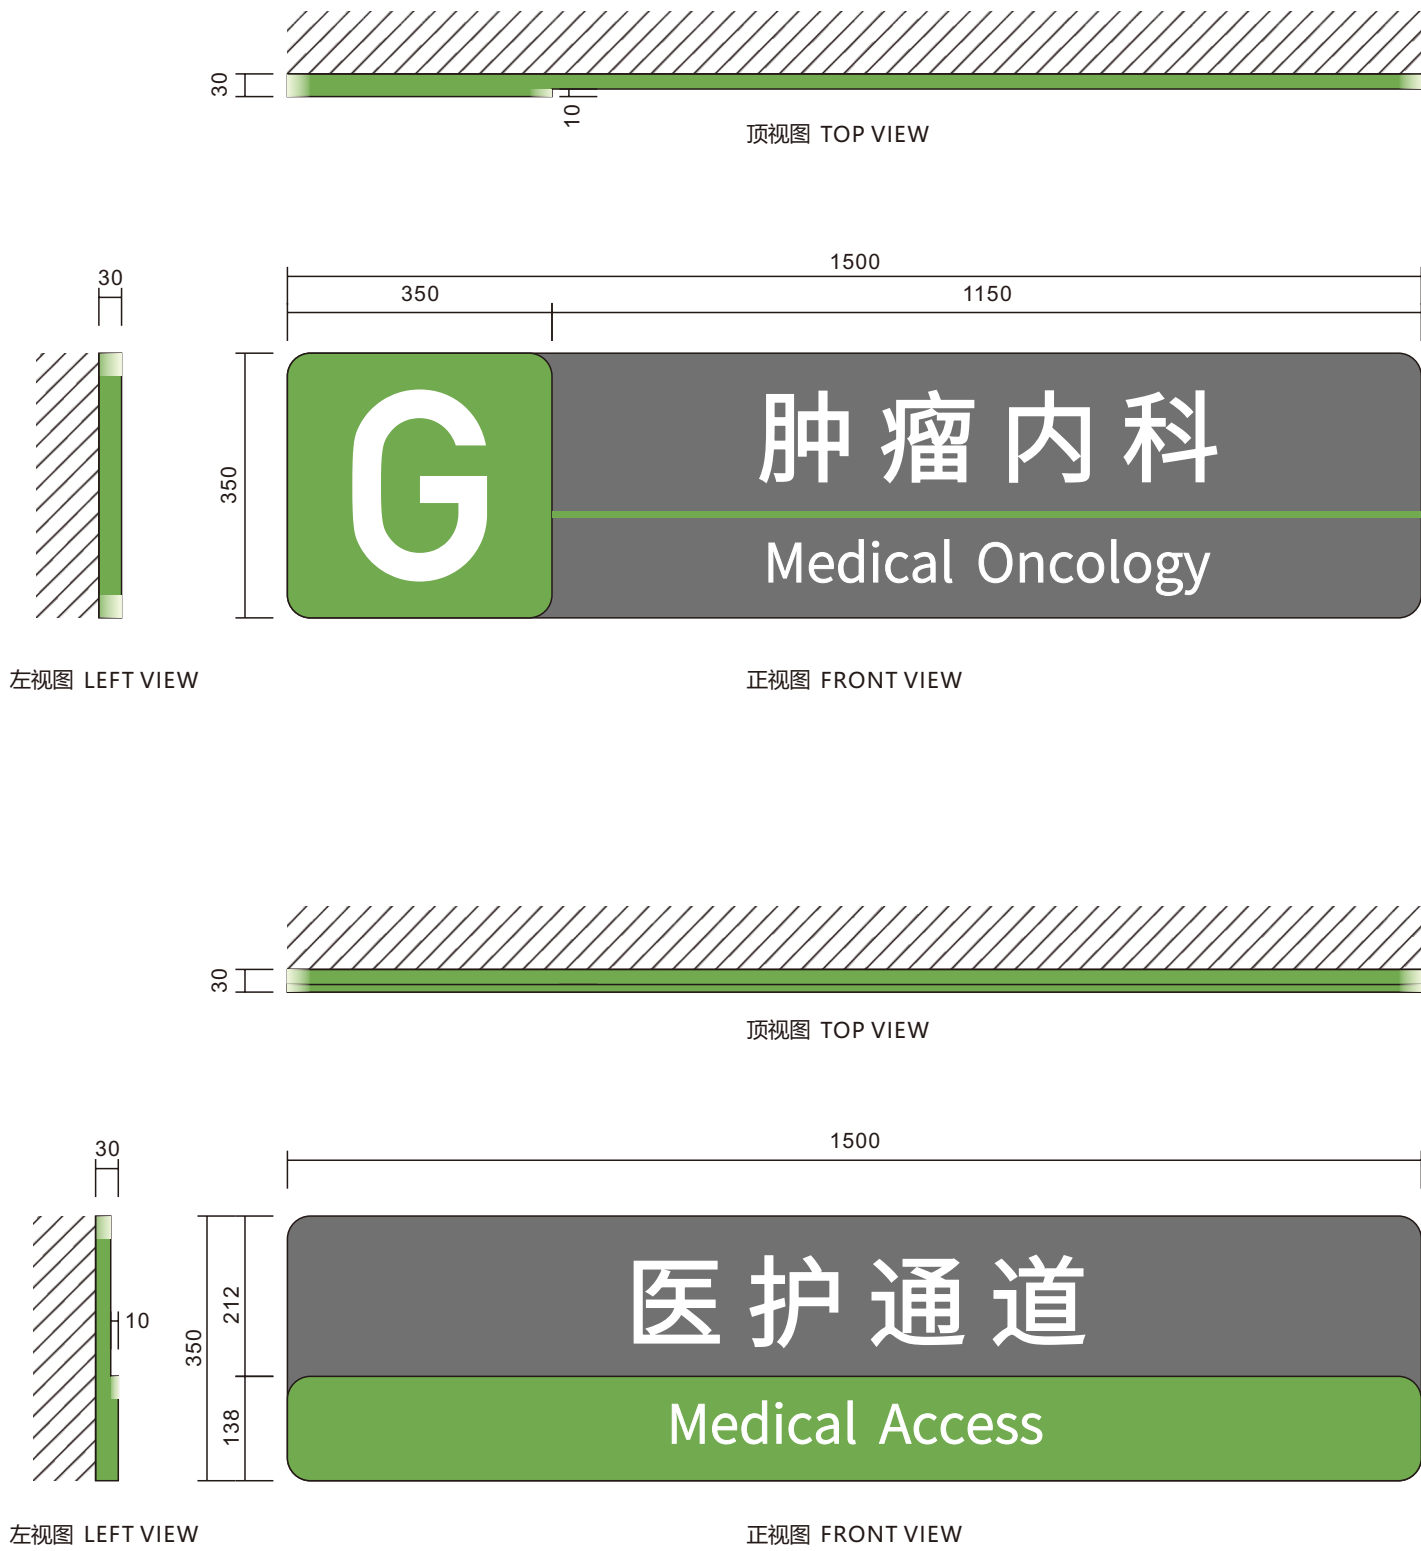

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:如图  
工艺:如图

- A 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面及侧面四周氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗指纹光油。
- B 表面氟碳烤漆标准色A-01,面罩抗指纹光油。
- C 正面用UV打印信息部分。
- D 内容丝网印刷。



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




名称:三角门牌(不发光)

尺寸:如图

材质工艺:1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体,烤漆,正面UV打印信息部分;

安装方式:葫芦孔挂装或双面胶及玻璃胶组合粘贴。

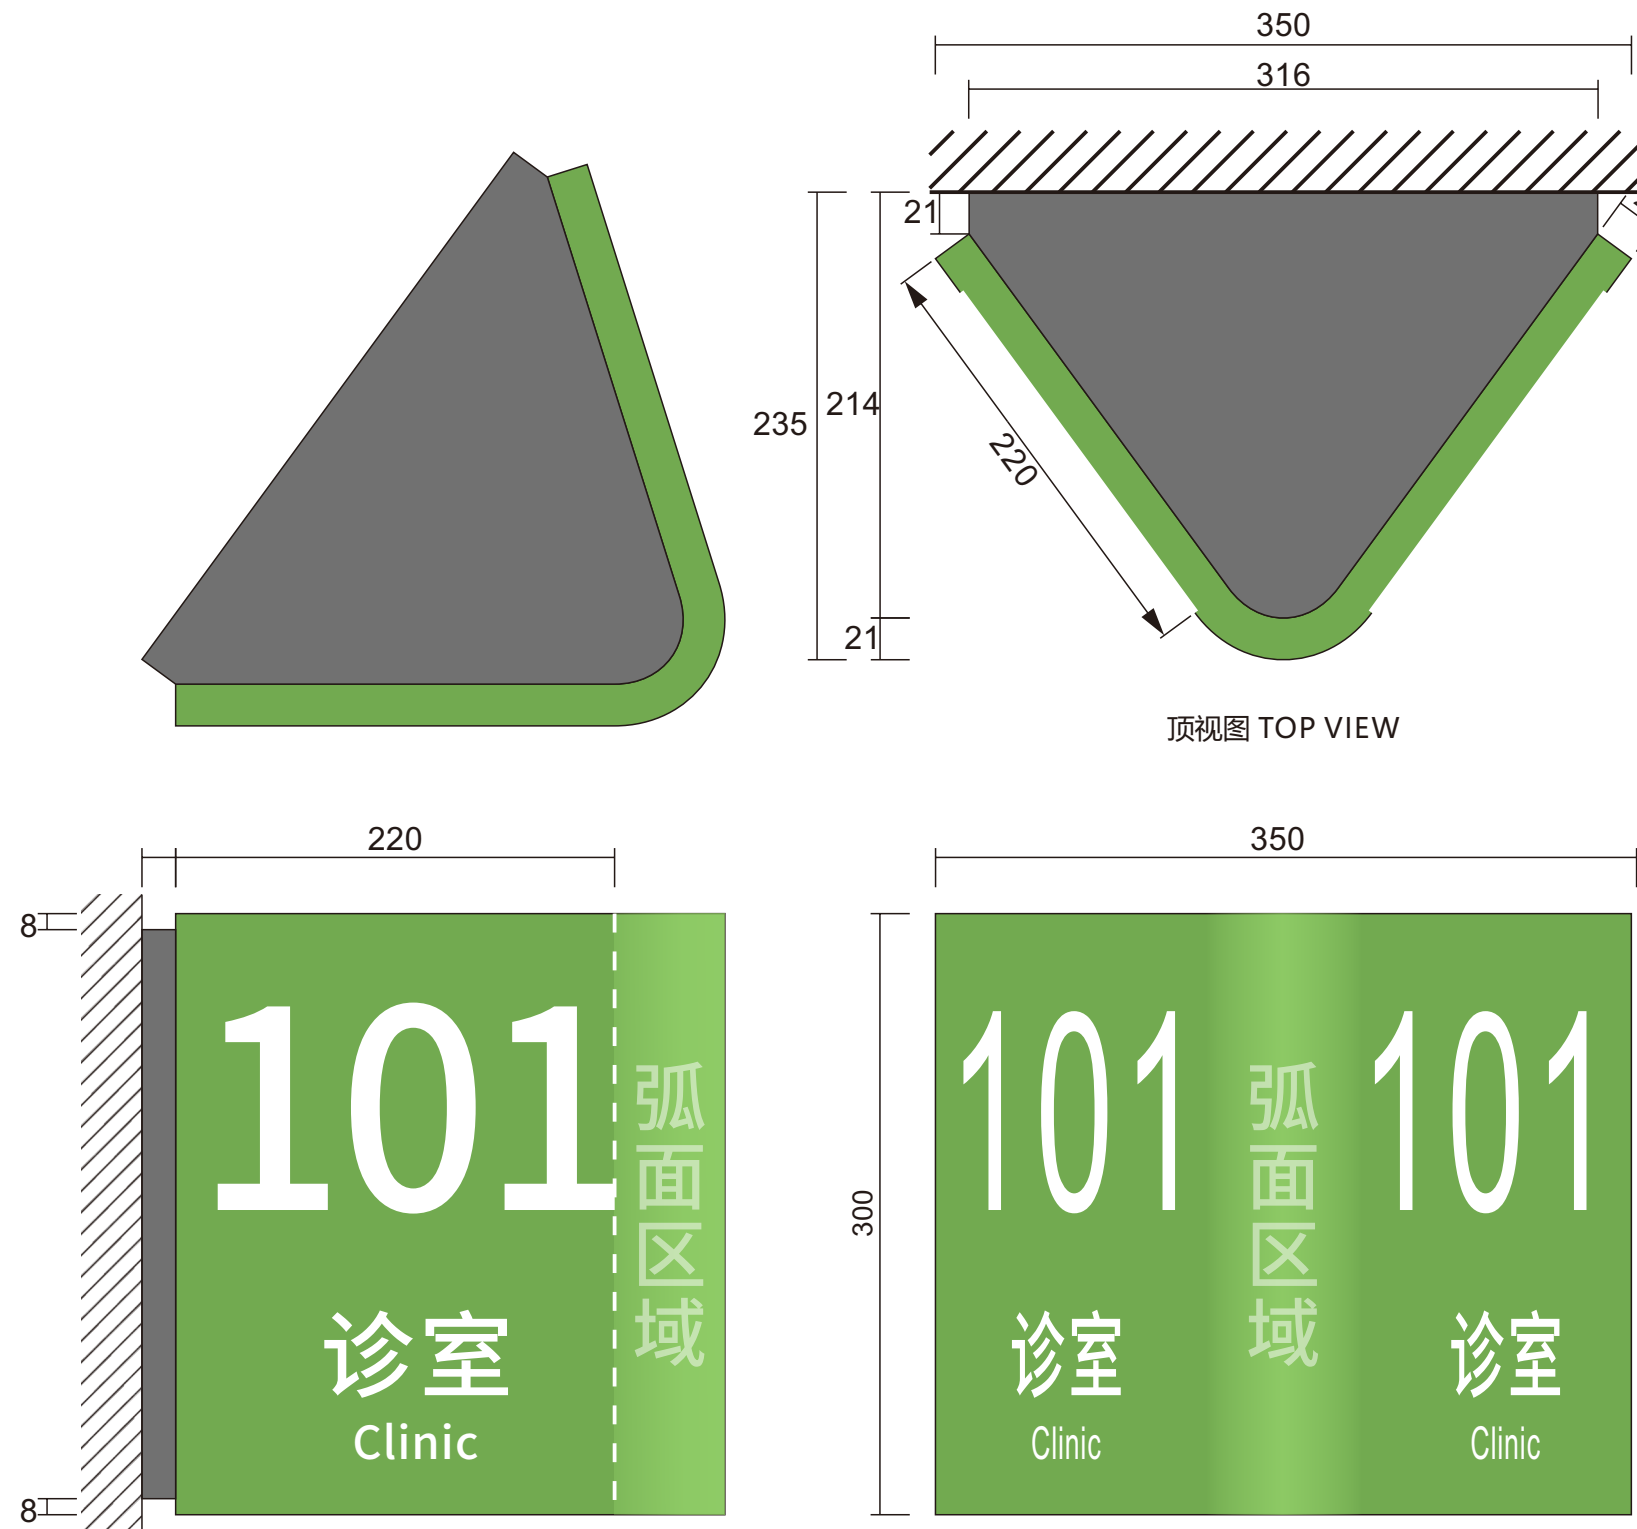

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center




名称：三角灯门牌（发光）



尺寸：如图

材质工艺：1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体，烤漆，正面镂空雕刻信息部分；  
背衬乳白色亚克力透光板，箱体内置LED光源。

安装方式：葫芦孔挂装或双面胶及玻璃胶组合粘贴。

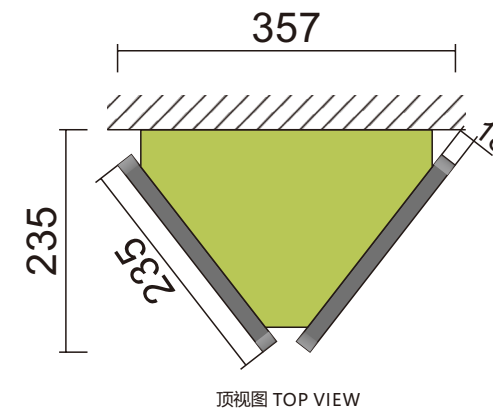

顶视图 TOP VIEW

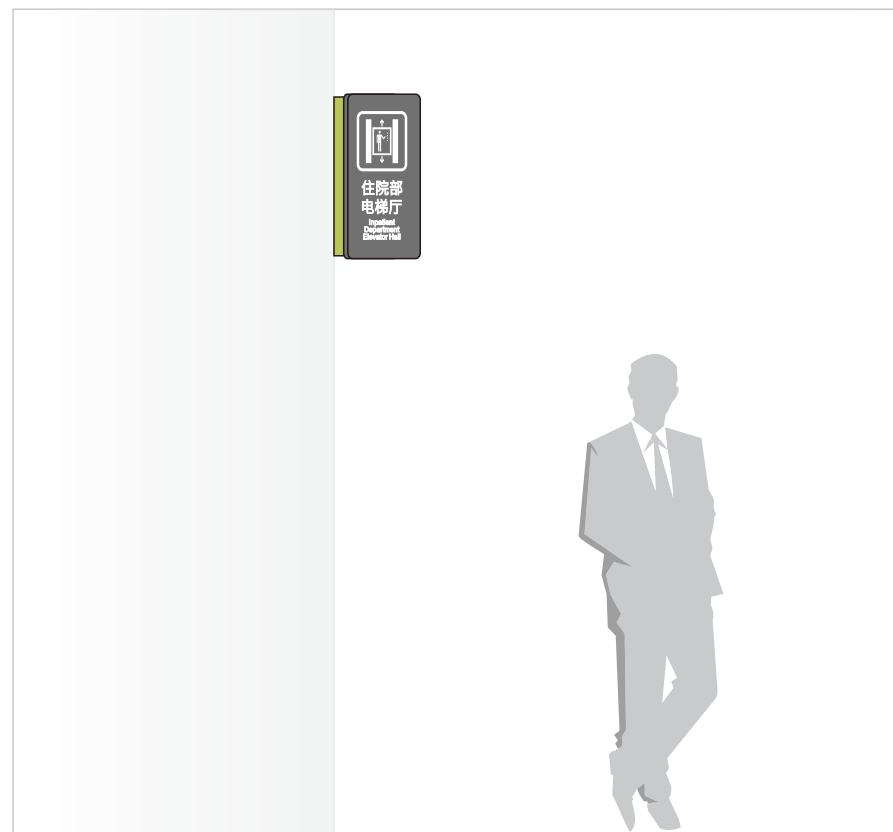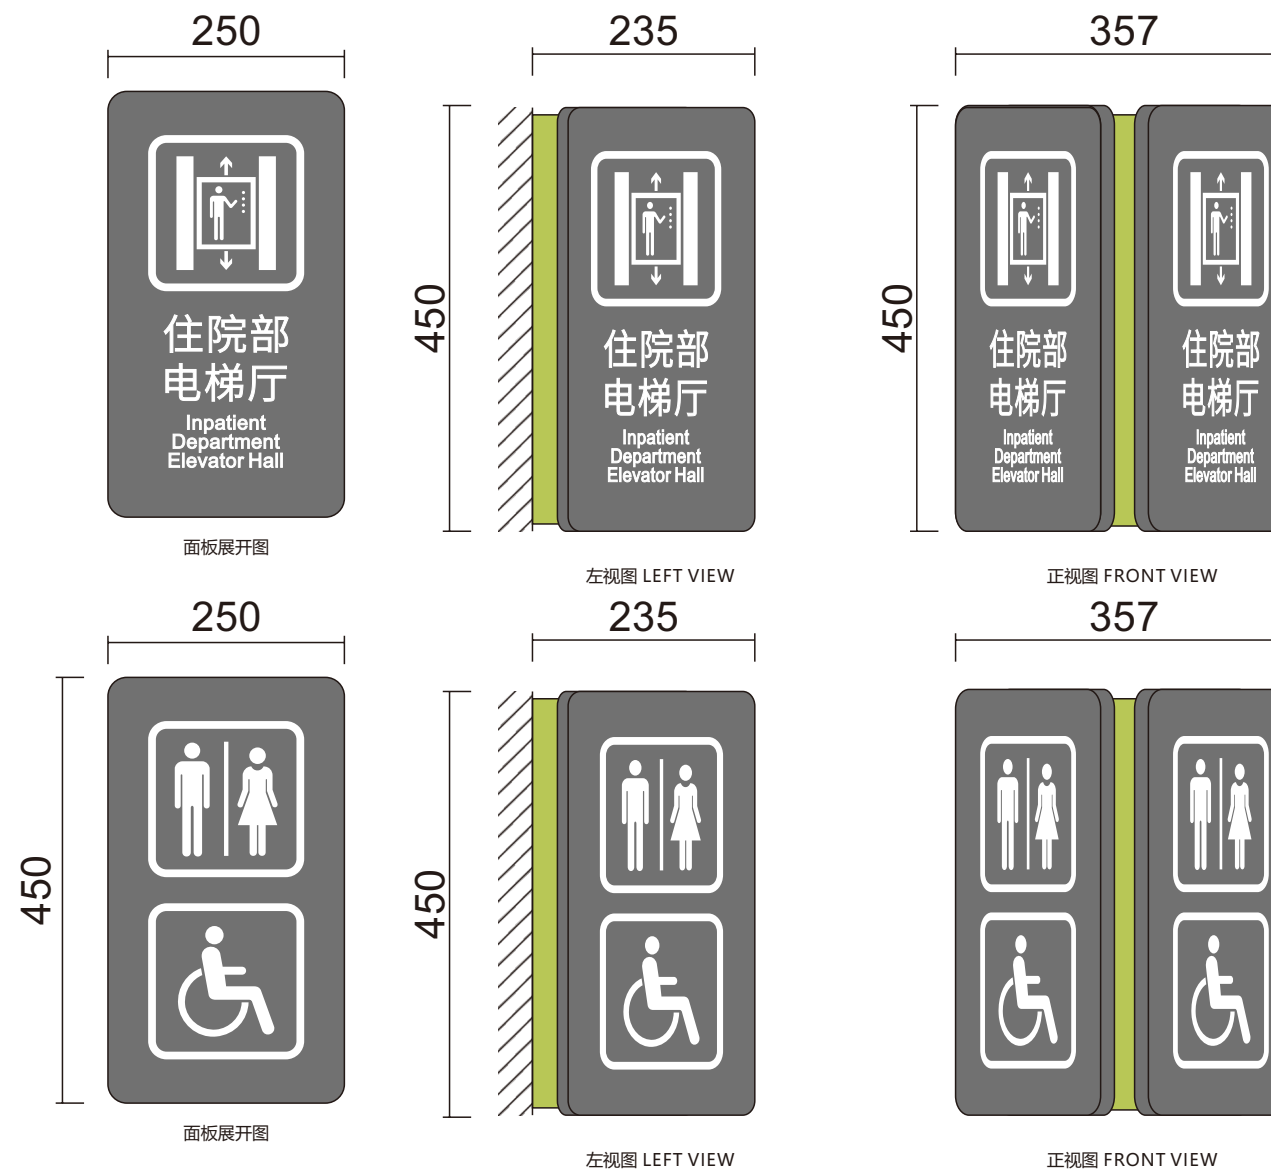

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核



主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

名称:插条式门牌  
尺寸:380\*295\*17mm  
材质工艺:1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型箱体,烤漆,正面UV打印信息部分;  
安装方式:葫芦孔挂装或双面胶及玻璃胶组合粘贴。

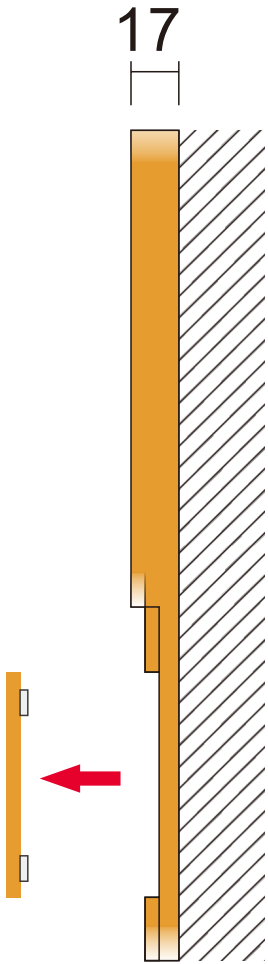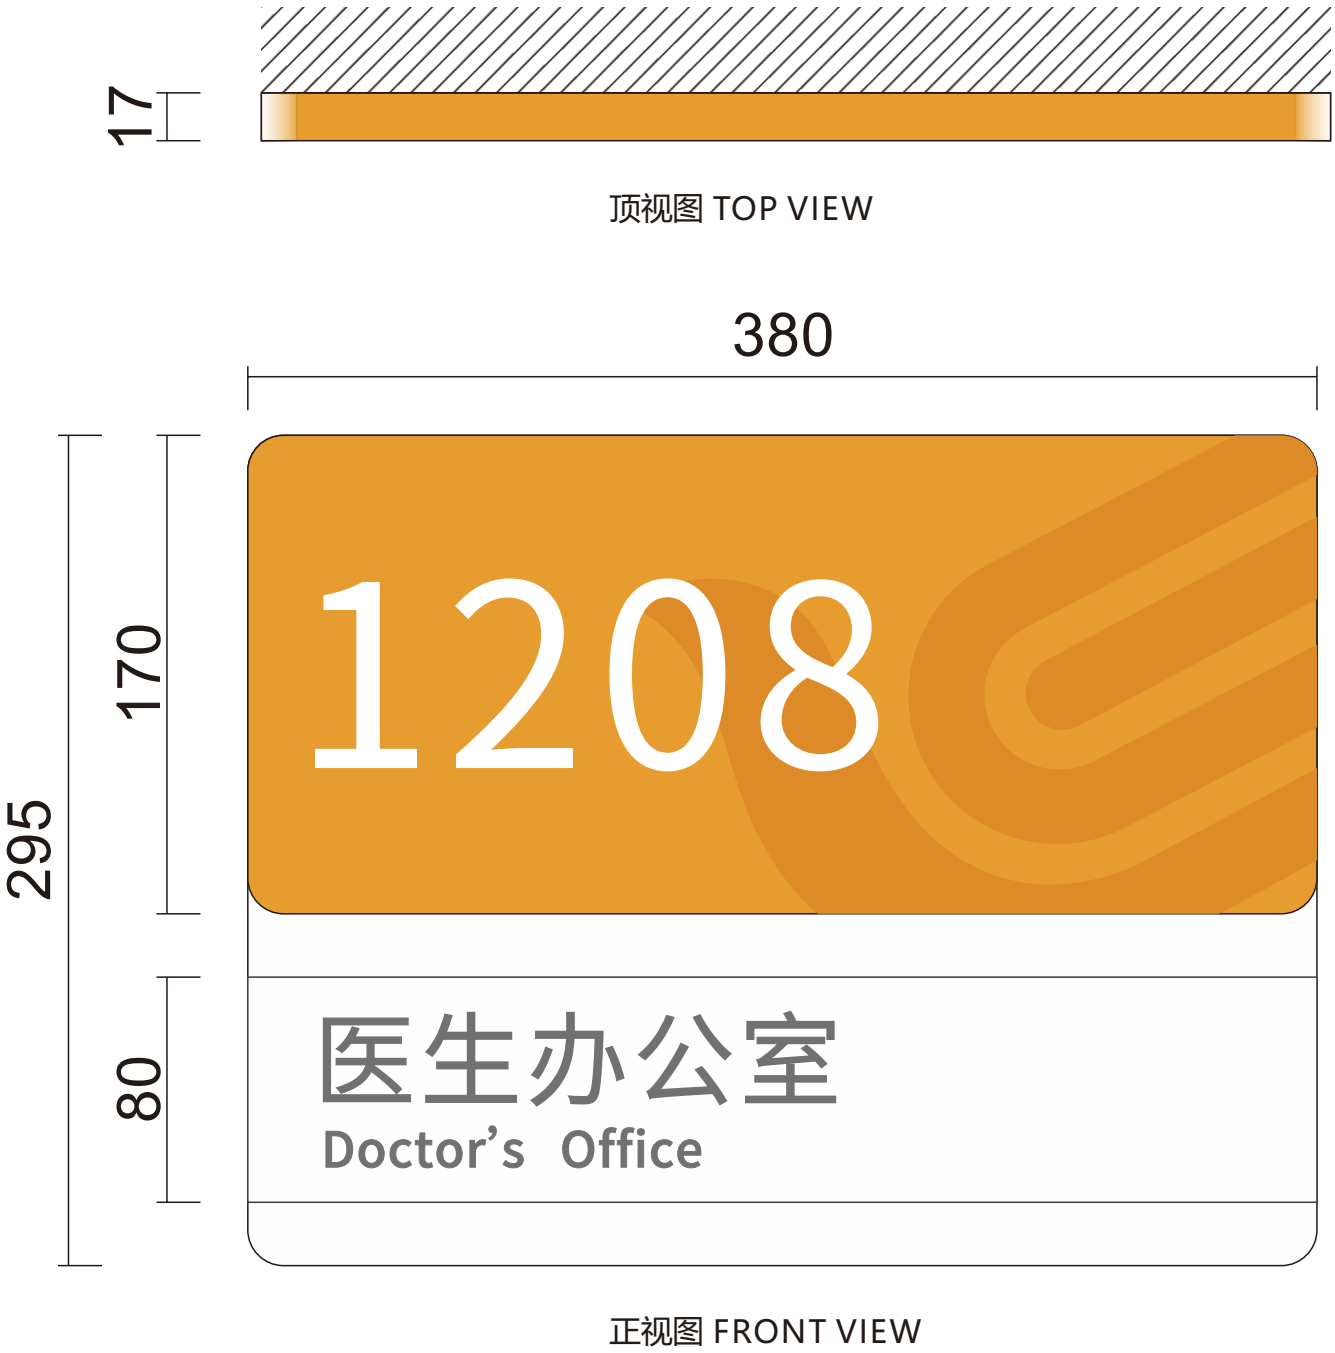

标识设计·方案

制作单号

B9

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

插条式门牌

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|


名称：平贴式门牌

尺寸：280\*100\*2mm

材质工艺：A.厚2mm有机玻璃切割面板，正面部分喷漆标准色A-01/标准色D，面罩抗指纹光油。

B.侧面四周及正面部分喷漆标准色C-01/E-01，面罩抗指纹光油。

C.内容丝网印刷。



顶视图 TOP VIEW



正视图 FRONT VIEW



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

名称：平贴式门牌

尺寸：280\*100\*5mm

材质工艺：A.厚5mm有机玻璃切割面板，正面部分喷漆标准色A-01/标准色D，面罩抗指纹光油。  
B.侧面四周及正面部分喷漆标准色C-01/E-01，面罩抗指纹光油。  
C.内容丝网印刷。



顶视图 TOP VIEW



正视图 FRONT VIEW



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

- 名称:宣传栏
- 尺寸:如图
- 材质工艺:

- A 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,正面及侧面氟碳烤漆标准色E-01,面罩抗指纹光油。
- B 表面氟碳烤漆标准色E-01,面板下沉10mm,面罩抗指纹光油。
- C 表面氟碳烤漆标准色D,面板下沉10mm,面罩抗指纹光油。
- D 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制边框,正面及侧面氟碳烤漆标准色D,面罩抗指纹光油,面板为透明有机玻璃,底板为磁性白板,门框由液压杆支撑可向上开启。
- E 文字丝网印刷白色。

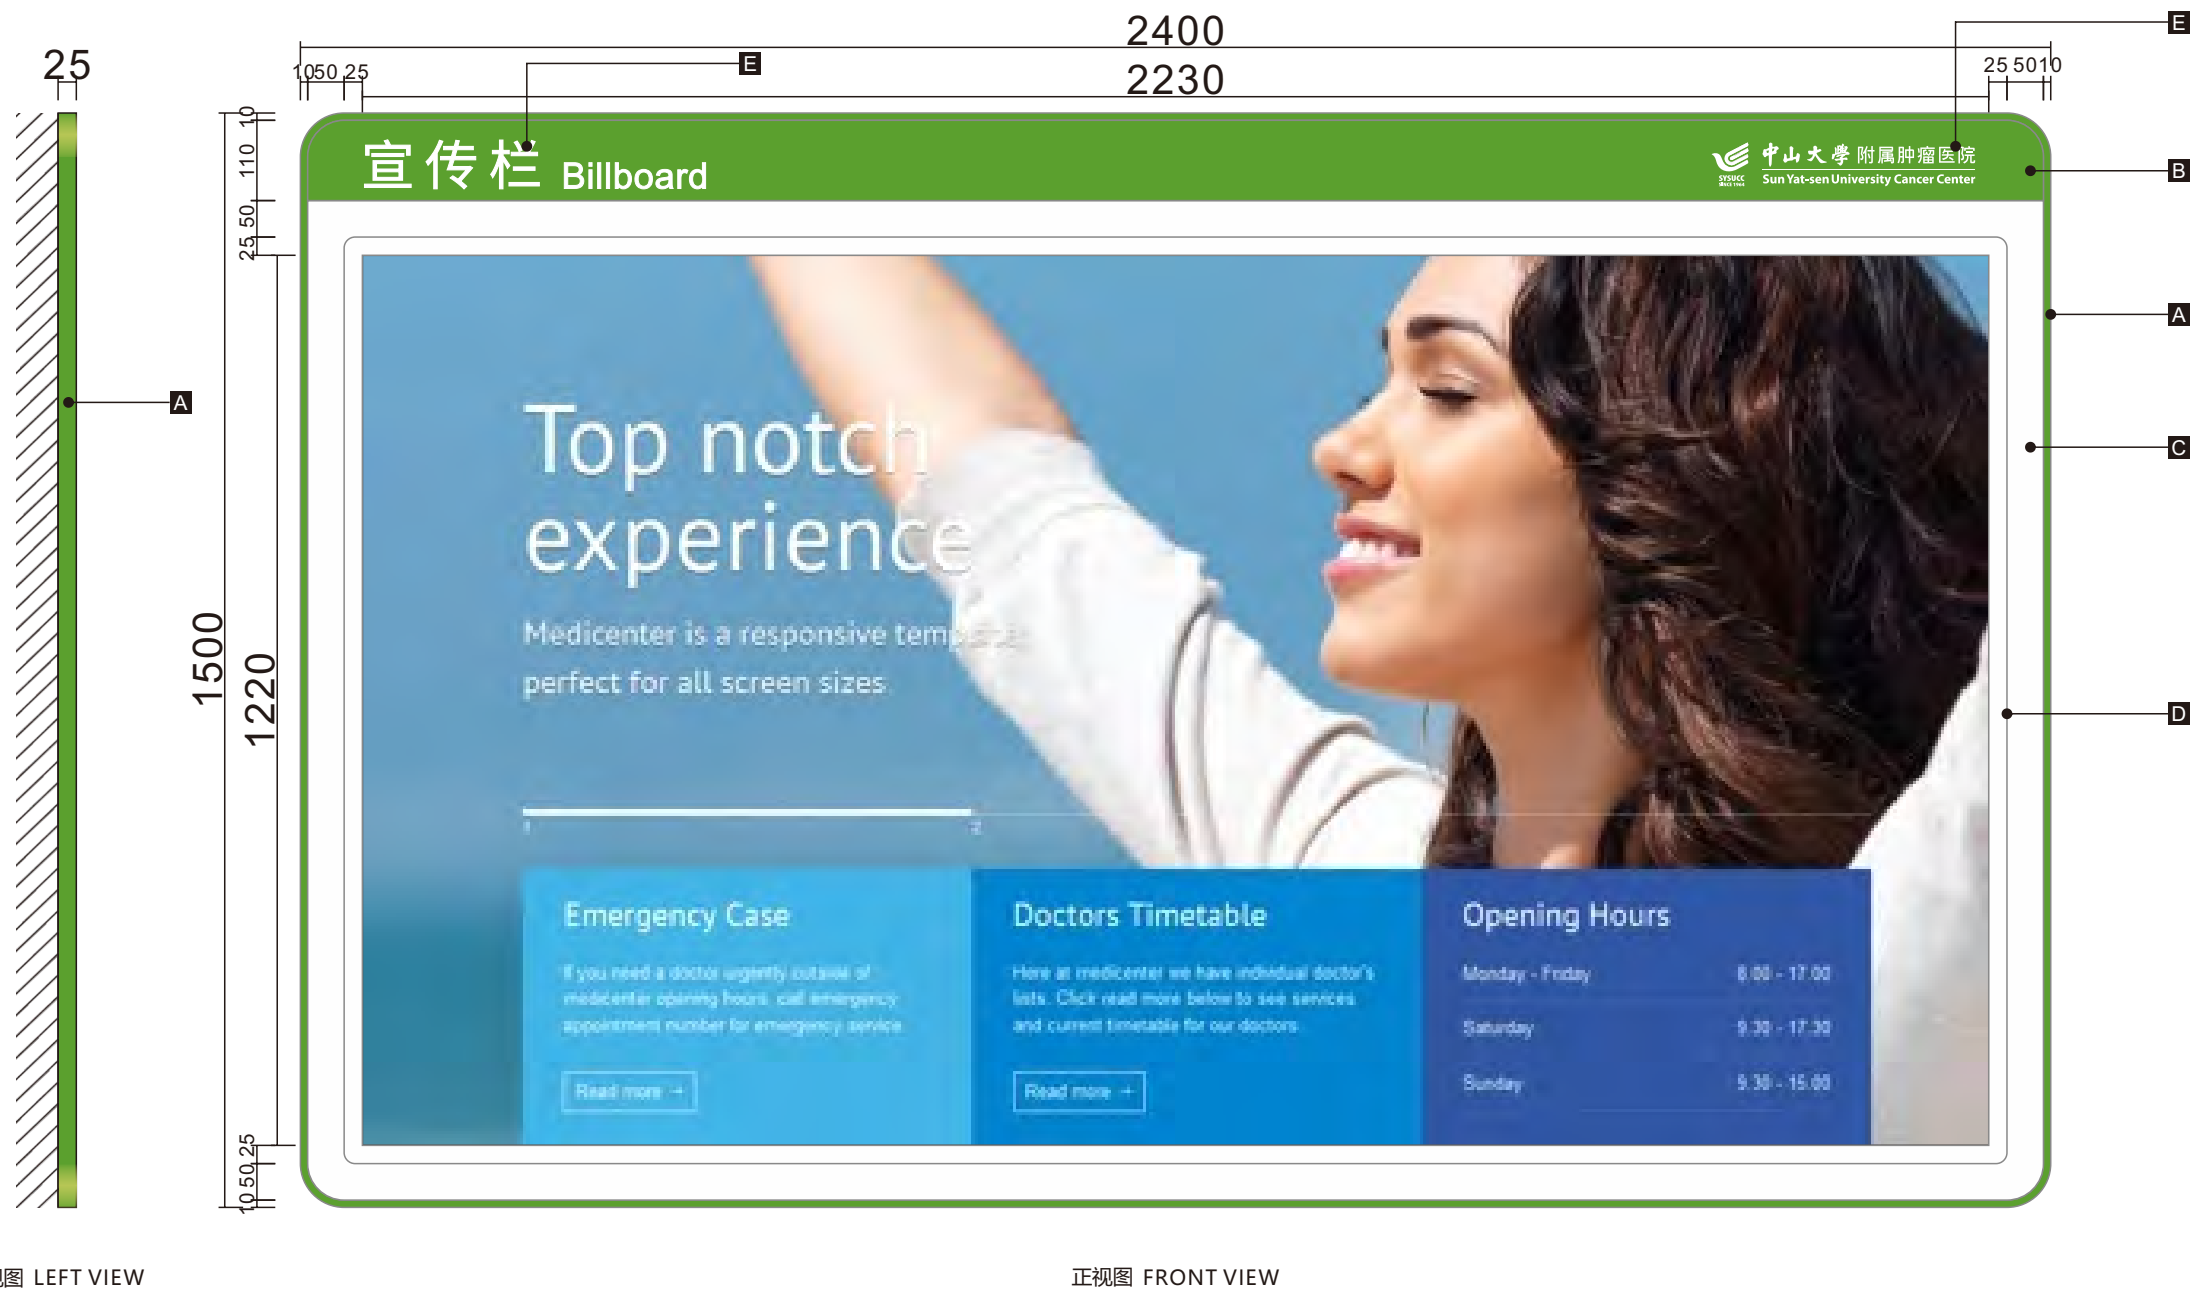

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

- 名称:公告栏
- 尺寸:如图
- 材质工艺:

- A 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型, 正面及侧面氟碳烤漆标准色C-01, 面罩抗指纹光油。
- B 表面氟碳烤漆标准色C-01, 面板下沉5mm, 面罩抗指纹光油。
- C 面板为软木, 下沉5mm, 画面采用图钉固定。
- D 文字丝网印刷白色。

B13

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

公告栏

工序负责

结构设计

外 加 工

五 金

喷 漆

标 识 A  
(有机类、型材、铝塑板)

丝 印

标 识 B  
(粘贴、打磨、包装)

光 电 源

合同项目


产品单价

产品数量

产品总价



中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

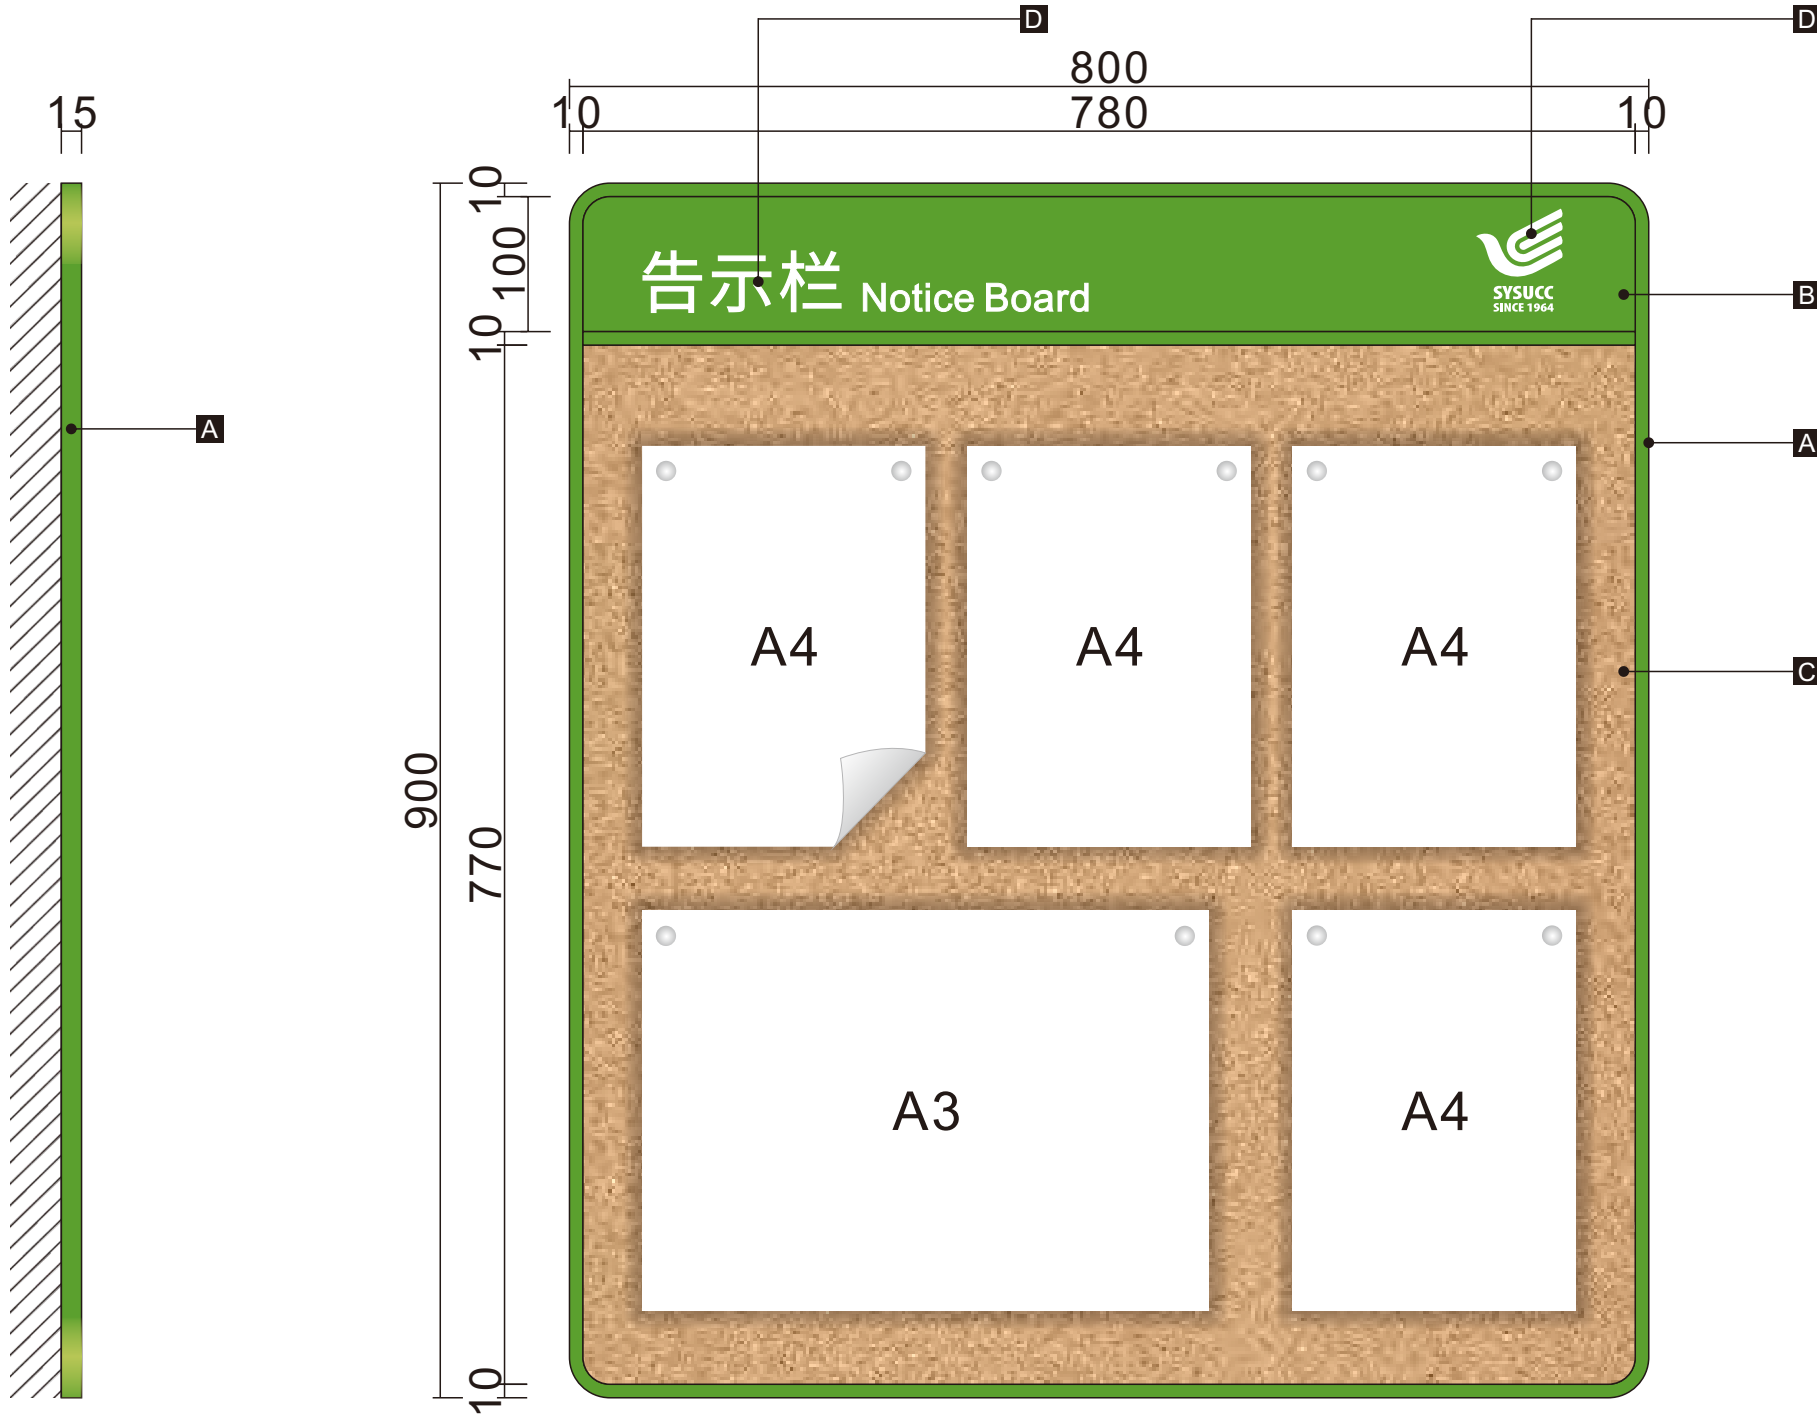

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

单位:mm

出图日期

设 计

使用科室审核

主管科室审核


主管处室审核

分管院长审核

完工日期

- 名称:B-30医护人员一览表
- 尺寸:如图
- 材质工艺:

- A厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型, 正面及侧面氟碳烤漆标准色C-01, 面罩抗指纹光油。
- B表面氟碳烤漆标准色C-01, 面板下沉10mm, 面罩抗指纹光油。
- C表面氟碳烤漆标准色B-01, 面板下沉10mm, 面罩抗指纹光油。
- D画面部分采用2mm机片背胶写真, 可弯曲卡入上下横档卡槽。
- E文字丝网印刷白色/标准色C-01。
- F表面氟碳烤漆标准色A-01, 面板下沉10mm, 面罩抗指纹光油。

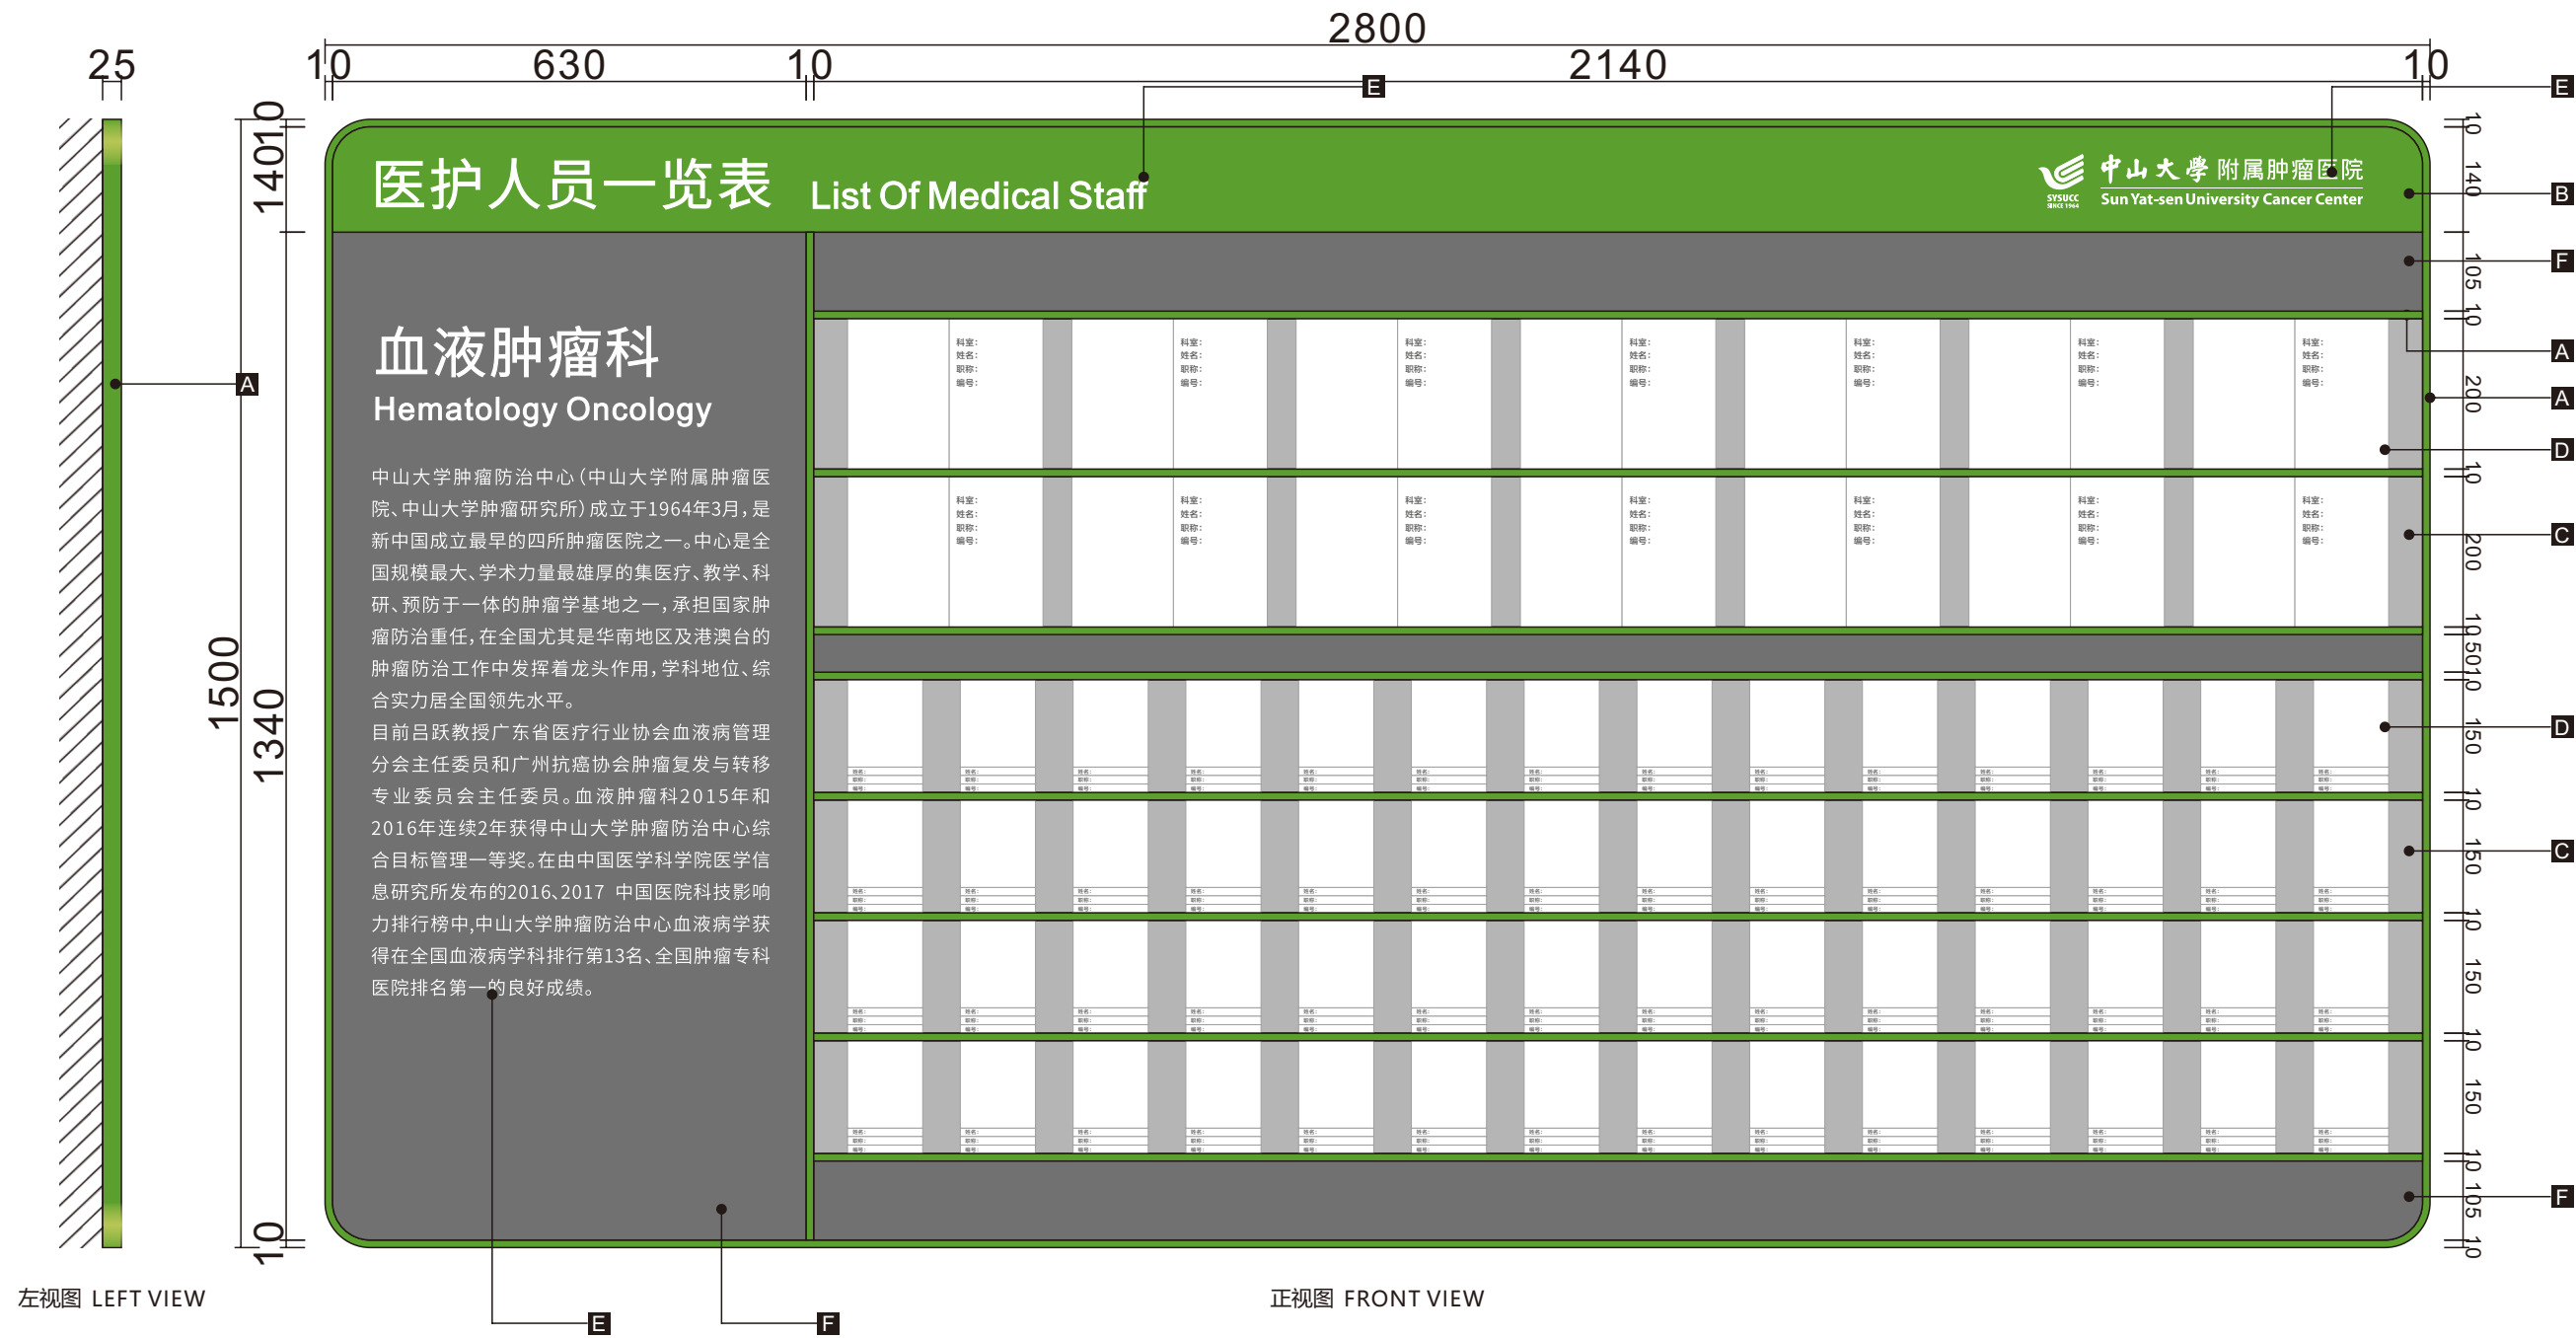

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸：500\*800mm  
工艺：1.2mm厚度304不锈钢刨槽折弯造型烤漆边框，打印内容部分；8mm亚克力夹画形式放置内容，内容可单独更换；  
数量：15件



SYSUCC  
SINCE 1964

# 共建清廉医院

# 维护患者权益

尊敬的患者朋友：

我院高度重视行风建设，如果您在候诊看病期间发现以下情况或行为，欢迎咨询或举报。

陌生人（医托）或医生进行虚假宣传并引诱您

- ✗ 到指定药店购买药品
- ✗ 到院外机构检验检查（基因检测、PET-CT/MR等）
- ✗ 到院外其他医疗机构住院
- ✗ 私下通过刷卡、转账等形式支付诊疗费用

为避免您的损失，请勿经第三方平台挂号或缴费！

我院官方挂号、缴费平台：



中山大学附属肿瘤医院  
微信小程序



中肿掌上就医  
手机APP

举报电话

医务办公室：020-87341224  
纪委办（监察室）：020-87342190



中山大学附属肿瘤医院黄埔院区

| 标识设计·方案                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 制作单号                                                                                                                                                                                   | B15          |
| 项目名称                                                                                                                                                                                   | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称                                                                                                                                                                                   | 流程制度牌        |
| 工序负责                                                                                                                                                                                   |              |
| 结构设计                                                                                                                                                                                   |              |
| 外加工                                                                                                                                                                                    |              |
| 五金                                                                                                                                                                                     |              |
| 喷漆                                                                                                                                                                                     |              |
| 标识A                                                                                                                                                                                    | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印                                                                                                                                                                                     |              |
| 标识B                                                                                                                                                                                    | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源                                                                                                                                                                                    |              |
| 合同项目                                                                                                                                                                                   |              |
| 产品单价                                                                                                                                                                                   |              |
| 产品数量                                                                                                                                                                                   |              |
| 产品总价                                                                                                                                                                                   |              |
| <div><p>SYSUCC<br/>SINCE 1964</p><p>中山大学附属肿瘤医院<br/>Sun Yat-sen University Cancer Center</p></div> |              |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|



- 名称:床头牌
- 尺寸:250\*169\*8mm
- 材质工艺:

A 厚2.0mmGB304#不锈钢切割围边,打磨平整,氟碳烤漆标准色B-01,面罩抗指纹光油。


B 厚3mm有机玻璃切割,喷漆白色,内容丝网印刷,制作插条,可从右侧抽出。

C 面板下沉2mm,烤漆标准色E-01,面罩抗指纹光油。

D 滑动卡条。

E 内容丝网印刷。

F 面板下沉2mm,烤漆标准色E-01,面罩抗指纹光油,内容丝网印刷。

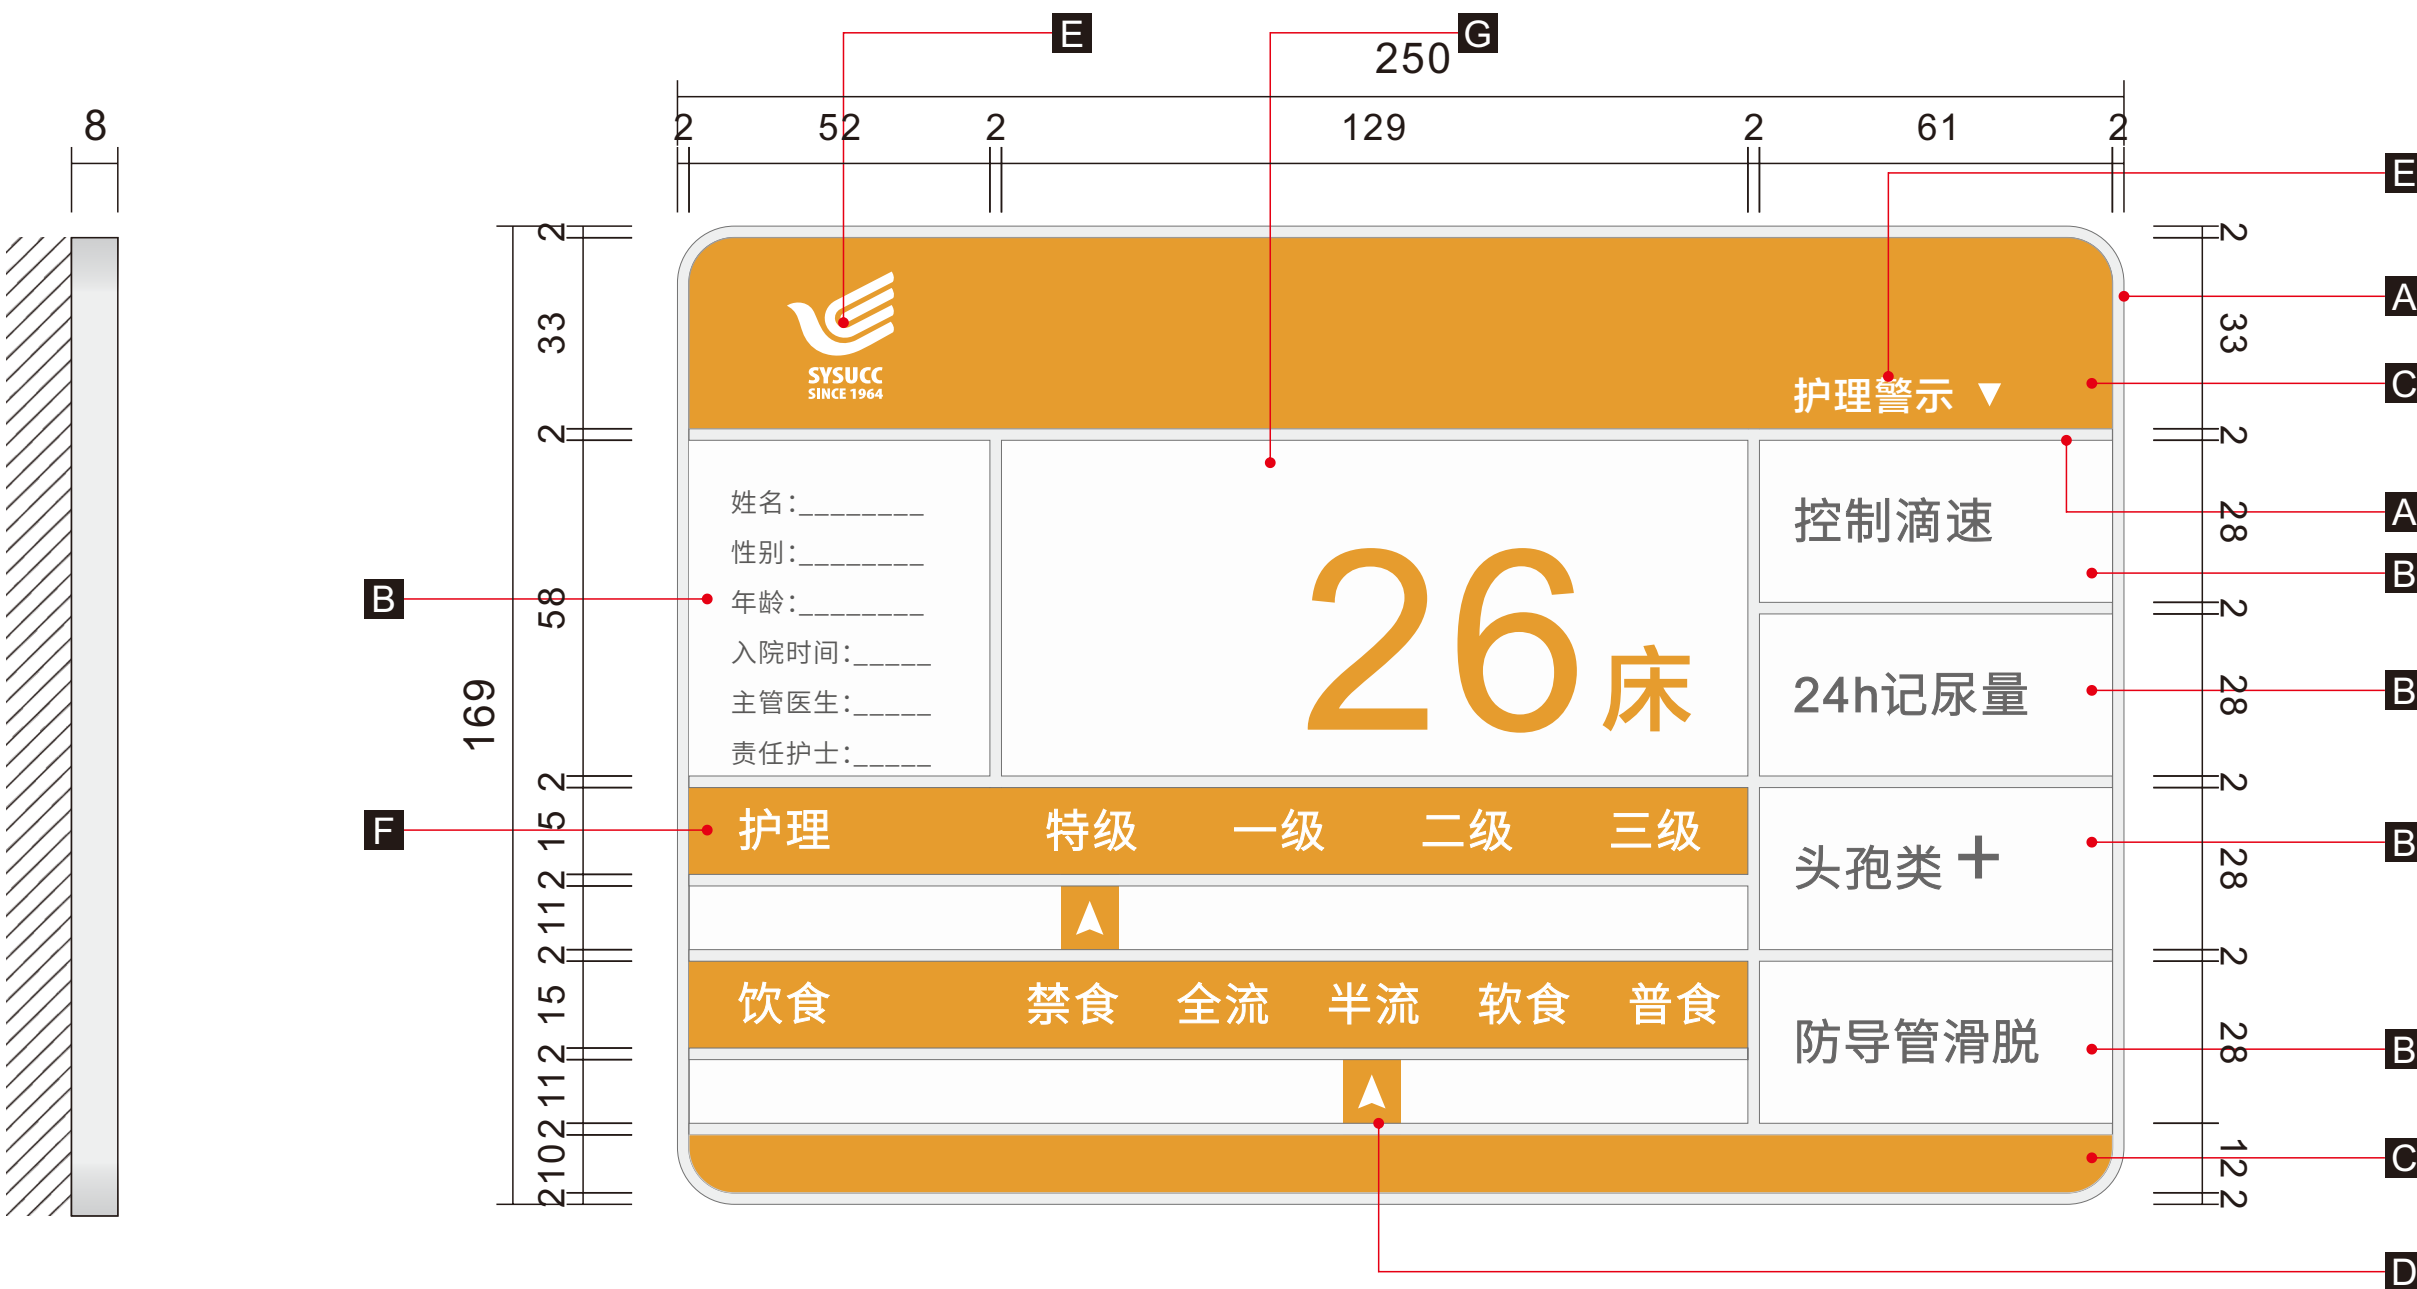

左视图 LEFT VIEW

正视图 FRONT VIEW

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期

尺寸:200\*450\*10mm

工艺:如图

A 厚1.2mmGB304#不锈钢包边焊制,氟碳烤漆标准色B-01,面罩抗指纹光油。

B 整版画面厚8mm透明有机玻璃背贴高精度写真画面。

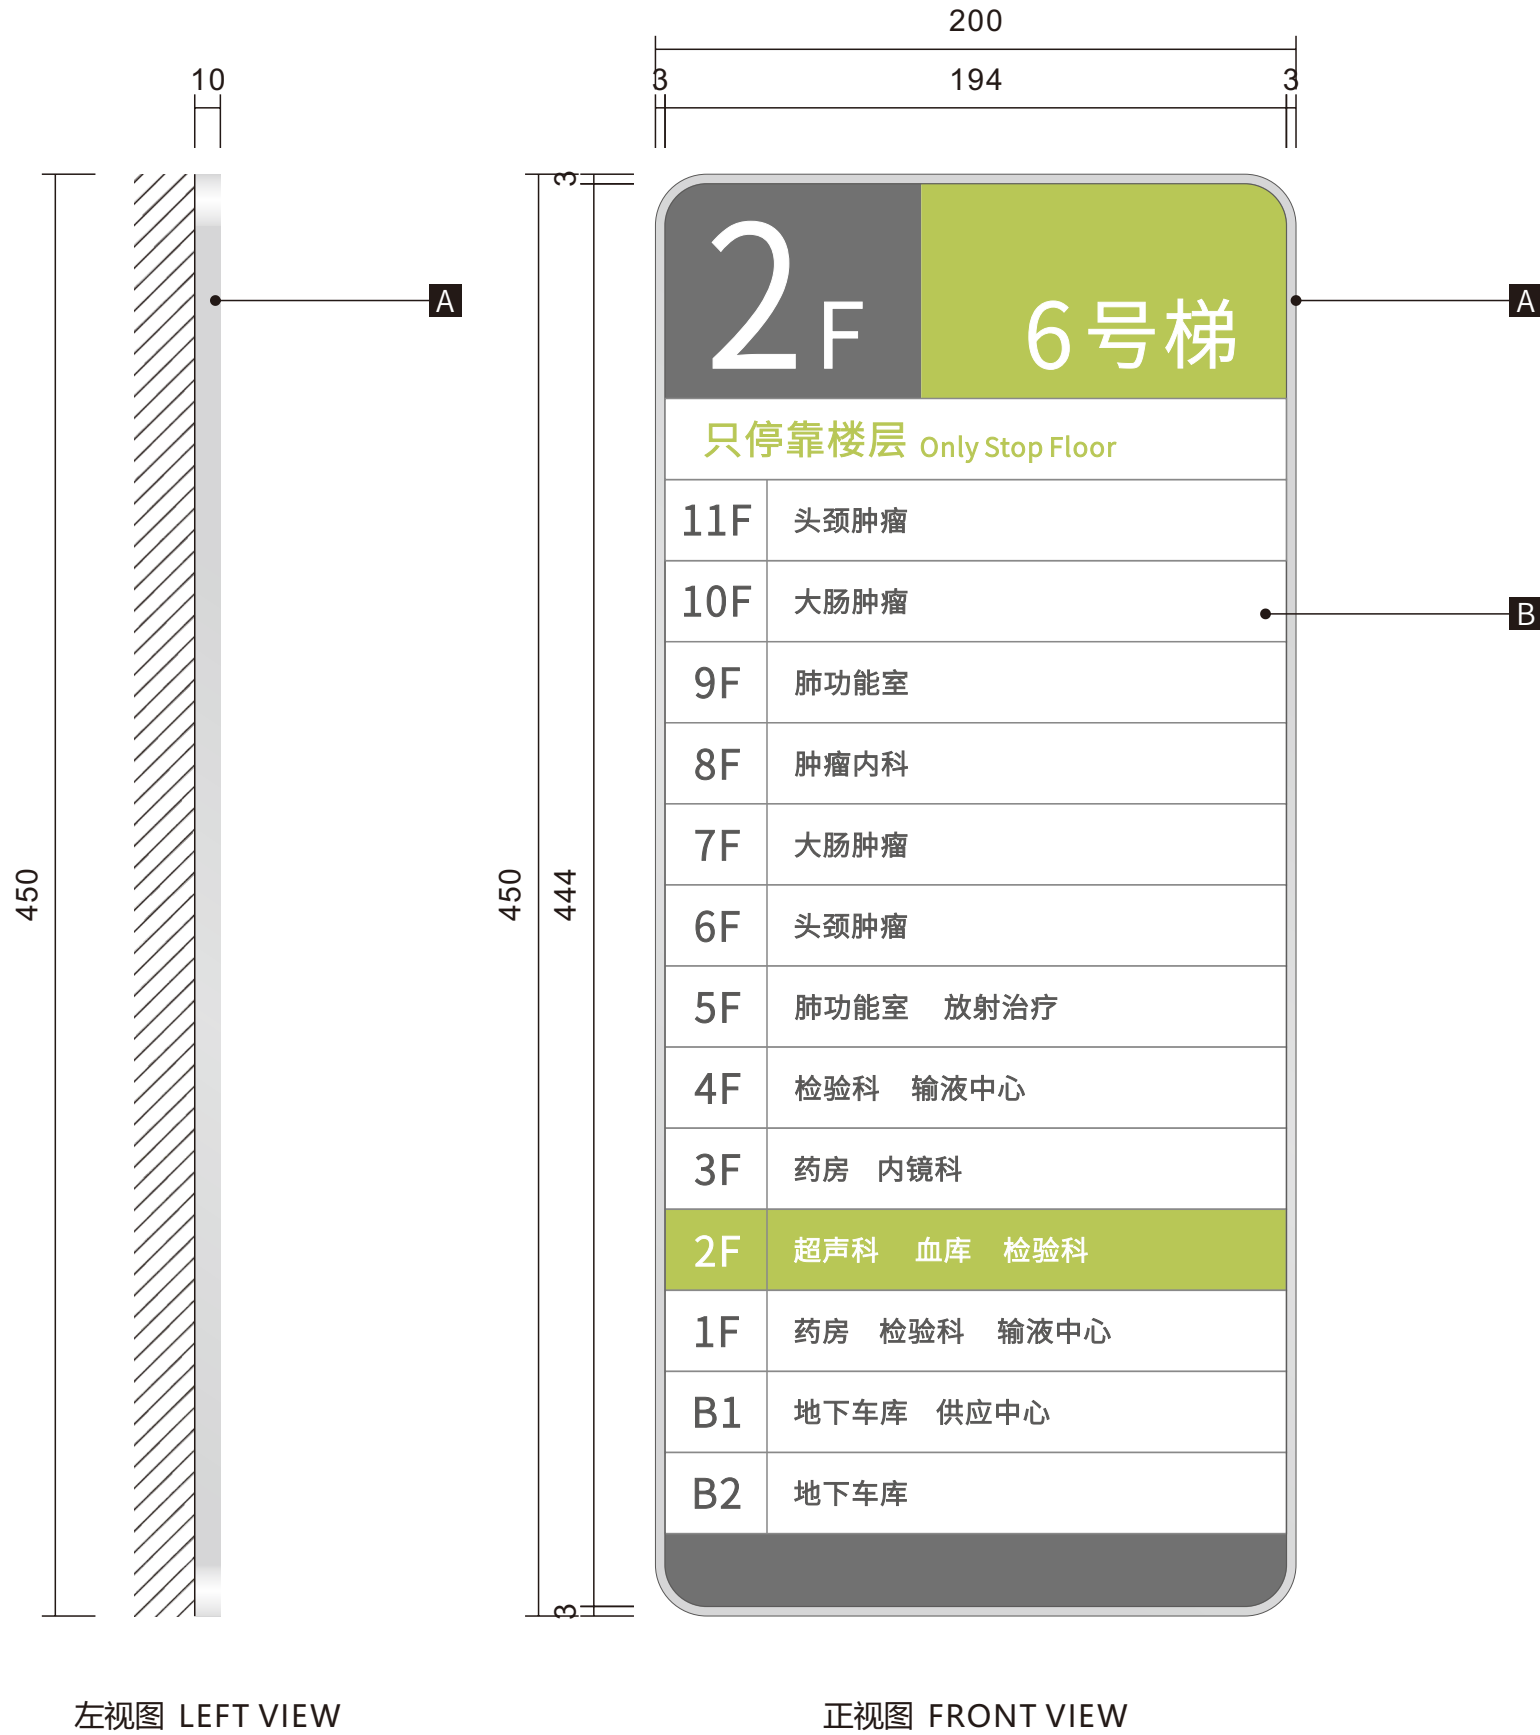

单位:mm

出图日期

设 计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:380\*80mm  
工艺:插条翻新,亚克力插条重新喷漆UV内容。  
数量:



| 标识设计·方案 |              |
|---------|--------------|
| 制作单号    | C1           |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称    | 翻新/更改        |
| 工序负责    |              |
| 结构设计    |              |
| 外加工     |              |
| 五金      |              |
| 喷漆      |              |
| 标识A     | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印      |              |
| 标识B     | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源     |              |
| 合同项目    |              |
| 产品单价    |              |
| 产品数量    |              |
| 产品总价    |              |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|



尺寸:150\*50\*1mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:1mm厚度亚克力雕刻,水条类产品,正、反面印刷内容(材料厚度根据需求指定)

数量:



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:150\*50\*2mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:2mm厚度亚克力雕刻,水条类产品,正、反面印刷内容(材料厚度根据需求指定)

数量:



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:150\*50\*3mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:3mm厚度亚克力雕刻,水条类产品,正、反面印刷内容(材料厚度根据需求指定)

数量:



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



尺寸:150\*50\*5mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:5mm厚度亚克力雕刻,水条类产品,正、反面印刷内容(材料厚度根据需求指定)

数量:



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期

尺寸:120\*45\*1mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:1mm厚度亚克力的雕刻,背含磁板(镶嵌磁粒)的水条类产品,正、反面印刷内容  
(材料厚度根据需求指定)

数量:

底板2mm透明亚克力激光开孔

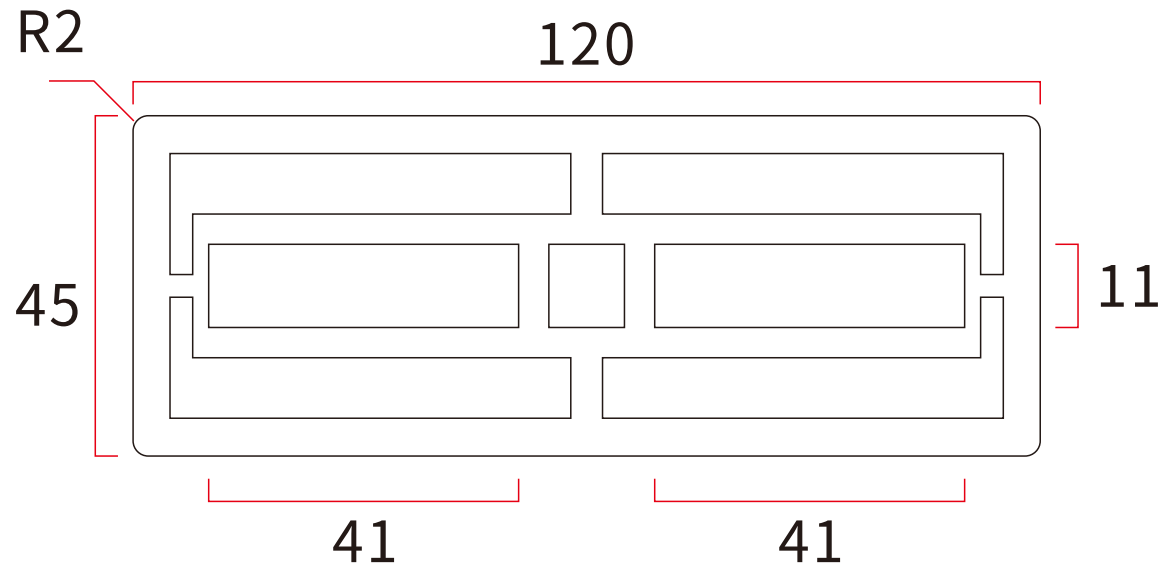

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:120\*45\*2mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:2mm厚度亚克力的雕刻,背含磁板(镶嵌磁粒)的水条类产品,正、反面印刷内容  
(材料厚度根据需求指定)

数量:

底板2mm透明亚克力激光开孔

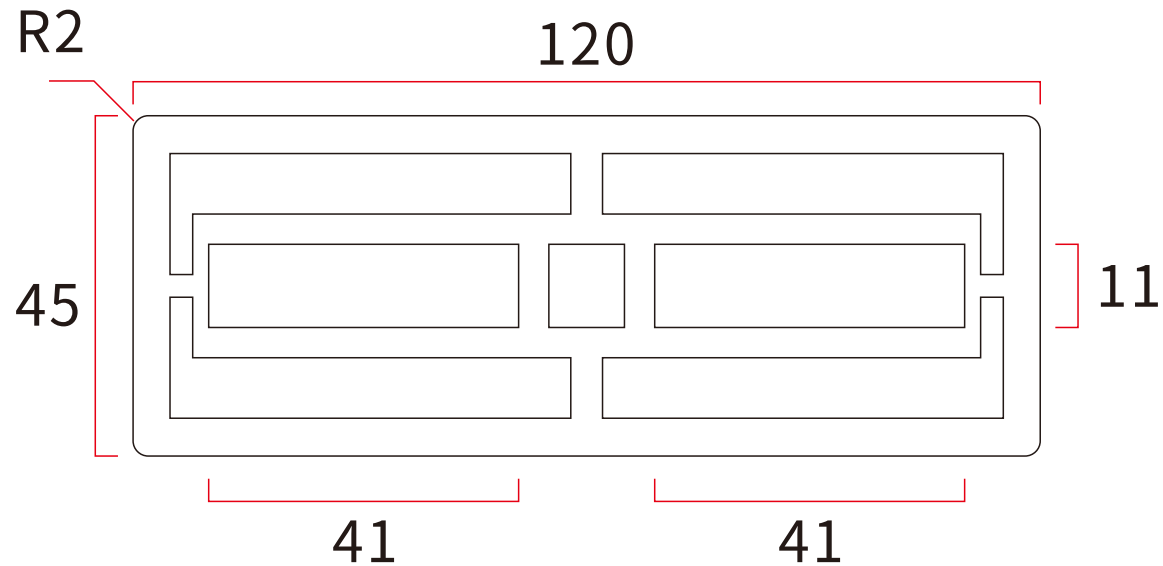

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:120\*45\*3mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:3mm厚度亚克力的雕刻,背含磁板(镶嵌磁粒)的水条类产品,正、反面印刷内容  
(材料厚度根据需求指定)

数量:

底板2mm透明亚克力激光开孔

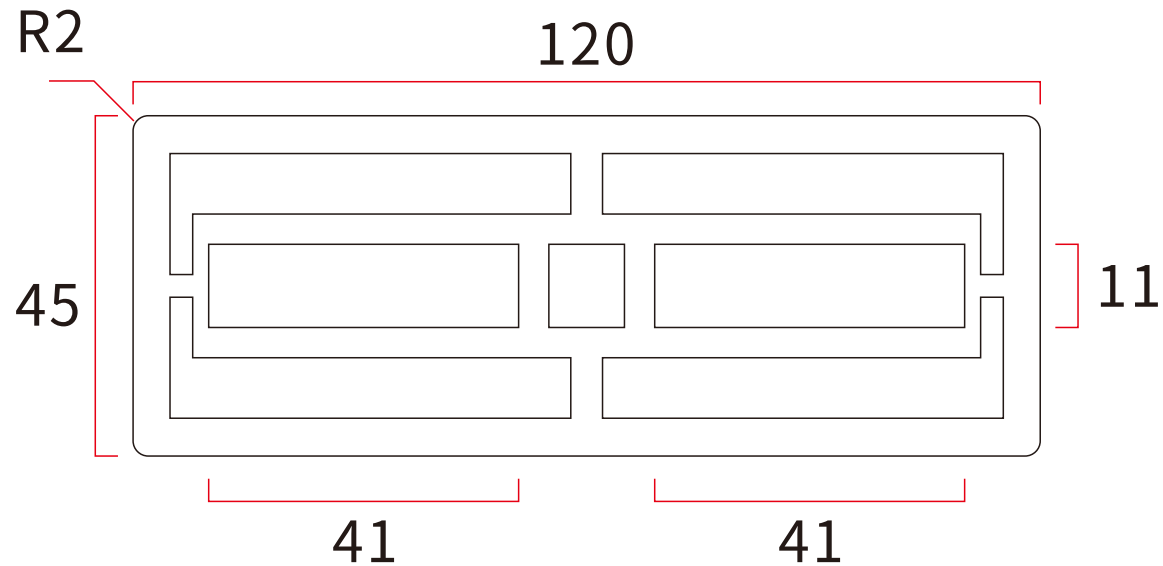

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:120\*45\*5mm(尺寸根据产品需求调整)

工艺:5mm厚度亚克力的雕刻,背含磁板(镶嵌磁粒)的水条类产品,正、反面印刷内容  
(材料厚度根据需求指定)

数量:

底板2mm透明亚克力激光开孔

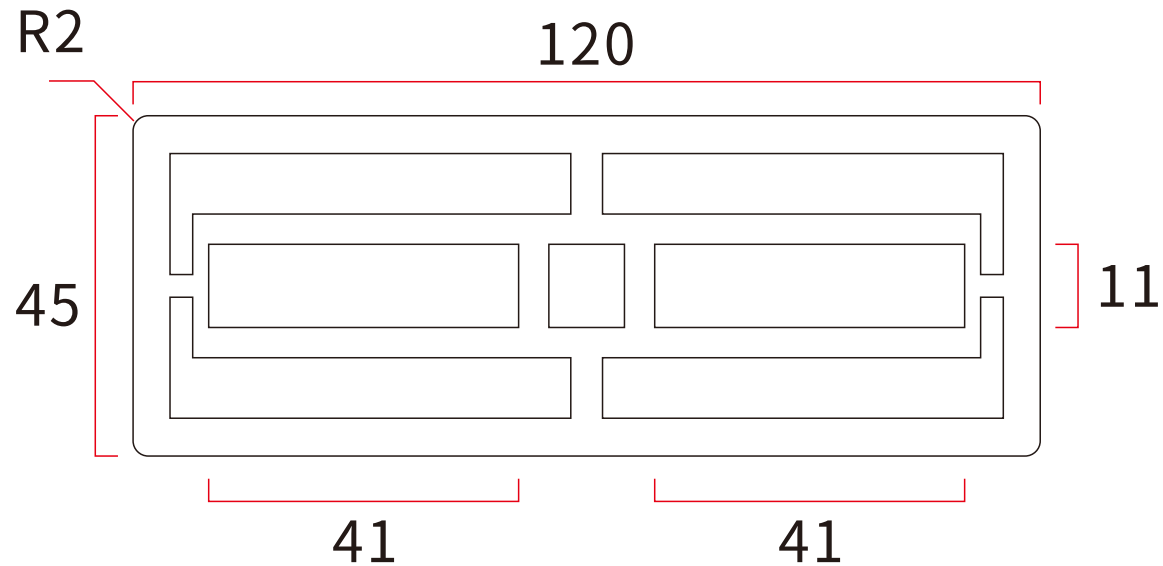

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

尺寸:210\*320\*1mm(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:1mm亚克力喷漆白色,内容正面UV,背带3M胶。  
数量:






尺寸:210\*320\*2mm(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:2mm亚克力喷漆白色,内容正面UV,背带3M胶。  
数量:



尺寸:210\*320\*5mm(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:5mm亚克力喷漆白色,内容正面UV,背带3M胶。  
数量:






尺寸:如图(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:3mm厚度亚克力雕刻,刻型,表面喷漆所需颜色。  
安装方式:玻璃胶组合粘贴。

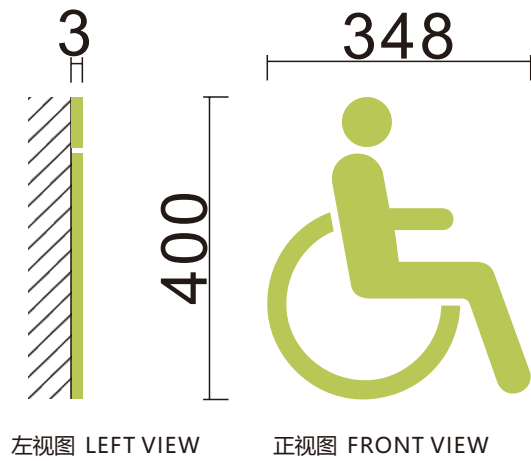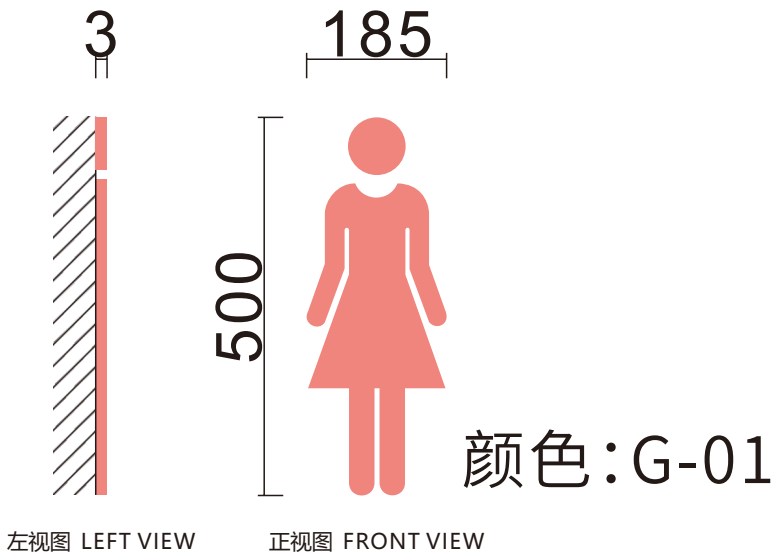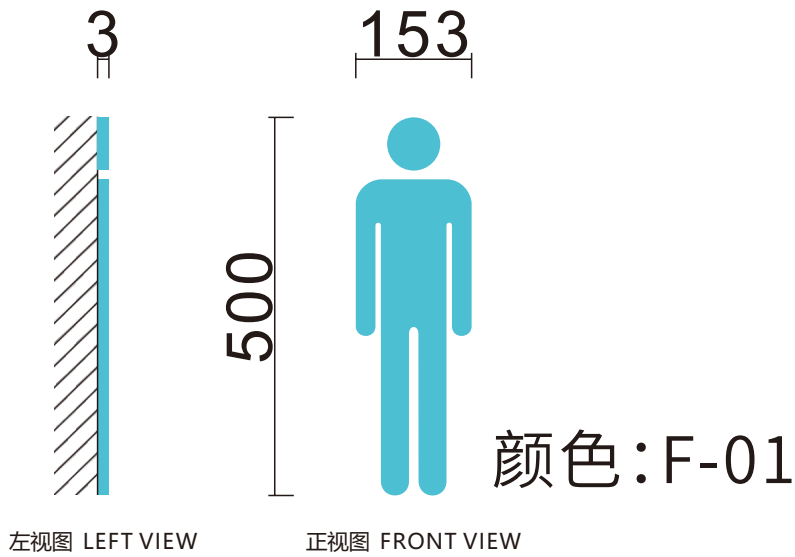

| 标识设计·方案 |               |
|---------|---------------|
| 制作单号    | C5-1          |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院      |
| 图纸名称    | 刻字、刻造型标识(单双层) |
| 工序负责    | 结构设计          |
| 外加工     |               |
| 五金      |               |
| 喷漆      |               |
| 标识 A    | (有机类、型材、铝塑板)  |
| 丝印      |               |
| 标识 B    | (粘贴、打磨、包装)    |
| 光电源     |               |
| 合同项目    |               |
| 产品单价    |               |
| 产品数量    |               |
| 产品总价    |               |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|




尺寸:如图(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:5mm厚度亚克力雕刻,刻型,表面喷漆所需颜色。  
安装方式:玻璃胶组合粘贴。

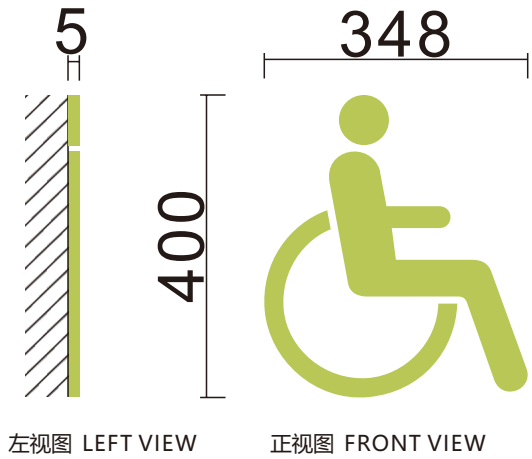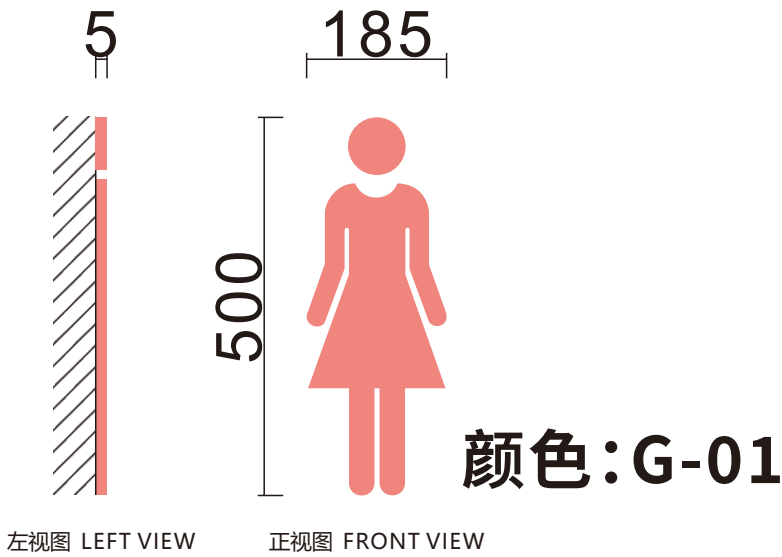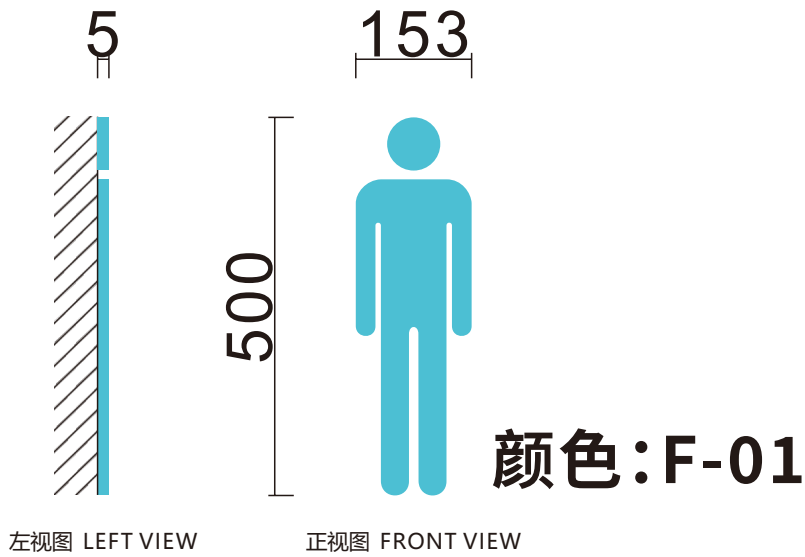

| 标识设计·方案 |                     |
|---------|---------------------|
| 制作单号    | C5-2                |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院            |
| 图纸名称    | 刻字、刻造型标识(单双层)       |
| 工序负责    | 结构设计                |
| 外加工     | 五金                  |
| 喷漆      | 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印      | 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源     |                     |
| 合同项目    |                     |
| 产品单价    |                     |
| 产品数量    |                     |
| 产品总价    |                     |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

尺寸:如图(尺寸根据产品需求调整)  
工艺:8mm厚度亚克力雕刻,刻型,表面喷漆所需颜色。  
安装方式:玻璃胶组合粘贴。

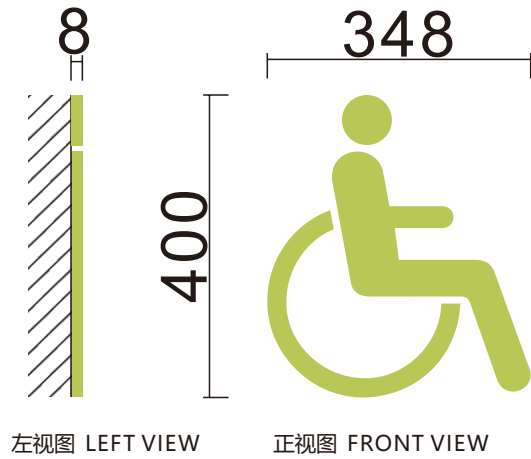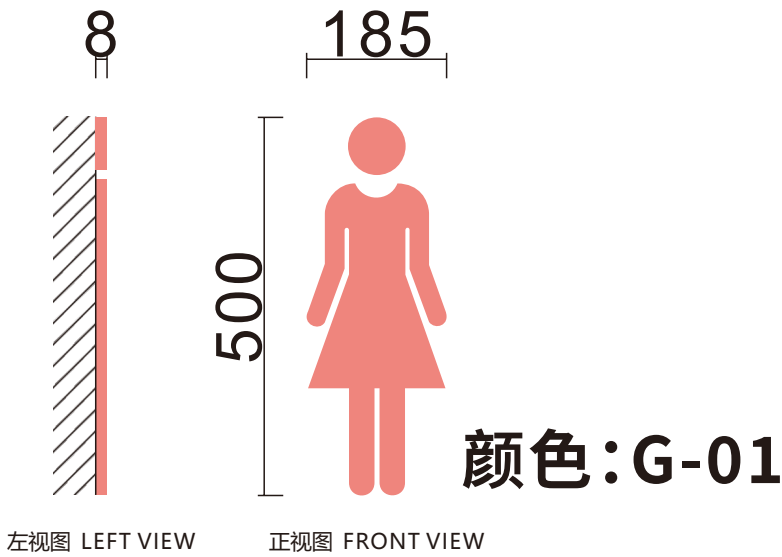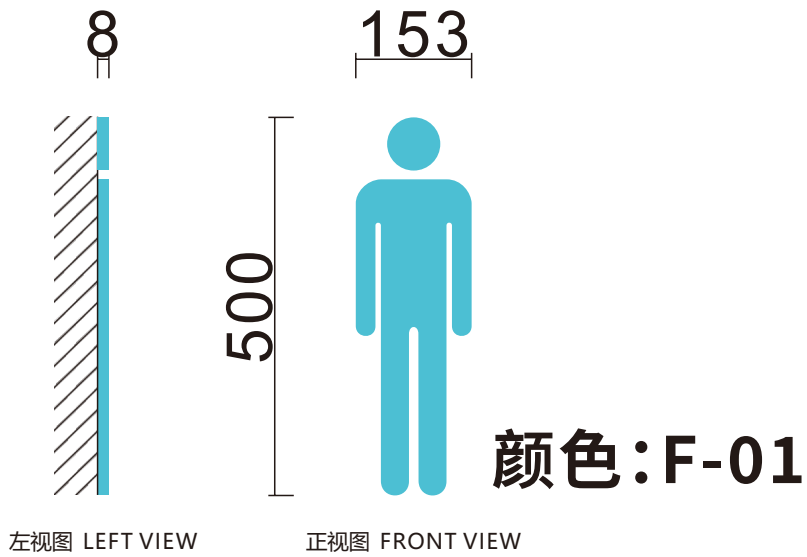


| 标识设计·方案 |               |
|---------|---------------|
| 制作单号    | C5-3          |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院      |
| 图纸名称    | 刻字、刻造型标识(单双层) |
| 工序负责    | 结构设计          |
| 外加工     |               |
| 五金      |               |
| 喷漆      |               |
| 标识 A    | (有机类、型材、铝塑板)  |
| 丝印      |               |
| 标识 B    | (粘贴、打磨、包装)    |
| 光电源     |               |
| 合同项目    |               |
| 产品单价    |               |
| 产品数量    |               |
| 产品总价    |               |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

尺寸:如图(尺寸根据产品需求调整)

工艺:厚1.2mmGB304#拉丝不锈钢焊制立体字,面罩抗指纹光油。

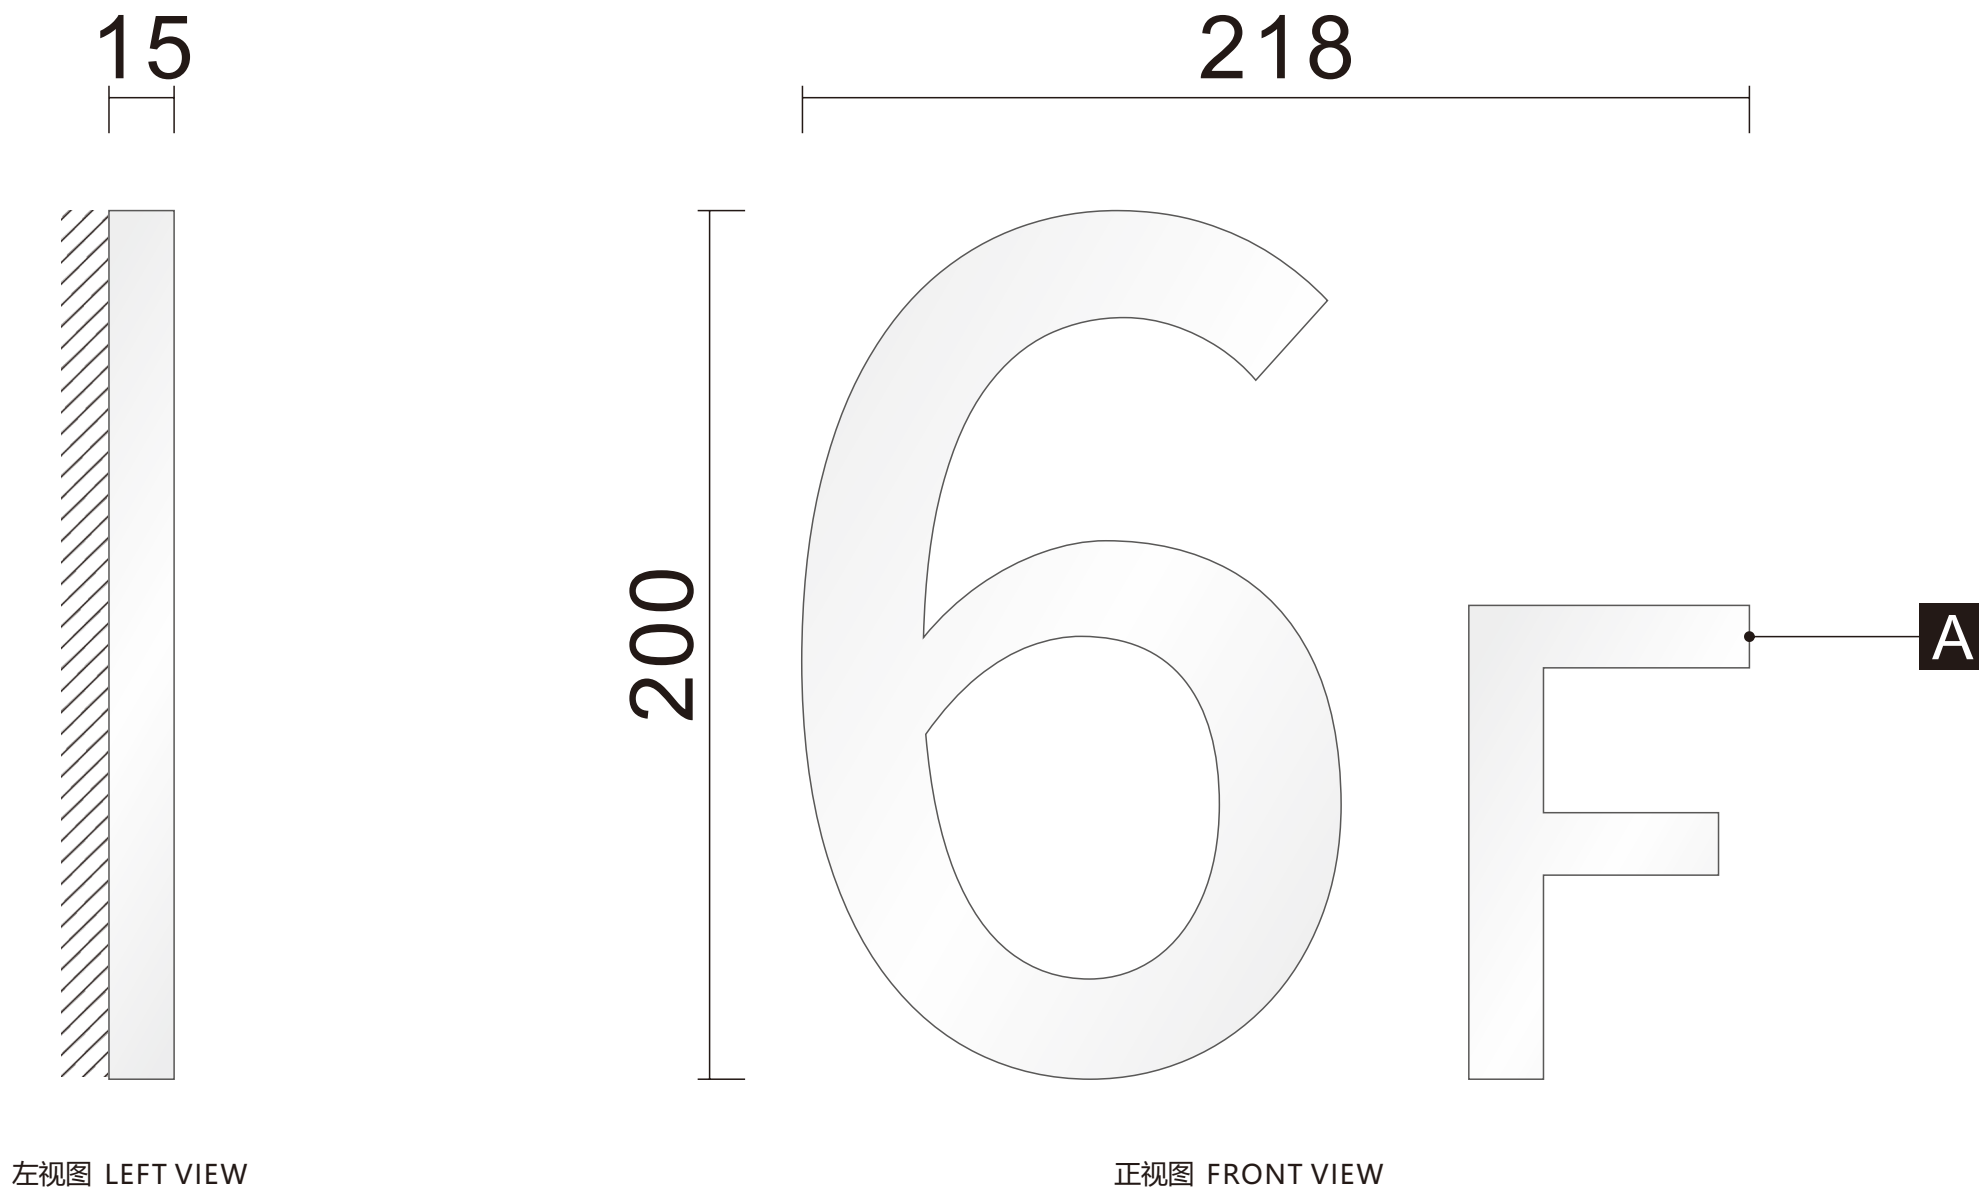

标识设计·方案

制作单号

C6

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

刻字、刻造型标识(单双层)

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识 A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识 B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center




名称：刻字、刻造型标识（单双层）  
尺寸：LOGO120\*120\*30MM/中文120\*510\*30MM/英文100\*1000\*30mm  
工艺：厚1.2mmGB304#不锈钢焊制背发光立体字，字体氟碳烤漆，  
面罩抗指纹光油，面板厚15mm，  
背拖15mm乳白色有机玻璃透光板，字体内置LED光源。


数量：

制作技术要求：

- 1、图标（1个）、中文（3个）高度120mm；
- 2、英文（11个）高度100 mm；
- 3、图标是正面亚克力UV，正面、背面发光，中英文字背面发光；
- 4、所有背面发光的产品，发光厚度不少于10mm厚度；
- 5、背面发光的产品发光位置不能够有阴影（连接螺栓位置除外）；
- 6、不锈钢壳跟亚克力连接位粘接一定要牢固，不能漏光，  
不锈钢字壳所有的焊接位不能漏光；
- 7、每一个中英文文字、图标只能出一条电线；背面发光产品光亮度，  
不能低于甲方提供的样品光亮度。

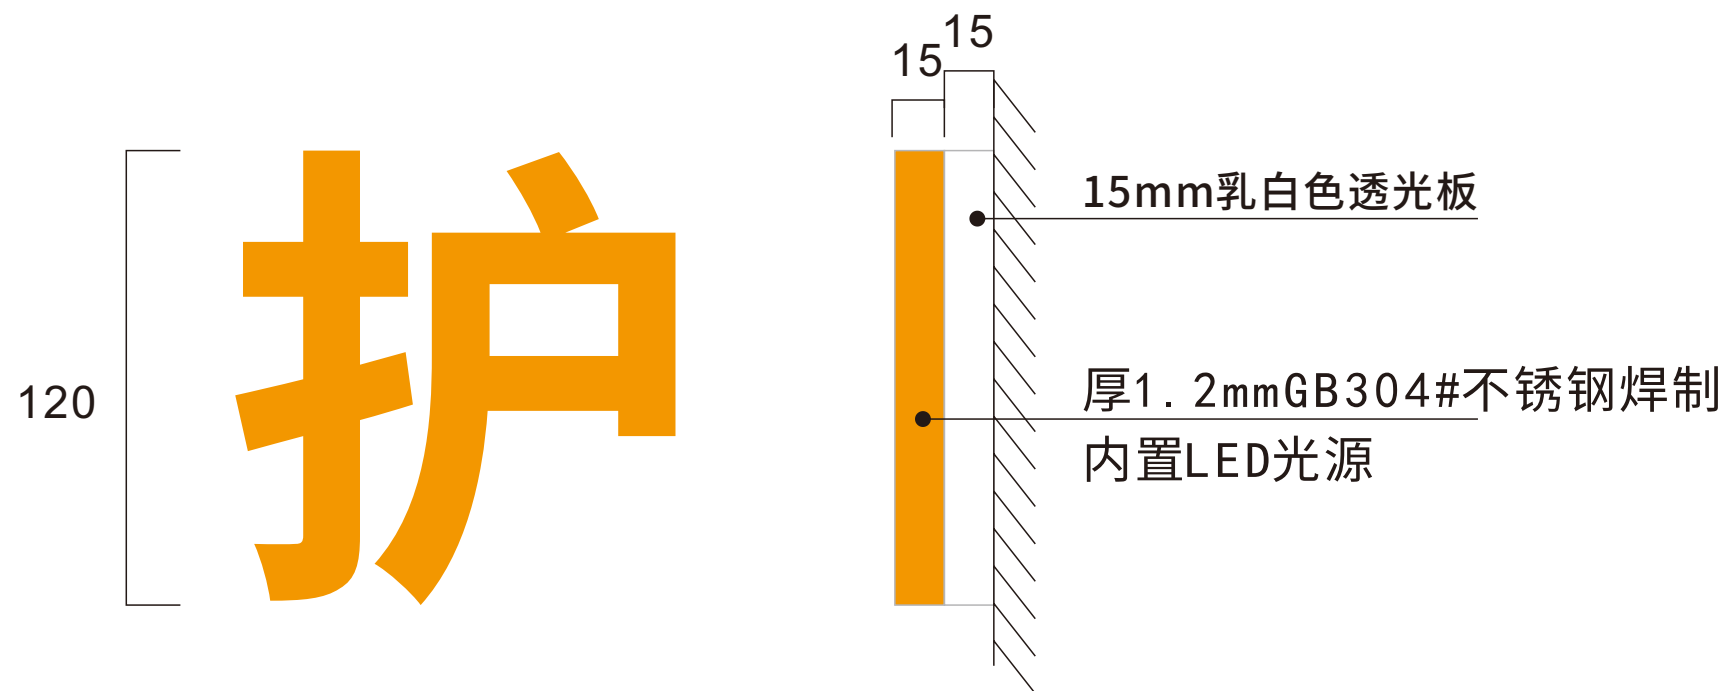

整圆做背发光，正面嵌入乳白透光亚克力正面发光  
内容正面UV。

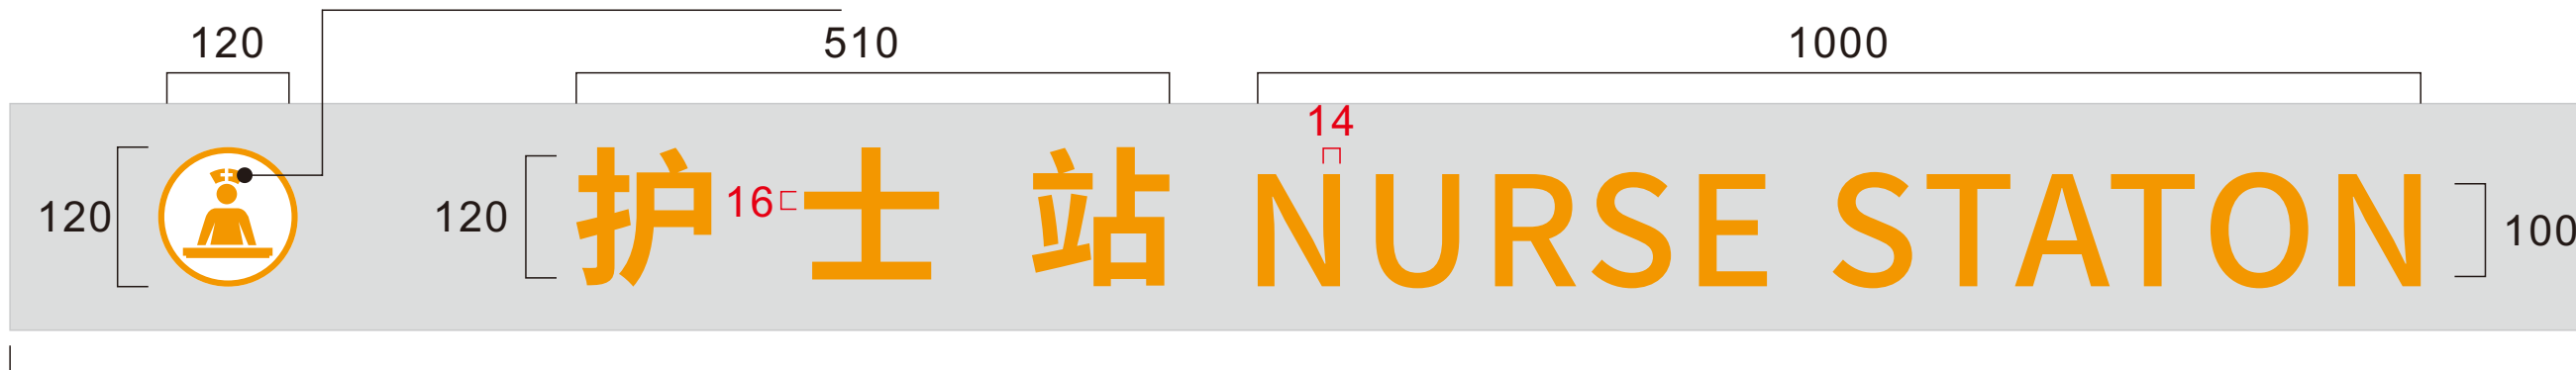

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核



主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

- 名称:圆形标识
- 尺寸:180\*180\*1mm
- 材质工艺:
  - A 厚1mm有机玻璃切割,周边倒圆边处理,喷漆标准色E-01,面罩抗指纹光油,文字内容丝网印刷。
  - 安装:贴墙安装

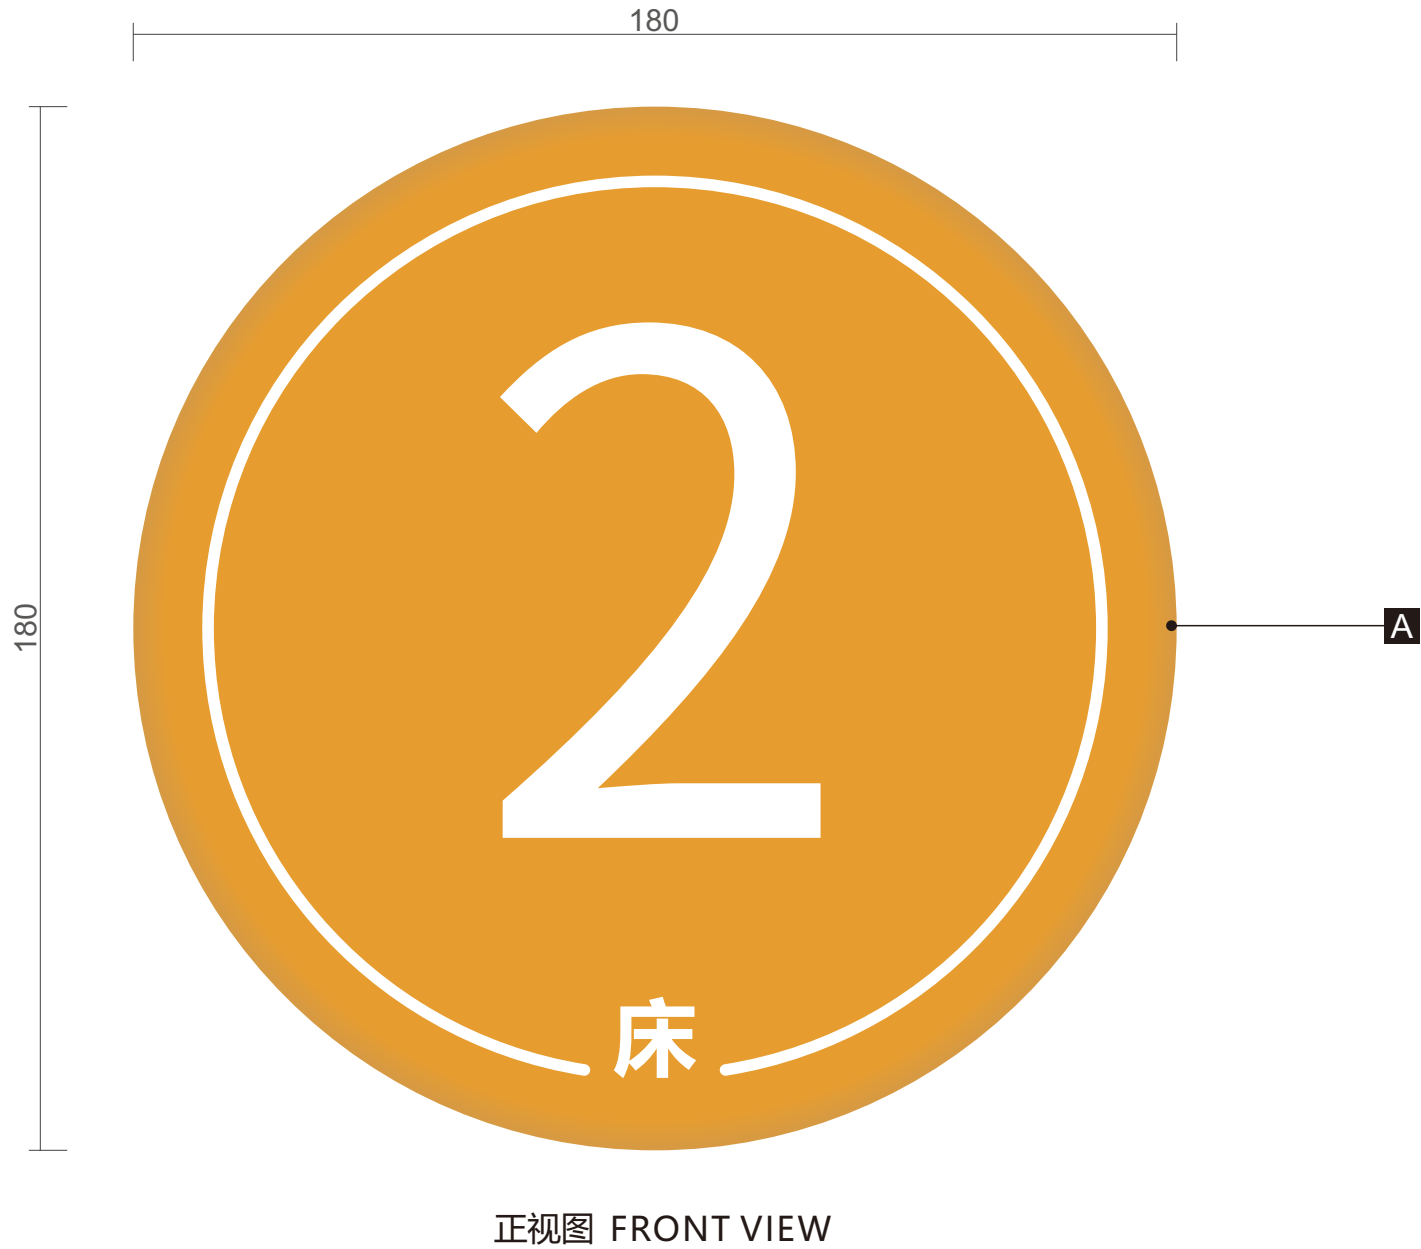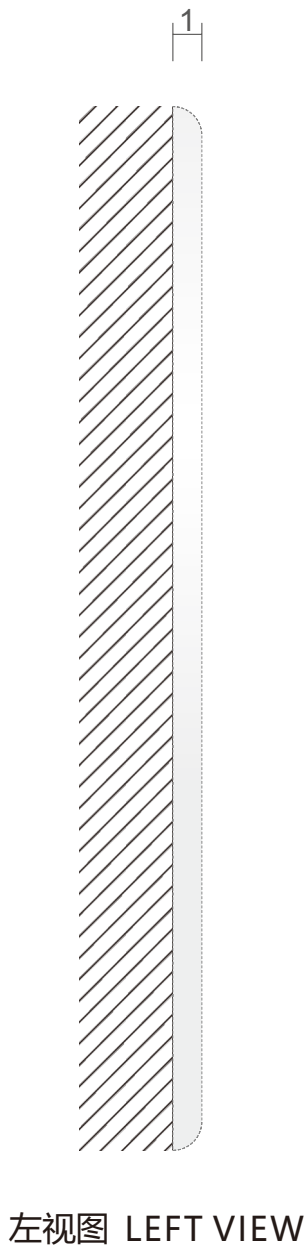

标识设计·方案

制作单号

C8-1

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

圆形标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A  
(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B  
(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目



产品单价

产品数量

产品总价

  
SYSUCC  
SINCE 1964  
中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

- 名称:圆形标识
- 尺寸:180\*180\*3mm
- 材质工艺:
  - A 厚3mm有机玻璃切割,周边倒圆边处理,喷漆标准色E-01,面罩抗指纹光油,文字内容丝网印刷。
  - 安装:贴墙安装

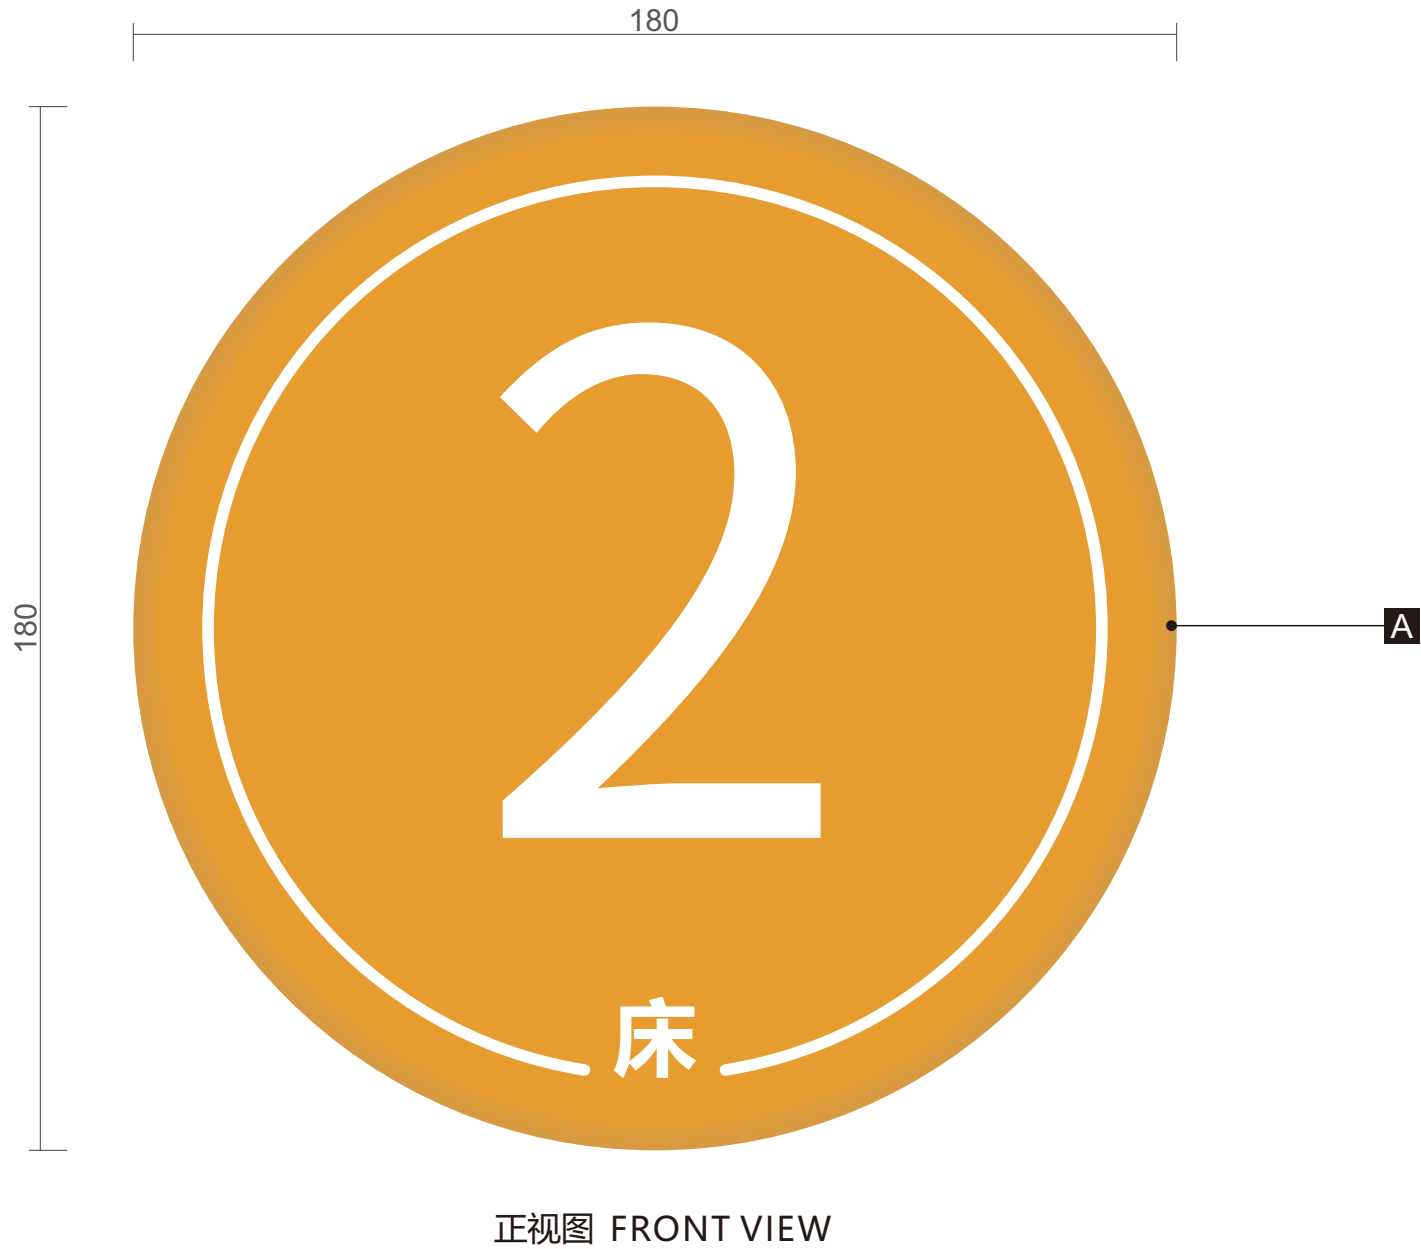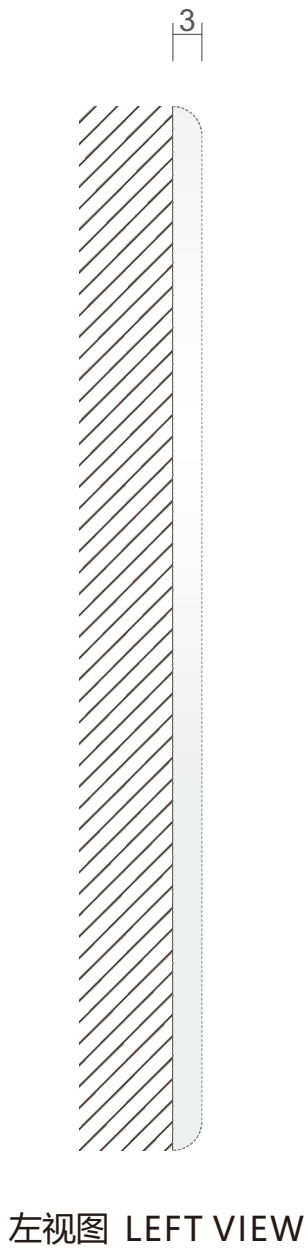

标识设计·方案

制作单号

C8-2

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

圆形标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识 A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识 B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目



产品单价

产品数量

产品总价

  
SYSUCC  
SINCE 1964  
中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

- 名称:圆形标识
- 尺寸:180\*180\*5mm
- 材质工艺:
  - A 厚5mm有机玻璃切割,周边倒圆边处理,喷漆标准色E-01,面罩抗指纹光油,文字内容丝网印刷。
  - 安装:贴墙安装

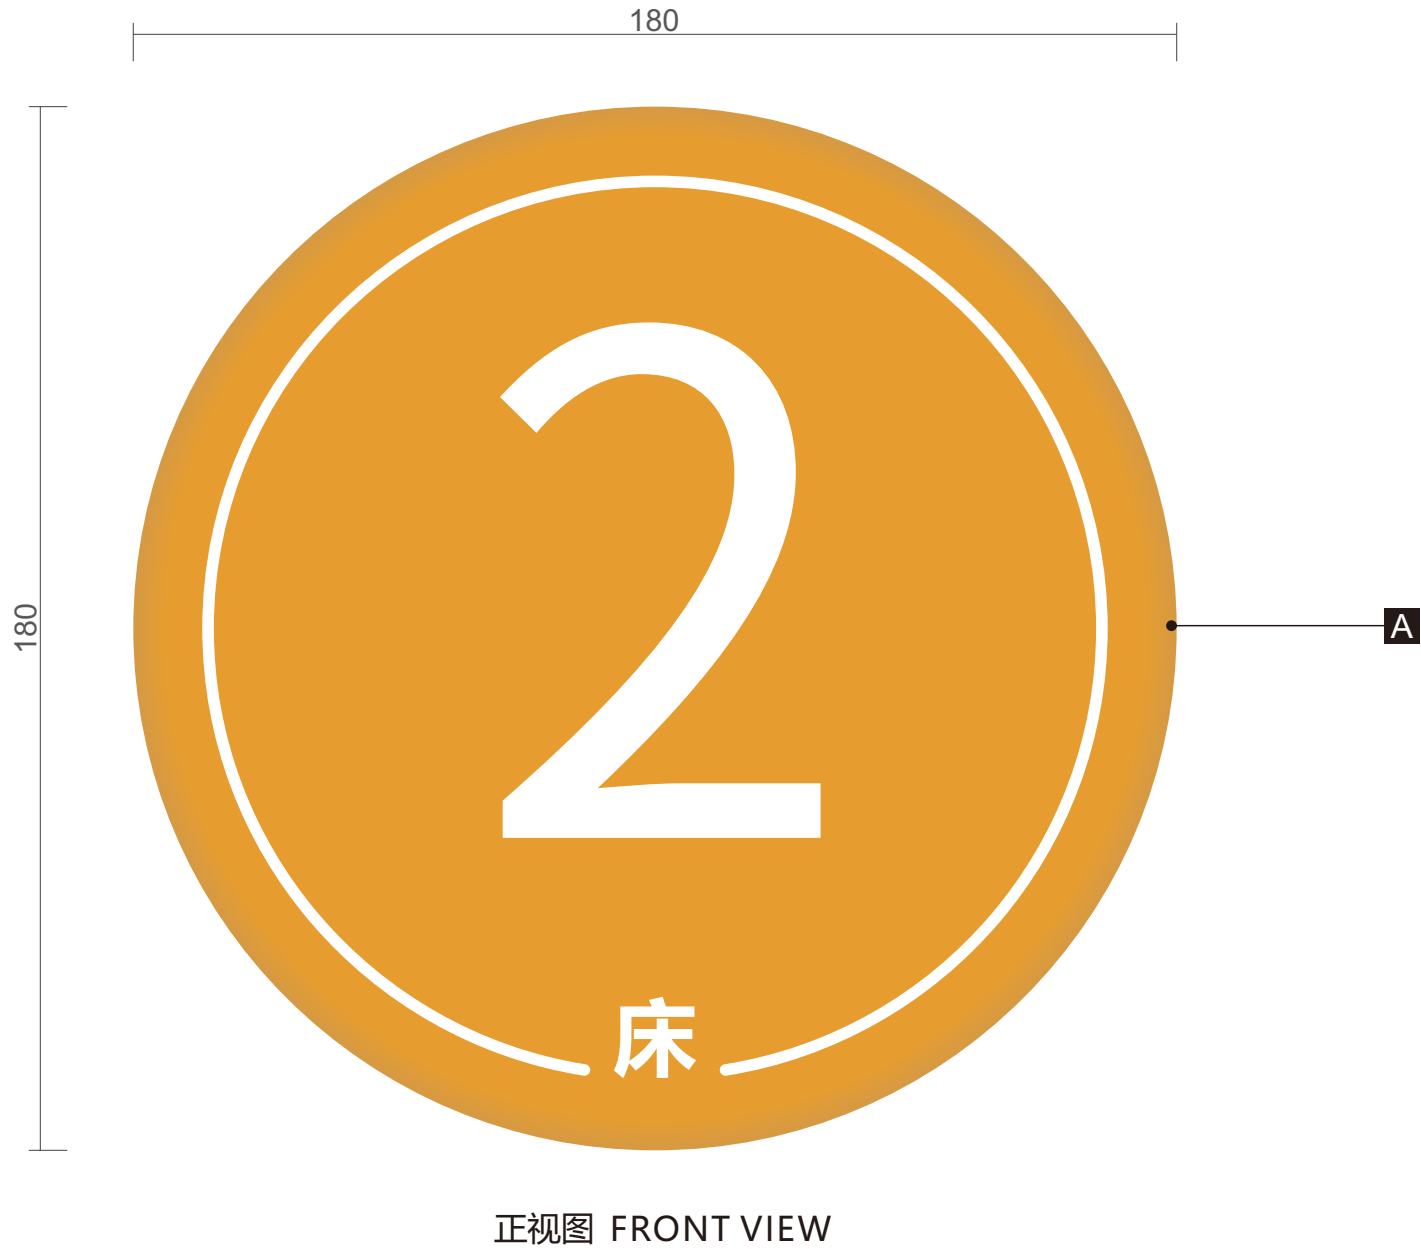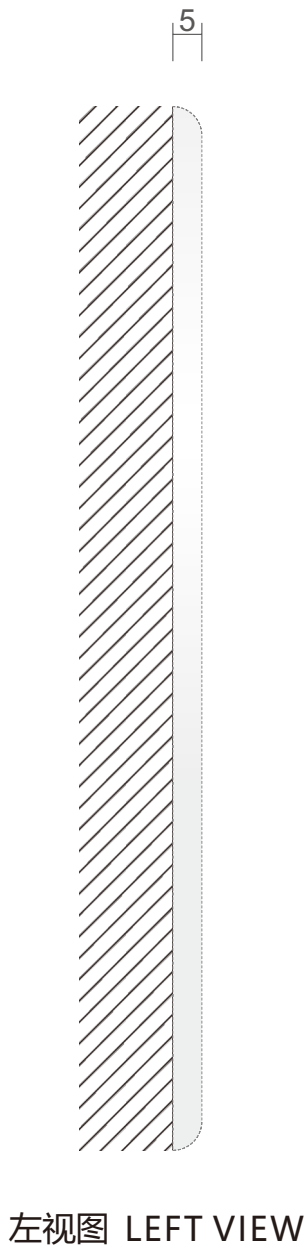

| 标识设计·方案 |              |
|---------|--------------|
| 制作单号    | C8-3         |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称    | 圆形标识         |
| 工序负责    | 结构设计         |
| 外加工     |              |
| 五金      |              |
| 喷漆      |              |
| 标识 A    | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印      |              |
| 标识 B    | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源     |              |
| 合同项目    |              |
| 产品单价    |              |
| 产品数量    |              |
| 产品总价    |              |


|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

名称：金属牌

尺寸：180\*180\*1mm

材质工艺：A.厚1mmGB304#拉丝不锈钢激光切割面板，文字内容丝网印刷，面罩抗指纹光油。

|                     |
|---------------------|
| 标识设计·方案             |
| 制作单号                |
| C9-1                |
| 项目名称                |
| 中大附属肿瘤医院            |
| 图纸名称                |
| 金属牌                 |
| 工序负责                |
| 结构设计                |
| 外加工                 |
| 五金                  |
| 喷漆                  |
| 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印                  |
| 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源                 |
| 合同项目                |
| 产品单价                |
| 产品数量                |
| 产品总价                |

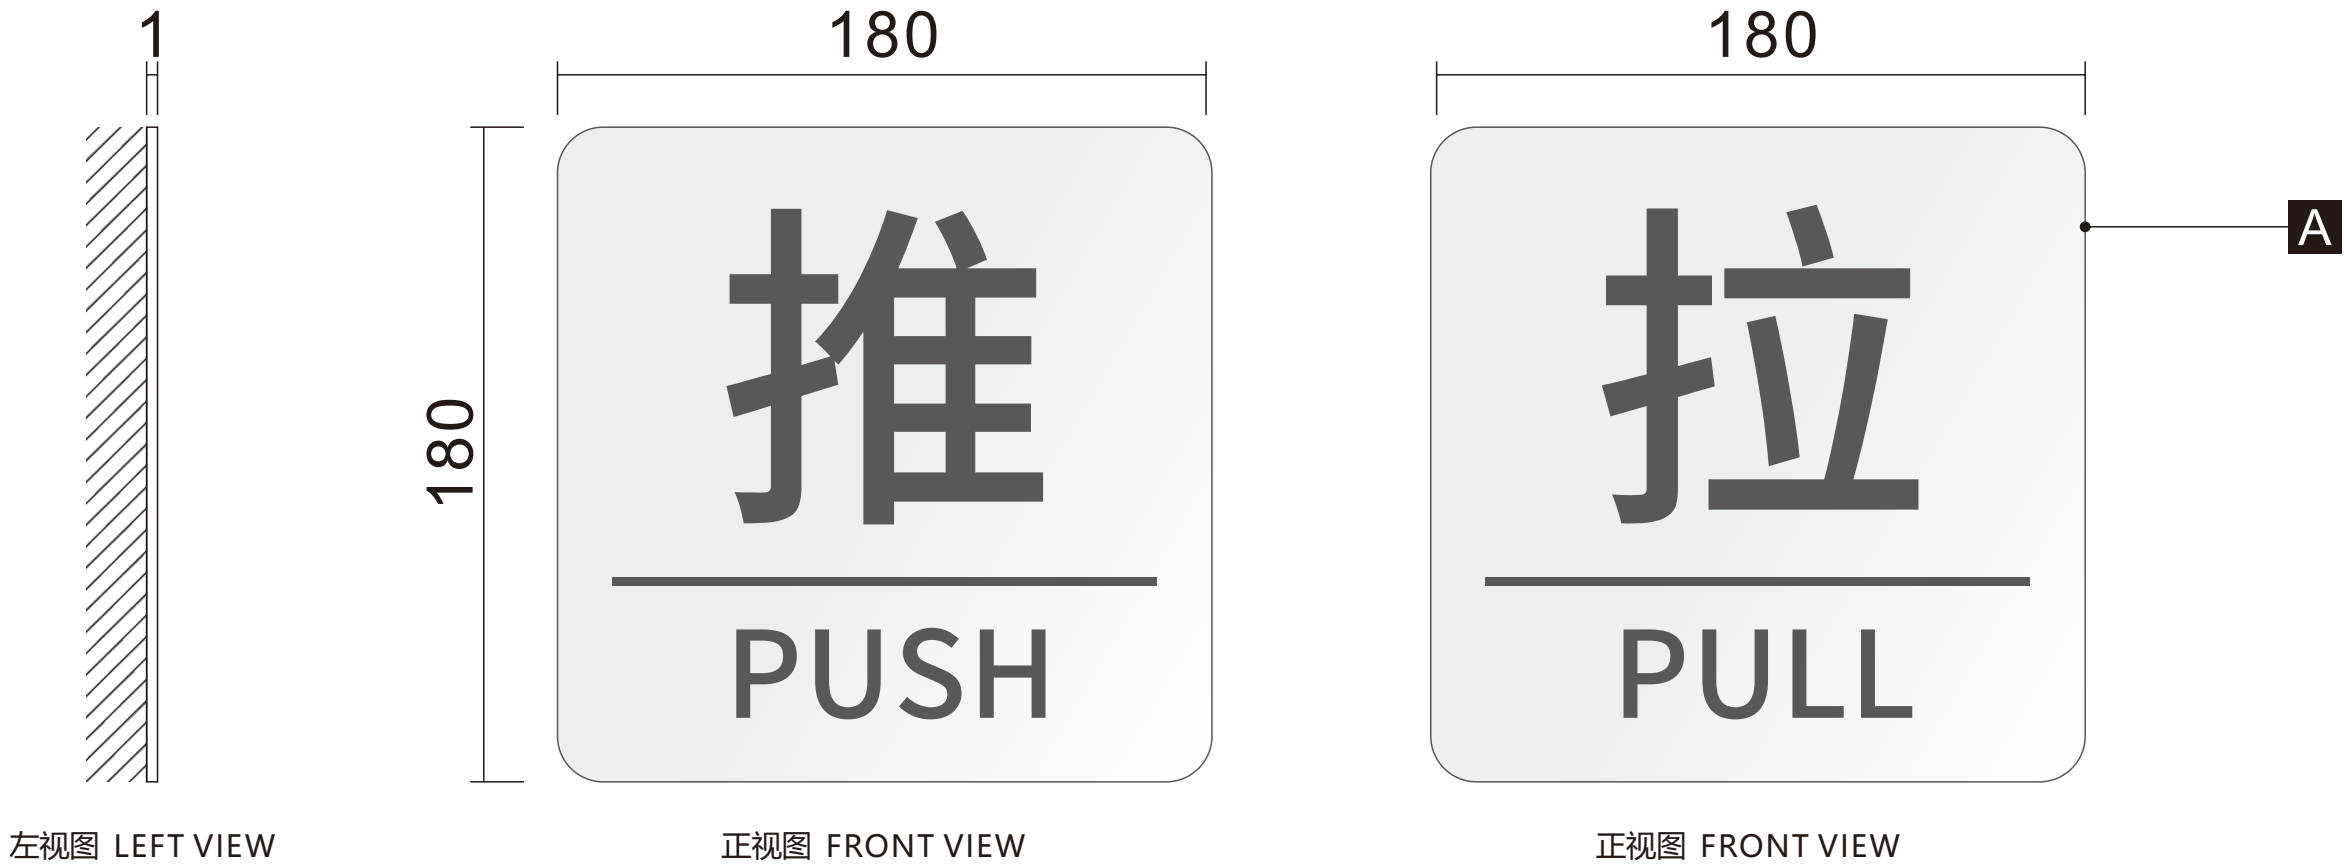

数量：


数量：

名称：金属牌

尺寸：180\*180\*2mm

材质工艺：A.厚2mmGB304#拉丝不锈钢激光切割面板，文字内容丝网印刷，面罩抗指纹光油。

|                     |
|---------------------|
| 标识设计·方案             |
| 制作单号                |
| C9-2                |
| 项目名称                |
| 中大附属肿瘤医院            |
| 图纸名称                |
| 金属牌                 |
| 工序负责                |
| 结构设计                |
| 外加工                 |
| 五金                  |
| 喷漆                  |
| 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印                  |
| 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源                 |
| 合同项目                |
| 产品单价                |
| 产品数量                |
| 产品总价                |

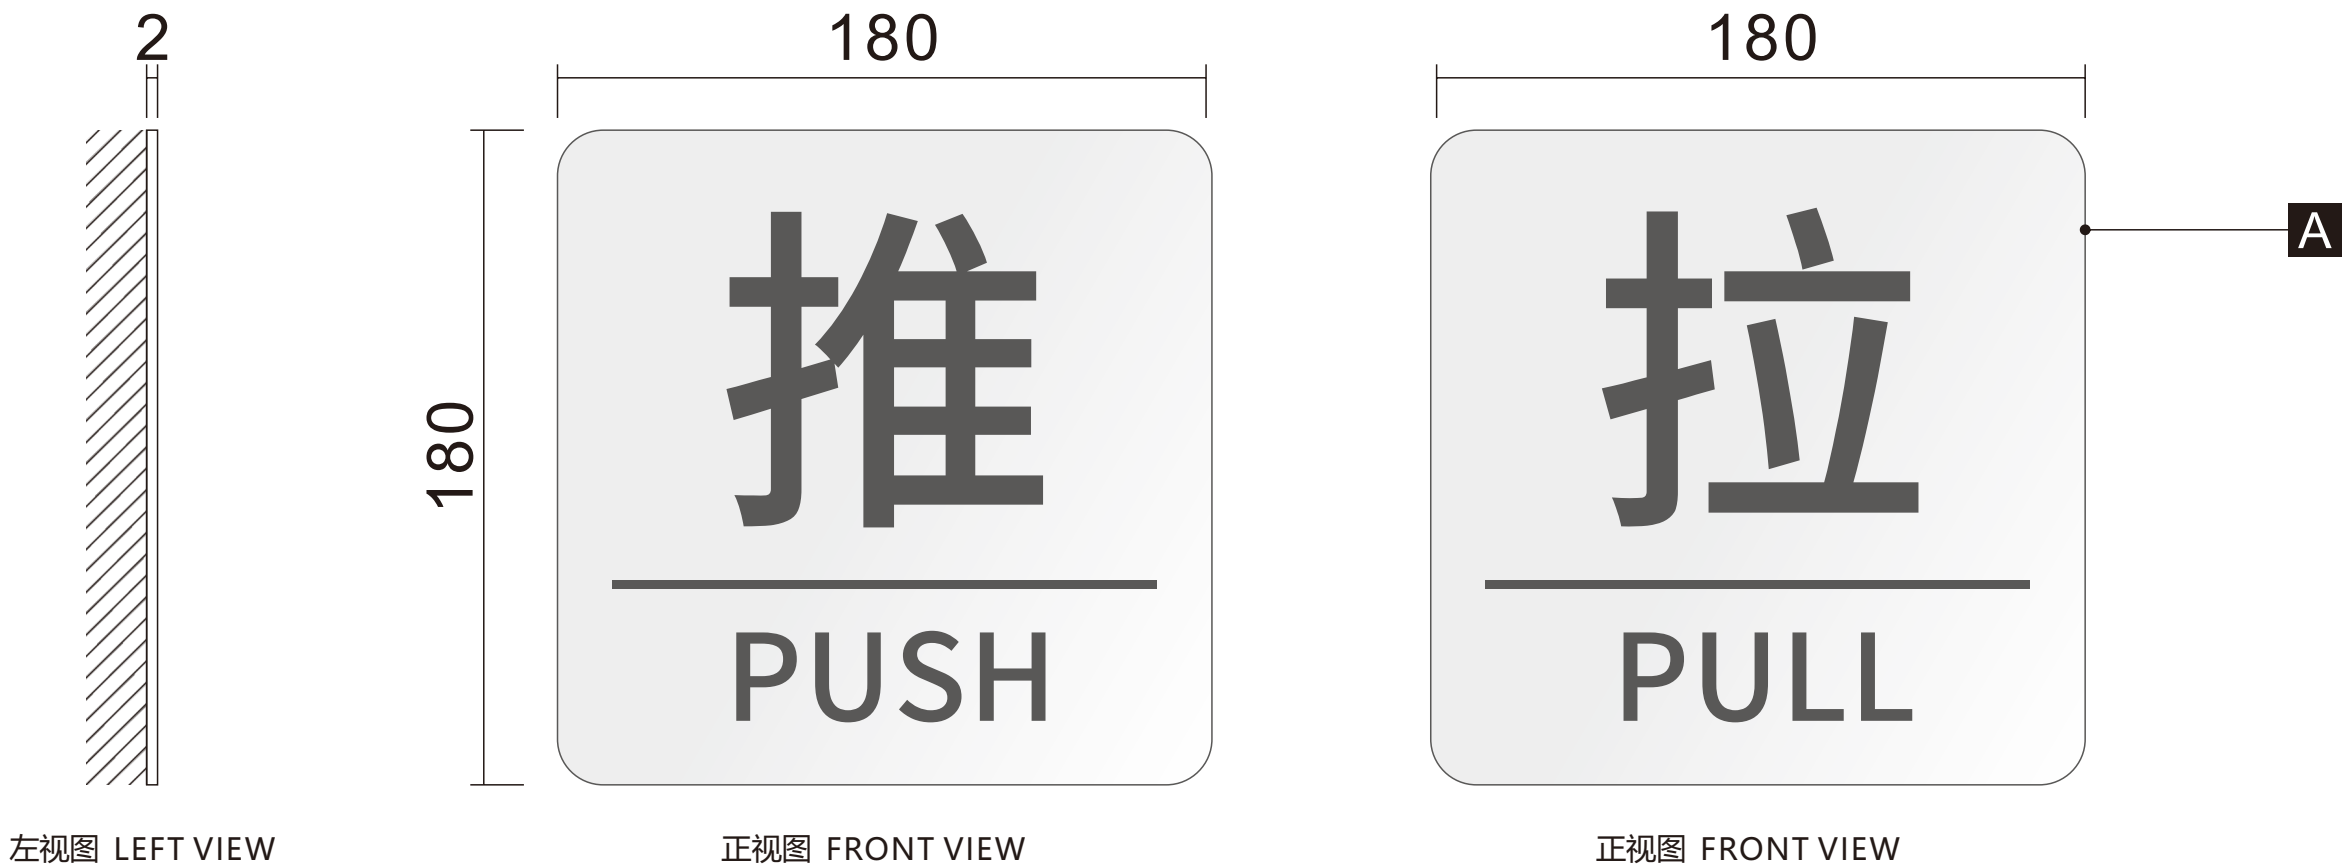

数量：


数量：

名称：金属牌

尺寸：180\*180\*3mm

材质工艺：A.厚3mmGB304#拉丝不锈钢激光切割面板，文字内容丝网印刷，面罩抗指纹光油。

|                     |
|---------------------|
| 标识设计·方案             |
| 制作单号                |
| C9-3                |
| 项目名称                |
| 中大附属肿瘤医院            |
| 图纸名称                |
| 金属牌                 |
| 工序负责                |
| 结构设计                |
| 外加工                 |
| 五金                  |
| 喷漆                  |
| 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印                  |
| 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源                 |
| 合同项目                |
| 产品单价                |
| 产品数量                |
| 产品总价                |

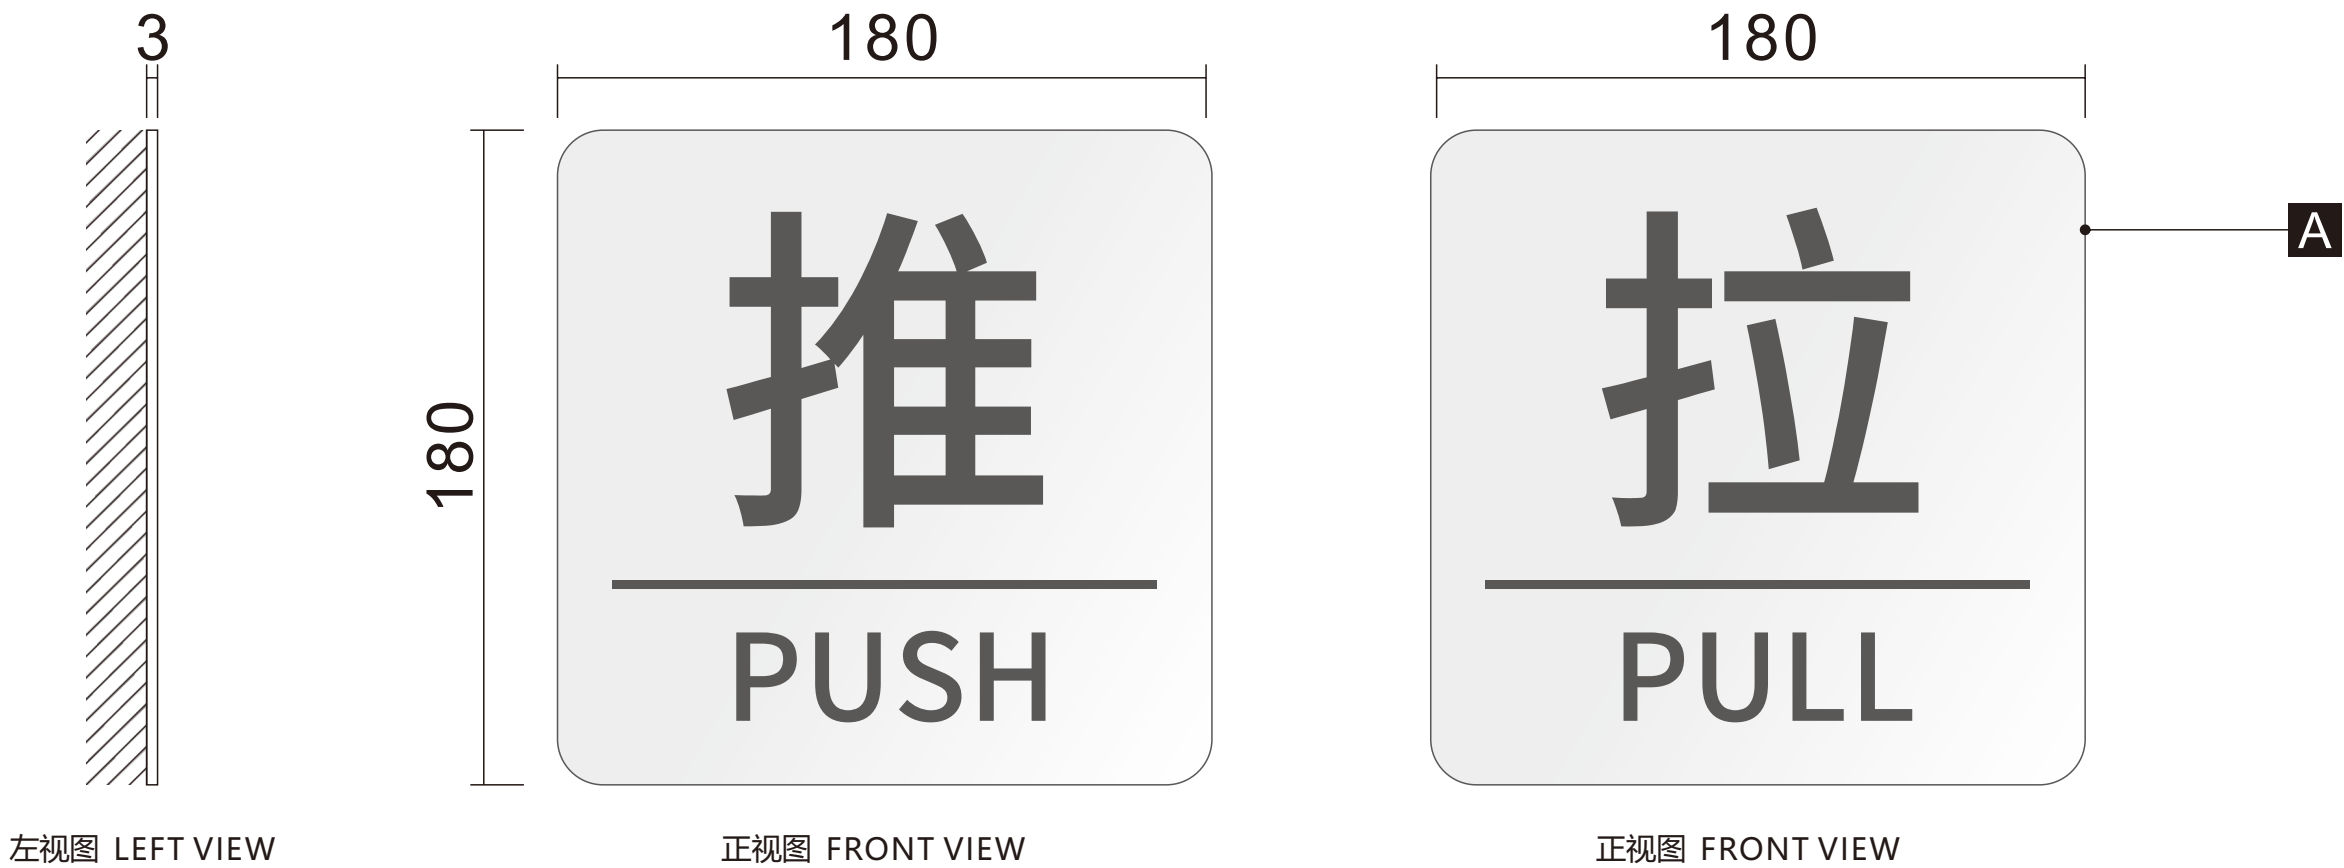

数量：


数量：

名称：金属牌

尺寸：180\*180\*5mm

材质工艺：A.厚5mmGB304#拉丝不锈钢激光切割面板，文字内容丝网印刷，面罩抗指纹光油。


|                     |
|---------------------|
| 标识设计·方案             |
| 制作单号                |
| C9-4                |
| 项目名称                |
| 中大附属肿瘤医院            |
| 图纸名称                |
| 金属牌                 |
| 工序负责                |
| 结构设计                |
| 外加工                 |
| 五金                  |
| 喷漆                  |
| 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印                  |
| 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源                 |
| 合同项目                |
| 产品单价                |
| 产品数量                |
| 产品总价                |

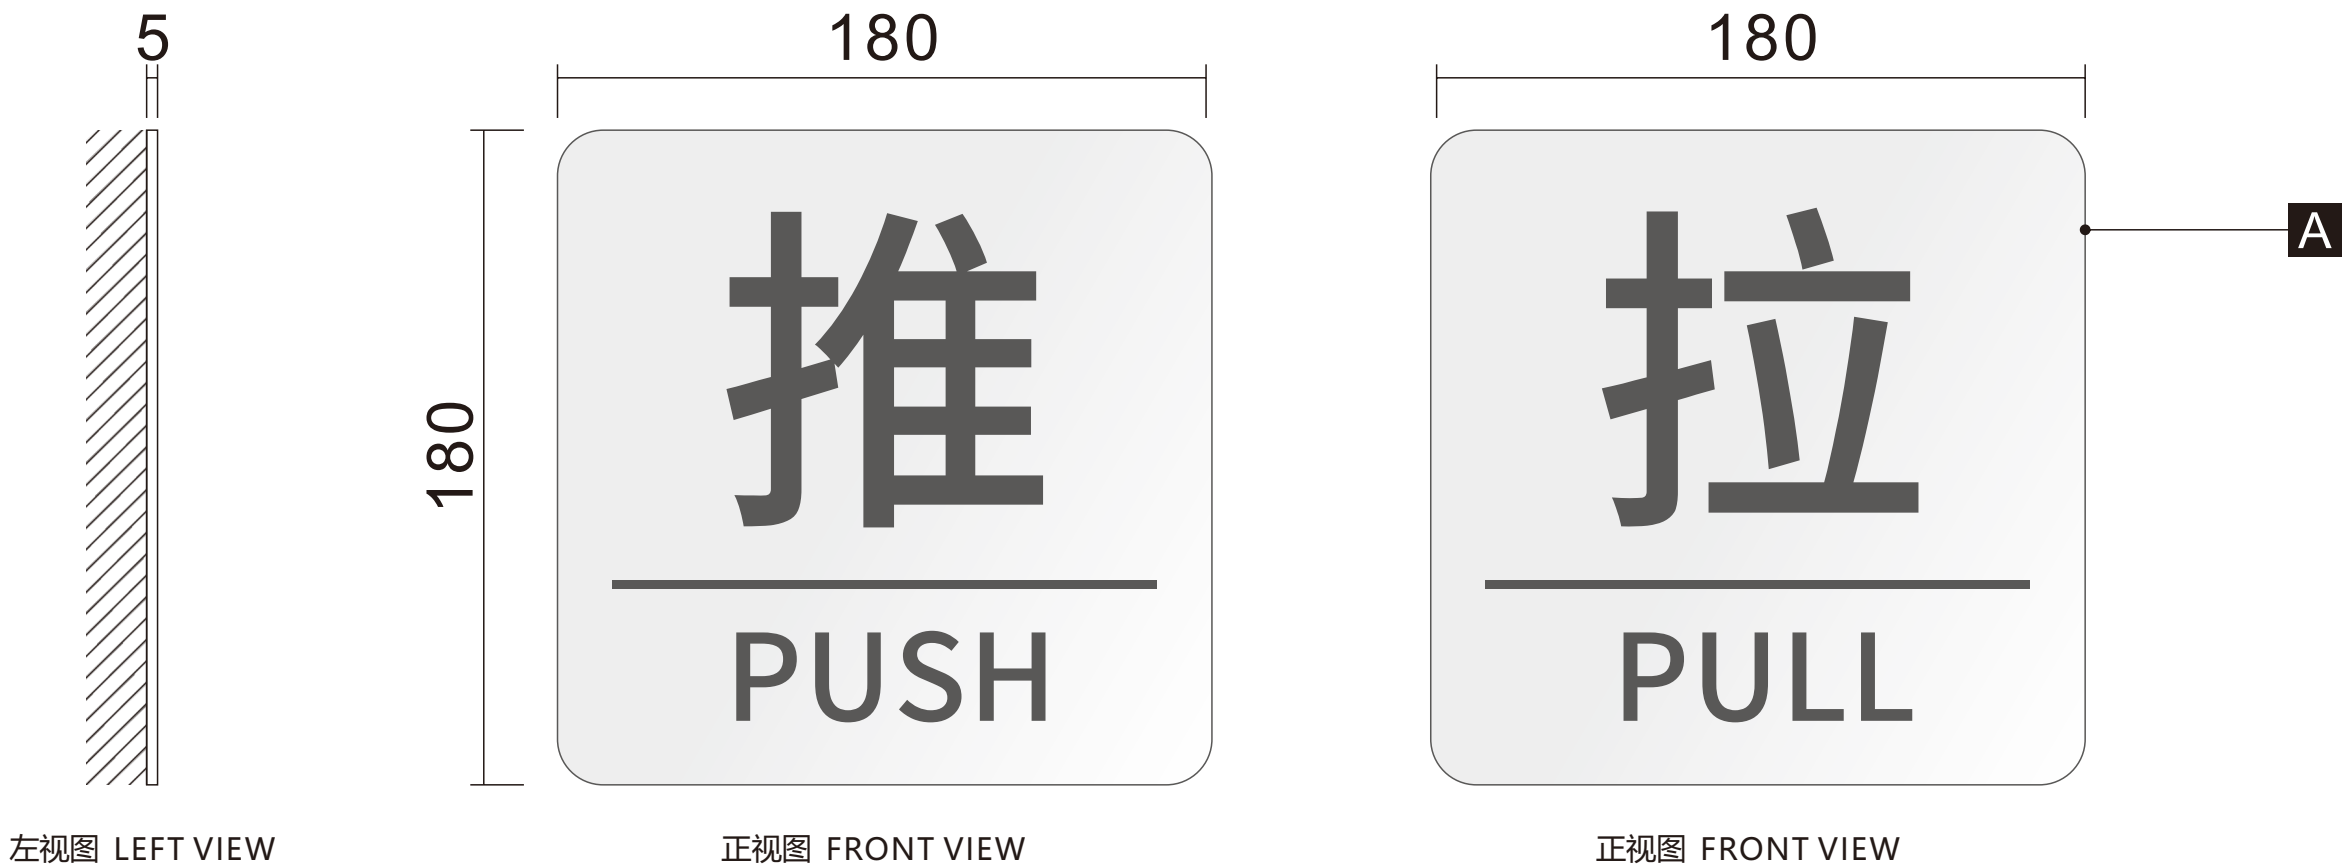

数量：

数量：

名称：简易宣传栏  
尺寸：600\*800\*20mm  
材质工艺：1.0mm不锈钢/2cm实木边框+8mm软幕布组装，安装方式：粘贴/打孔挂装。

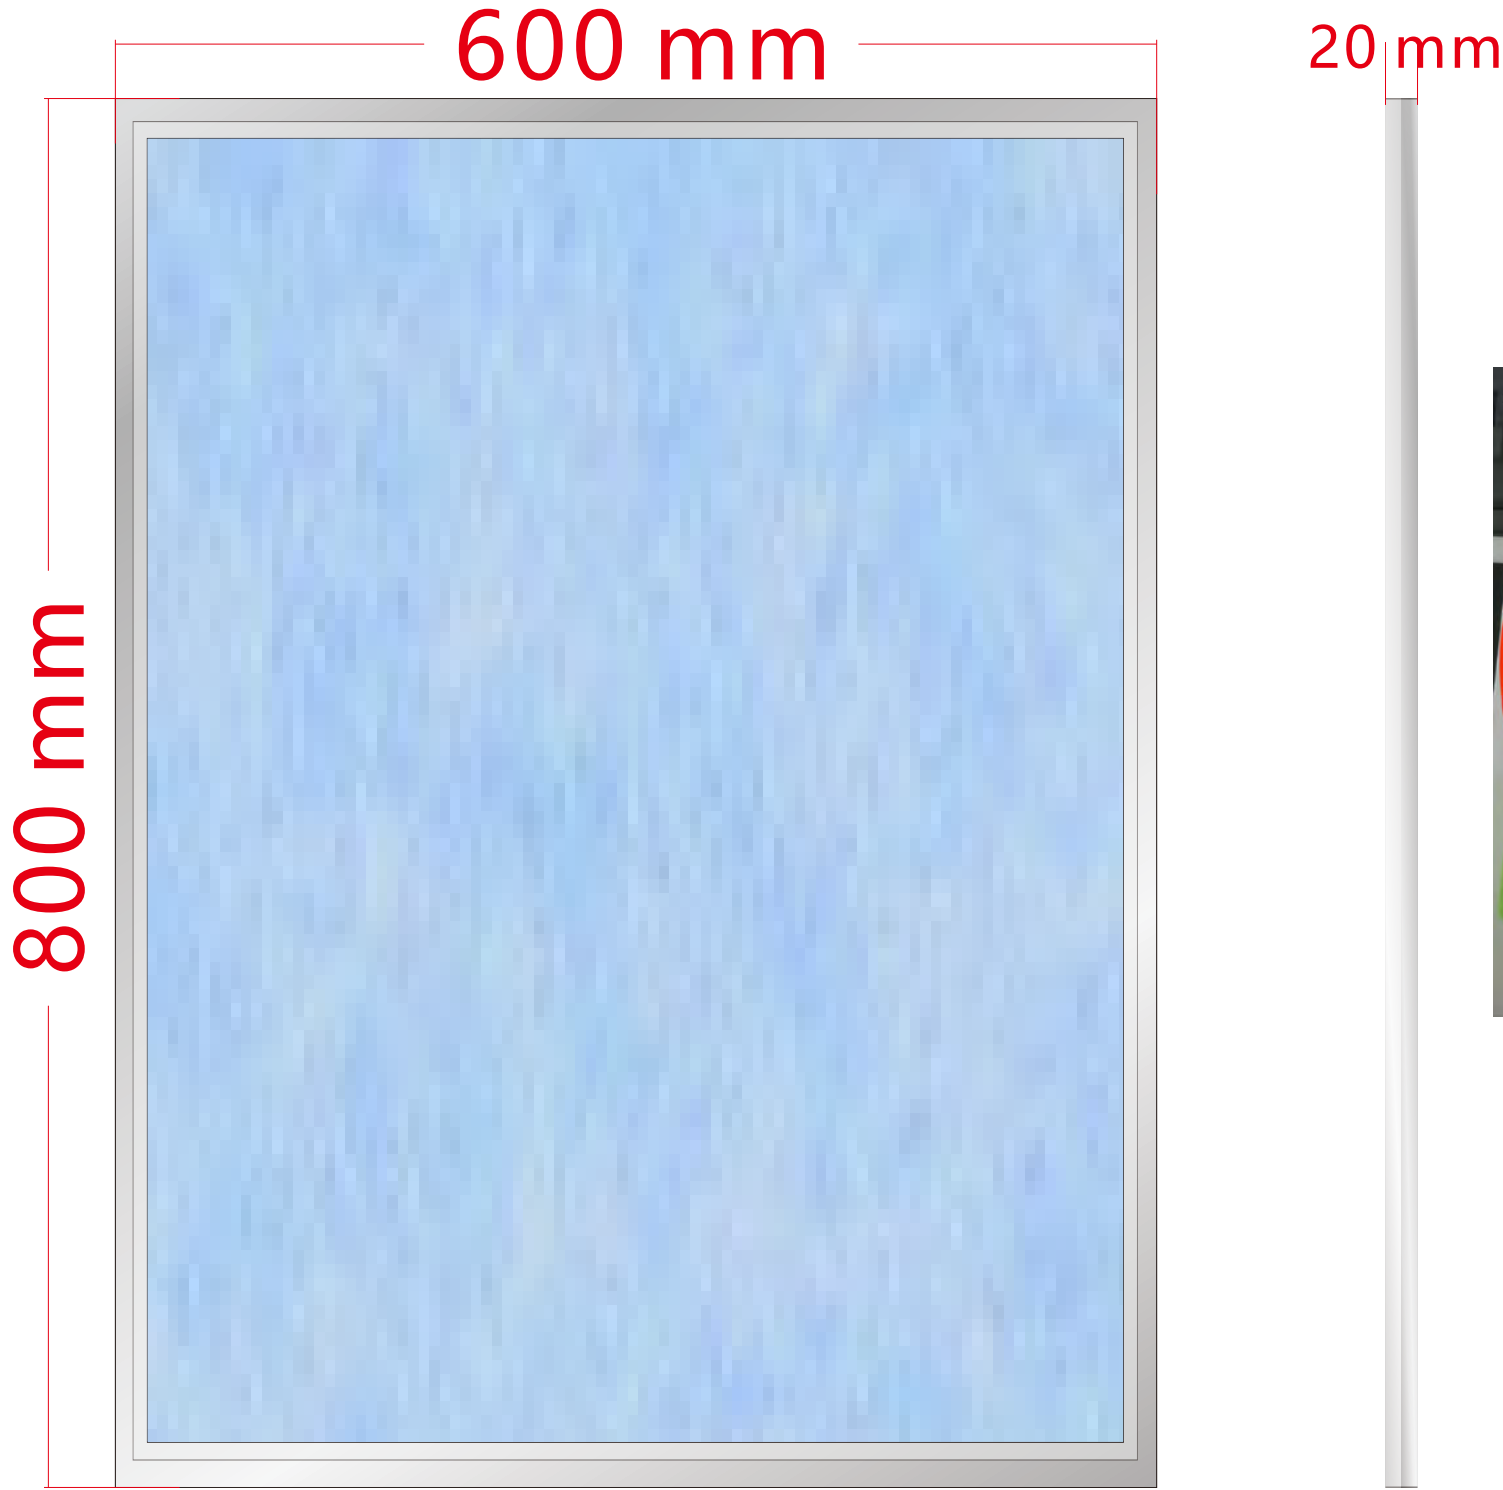

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



名称：资料盒B

尺寸：如图

材质工艺：特殊规格，定制单层亚克力组装，材料采用透明或瓷白亚克力（具体厚度根据需求待定）  
(1mm/2mm/3mm/5mm亚克力，每层组装材料根据需求待定)




| 标识设计·方案             |          |
|---------------------|----------|
| 制作单号                | C13      |
| 项目名称                | 中大附属肿瘤医院 |
| 图纸名称                | 资料盒B     |
| 工序负责                |          |
| 结构设计                |          |
| 外加工                 |          |
| 五金                  |          |
| 喷漆                  |          |
| 标识A<br>(有机类、型材、铝塑板) |          |
| 丝印                  |          |
| 标识B<br>(粘贴、打磨、包装)   |          |
| 光电源                 |          |
| 合同项目                |          |
| 产品单价                |          |
| 产品数量                |          |
| 产品总价                |          |

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

名称：资料盒C

尺寸：如图

材质工艺：特殊规格，定制多层亚克力组装，材料采用透明或瓷白亚克力（具体厚度根据需求待定）  
(1mm/2mm/3mm/5mm亚克力，每层组装材料根据需求待定)

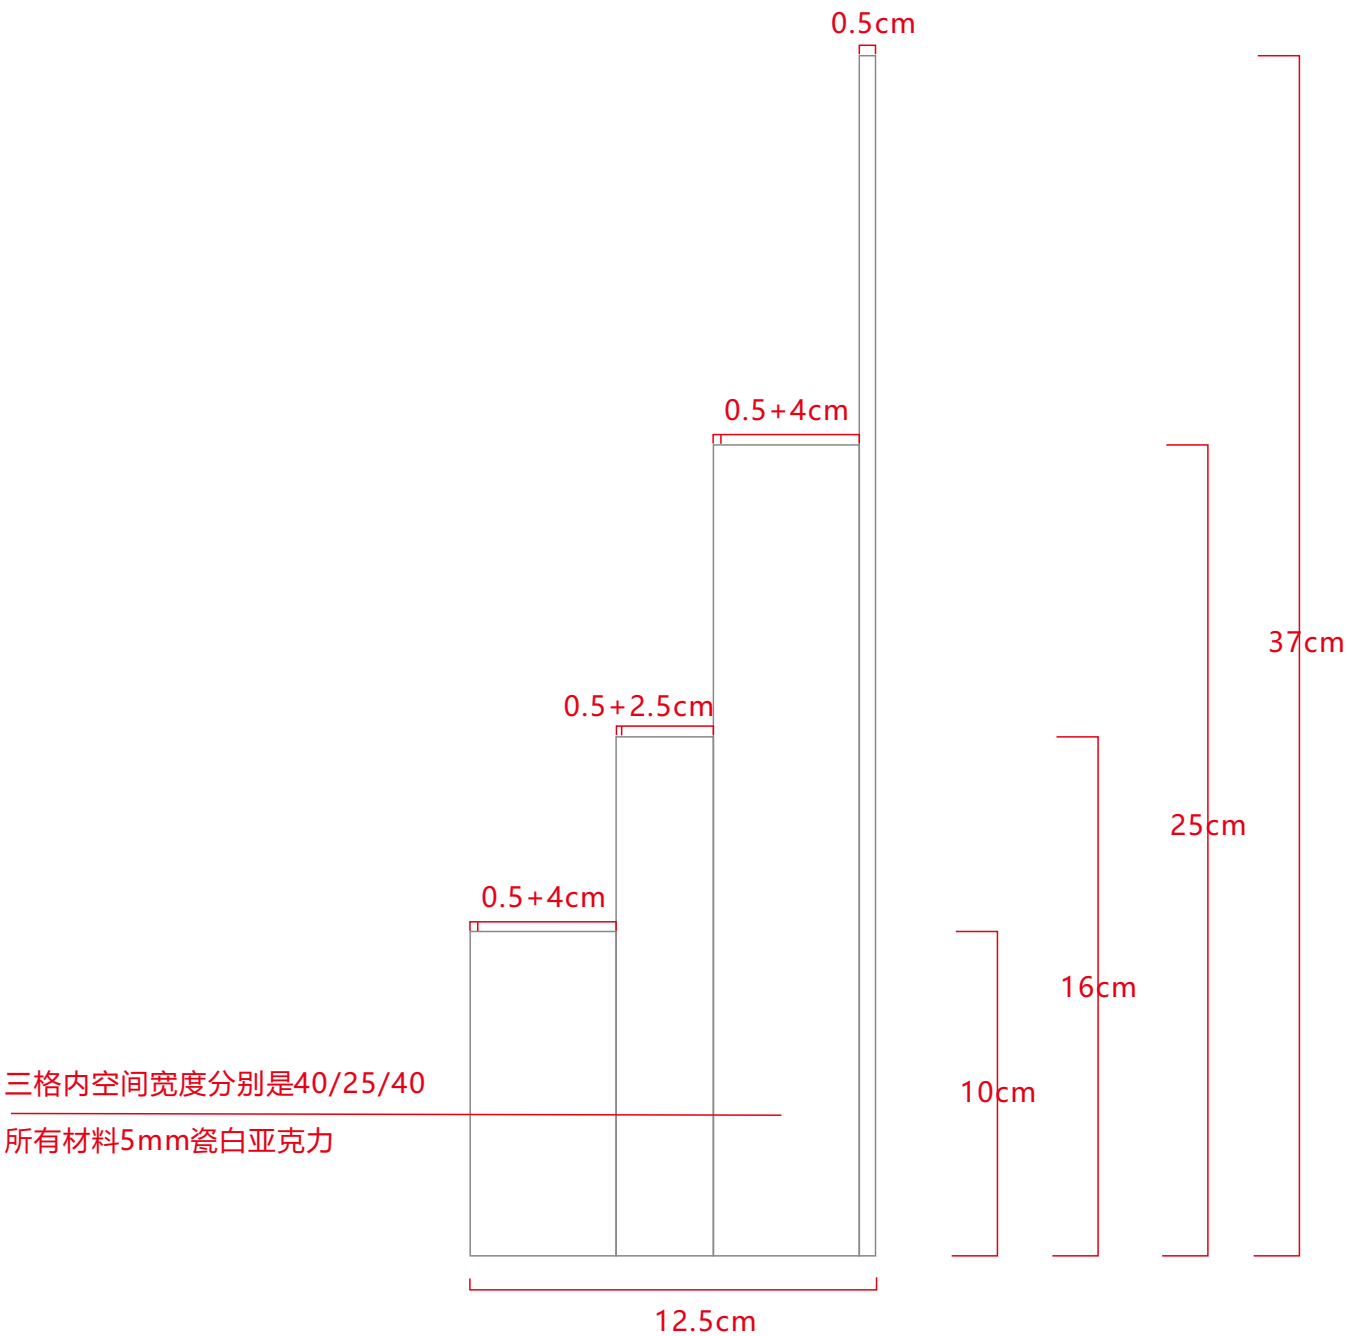

标识设计 · 方案

制作单号

C14

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

资料盒C

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A  
(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B  
(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

名称：铭牌  
尺寸：如图（根据需要修改尺寸）  
材质工艺：横拉丝不锈钢，蚀刻填色，1.2mm材料厚度以上



| 标识设计·方案 |              |
|---------|--------------|
| 制作单号    | C15          |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称    | 铭牌           |
| 工序负责    | 结构设计         |
| 外加工     |              |
| 五金      |              |
| 喷漆      |              |
| 标识A     | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝印      |              |
| 标识B     | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光电源     |              |
| 合同项目    |              |
| 产品单价    |              |
| 产品数量    |              |
| 产品总价    |              |

名称：PVC标识

尺寸：如图（根据需要修改尺寸）

材质工艺：5mm厚度pvc材质，雕刻形状；玻璃胶泡沫胶组合安装



|       |      |    |        |        |        |        |      |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|

标识设计·方案

制作单号

C16-1

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

PVC标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A  
(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B  
(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学 附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

名称：PVC标识

尺寸：如图（根据需要修改尺寸）

材质工艺：6mm厚度pvc材质，雕刻形状；玻璃胶泡沫胶组合安装



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

标识设计·方案

制作单号

C16-2

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

PVC标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学 附属肿瘤医院

Sun Yat-sen University Cancer Center

名称：PVC标识

尺寸：如图（根据需要修改尺寸）

材质工艺：8mm厚度pvc材质，雕刻形状；玻璃胶泡沫胶组合安装



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

标识设计·方案

制作单号

C16-3

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

PVC标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价



SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学 附属肿瘤医院

Sun Yat-sen University Cancer Center

名称：PVC标识

尺寸：如图（根据需要修改尺寸）

材质工艺：10mm厚度pvc材质，雕刻形状；玻璃胶泡沫胶组合安装



单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

标识设计·方案

制作单号

C16-4

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

PVC标识

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价




SYSUCC  
SINCE 1964

中山大学 附属肿瘤医院

Sun Yat-sen University Cancer Center

名称:户外总索引  
尺寸:如图  
材质工艺:参考图纸。

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色A-01,油漆掺入银粉,漆面细闪银效果,面罩抗紫外线光油。
- B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗紫外线光油。
- C** 户外LED灯箱,面板为厚5mm有机玻璃贴对应内容高精度灯片,内置户外防水LED光源。
- D** 铝型材组装面板,内容丝网印刷。
- E** 文字内容丝网印刷白色。
- F** 辅助图形丝网印刷标准色A-02。

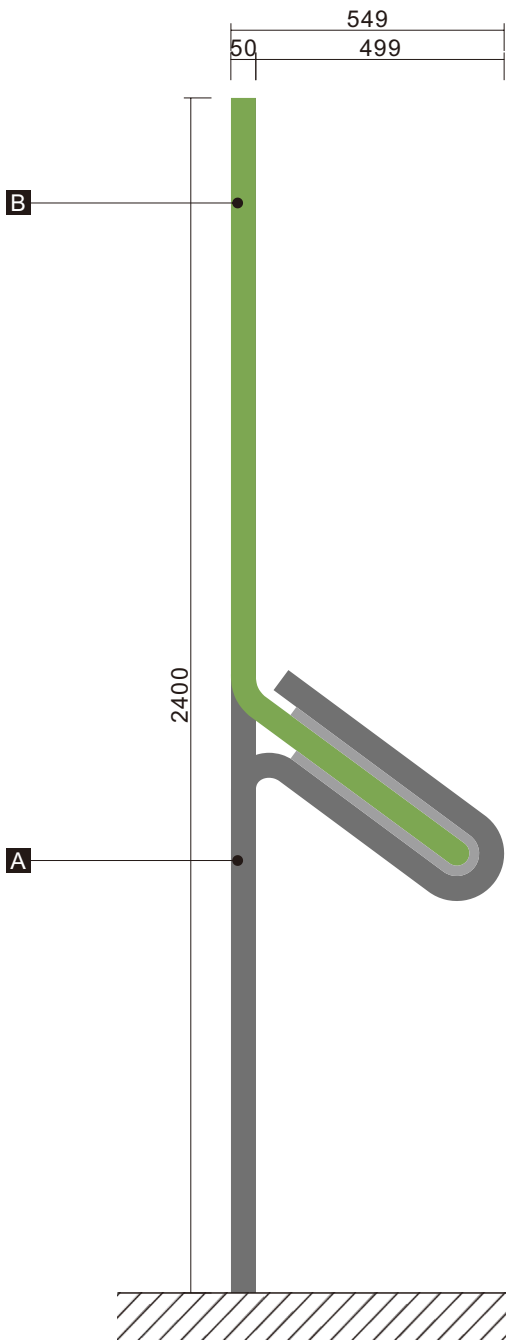

## 标识设计·方案

制作单号

D1

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

户外总索引

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识A

(有机类、型材、铝塑板)

丝网

标识B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center



名称:户外分流导示

尺寸:如图

材质工艺:参考图纸。

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色A-01,油漆掺入银粉,漆面细闪银效果,面罩抗紫外线光油。
- B** 厚1.5mm100X100不锈钢方通焊制立杆,表面氟碳烤漆标准色B-01,油漆掺入银粉,漆面细闪银效果,面罩抗紫外线光油。
- C** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型,表面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗紫外线光油。
- D** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制内衬,四周内凹10mm,表面氟碳烤漆标准色A-01,油漆掺入银粉,漆面细闪银效果,面罩抗紫外线光油。
- E** 内容激光切割镂空,背衬乳白色透光板或贴对应色彩灯片,箱体内置户外防水LED光源。
- F** 户外LED灯箱,面板为厚5mm有机玻璃贴对应内容高精度灯片,内置户外防水LED光源。
- G** 文字内容丝网印刷。
- H** 线条丝网印刷标准色C-01。

排版内容以排版图为准

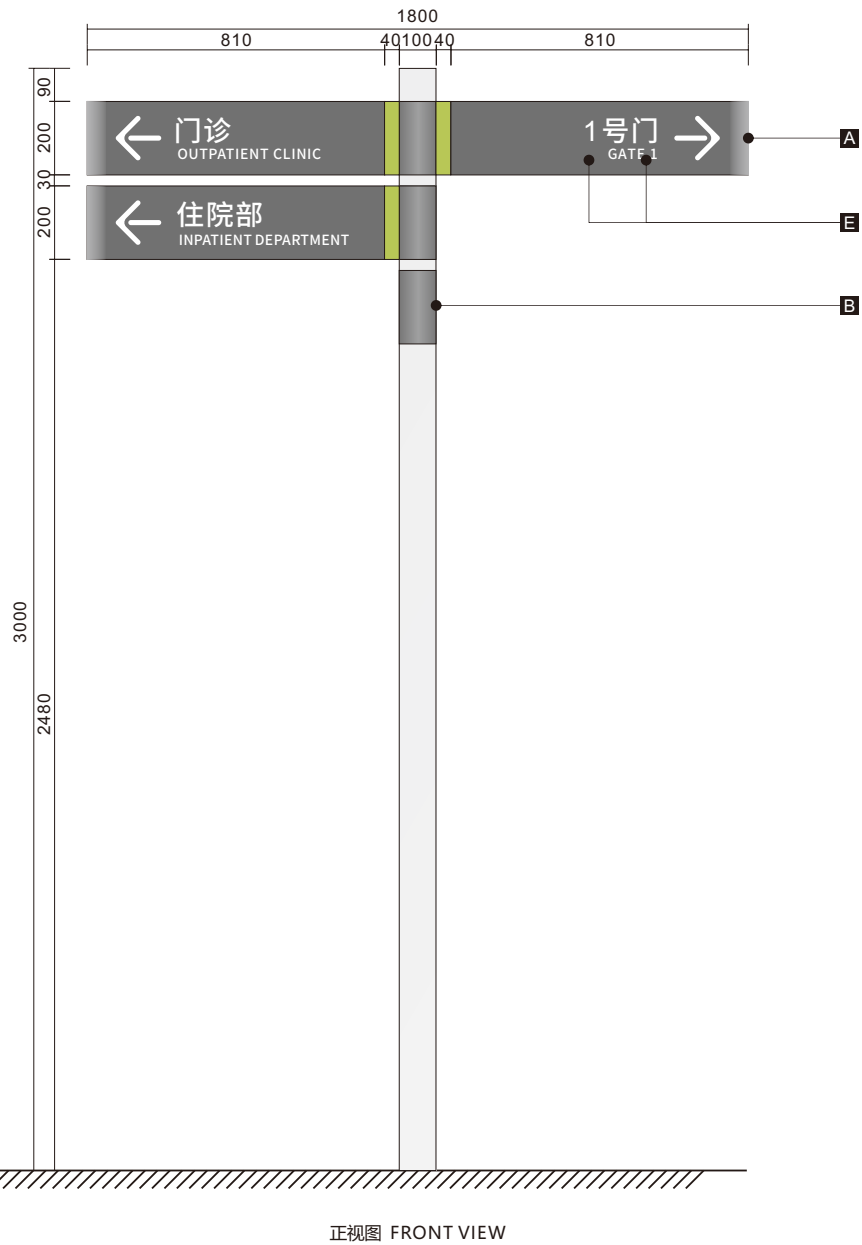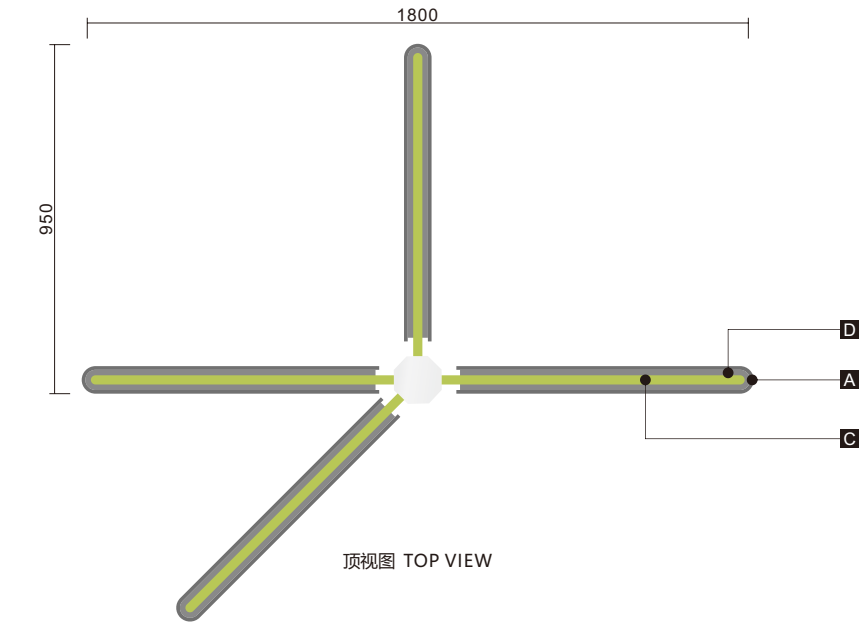

标识设计·方案

制作单号

D2

项目名称

中大附属肿瘤医院

图纸名称

户外分流导示

工序负责

结构设计

外加工

五金

喷漆

标识 A

(有机类、型材、铝塑板)

丝印

标识 B

(粘贴、打磨、包装)

光电源

合同项目

产品单价

产品数量

产品总价

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核


完工日期



中山大学附属肿瘤医院  
Sun Yat-sen University Cancer Center

名称：户外宣传栏  
尺寸：2400\*2100\*100mm  
材质工艺：参考深化图纸  
安装：嵌入式安装

- A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色B-01，油漆掺入银粉，漆面细闪银效果，面罩抗紫外线光油。
- B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色A-01，油漆掺入银粉，漆面细闪银效果，面罩抗紫外线光油。
- C** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色C-01，面罩抗紫外线光油。
- D** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制边框，面板为厚8mm钢化玻璃，内部面板为磁性白板，门框液压杆支撑可向上开启。
- E** 文字内容丝网印刷。  
贴对应内容高精度灯片，内置户外防水LED光源。

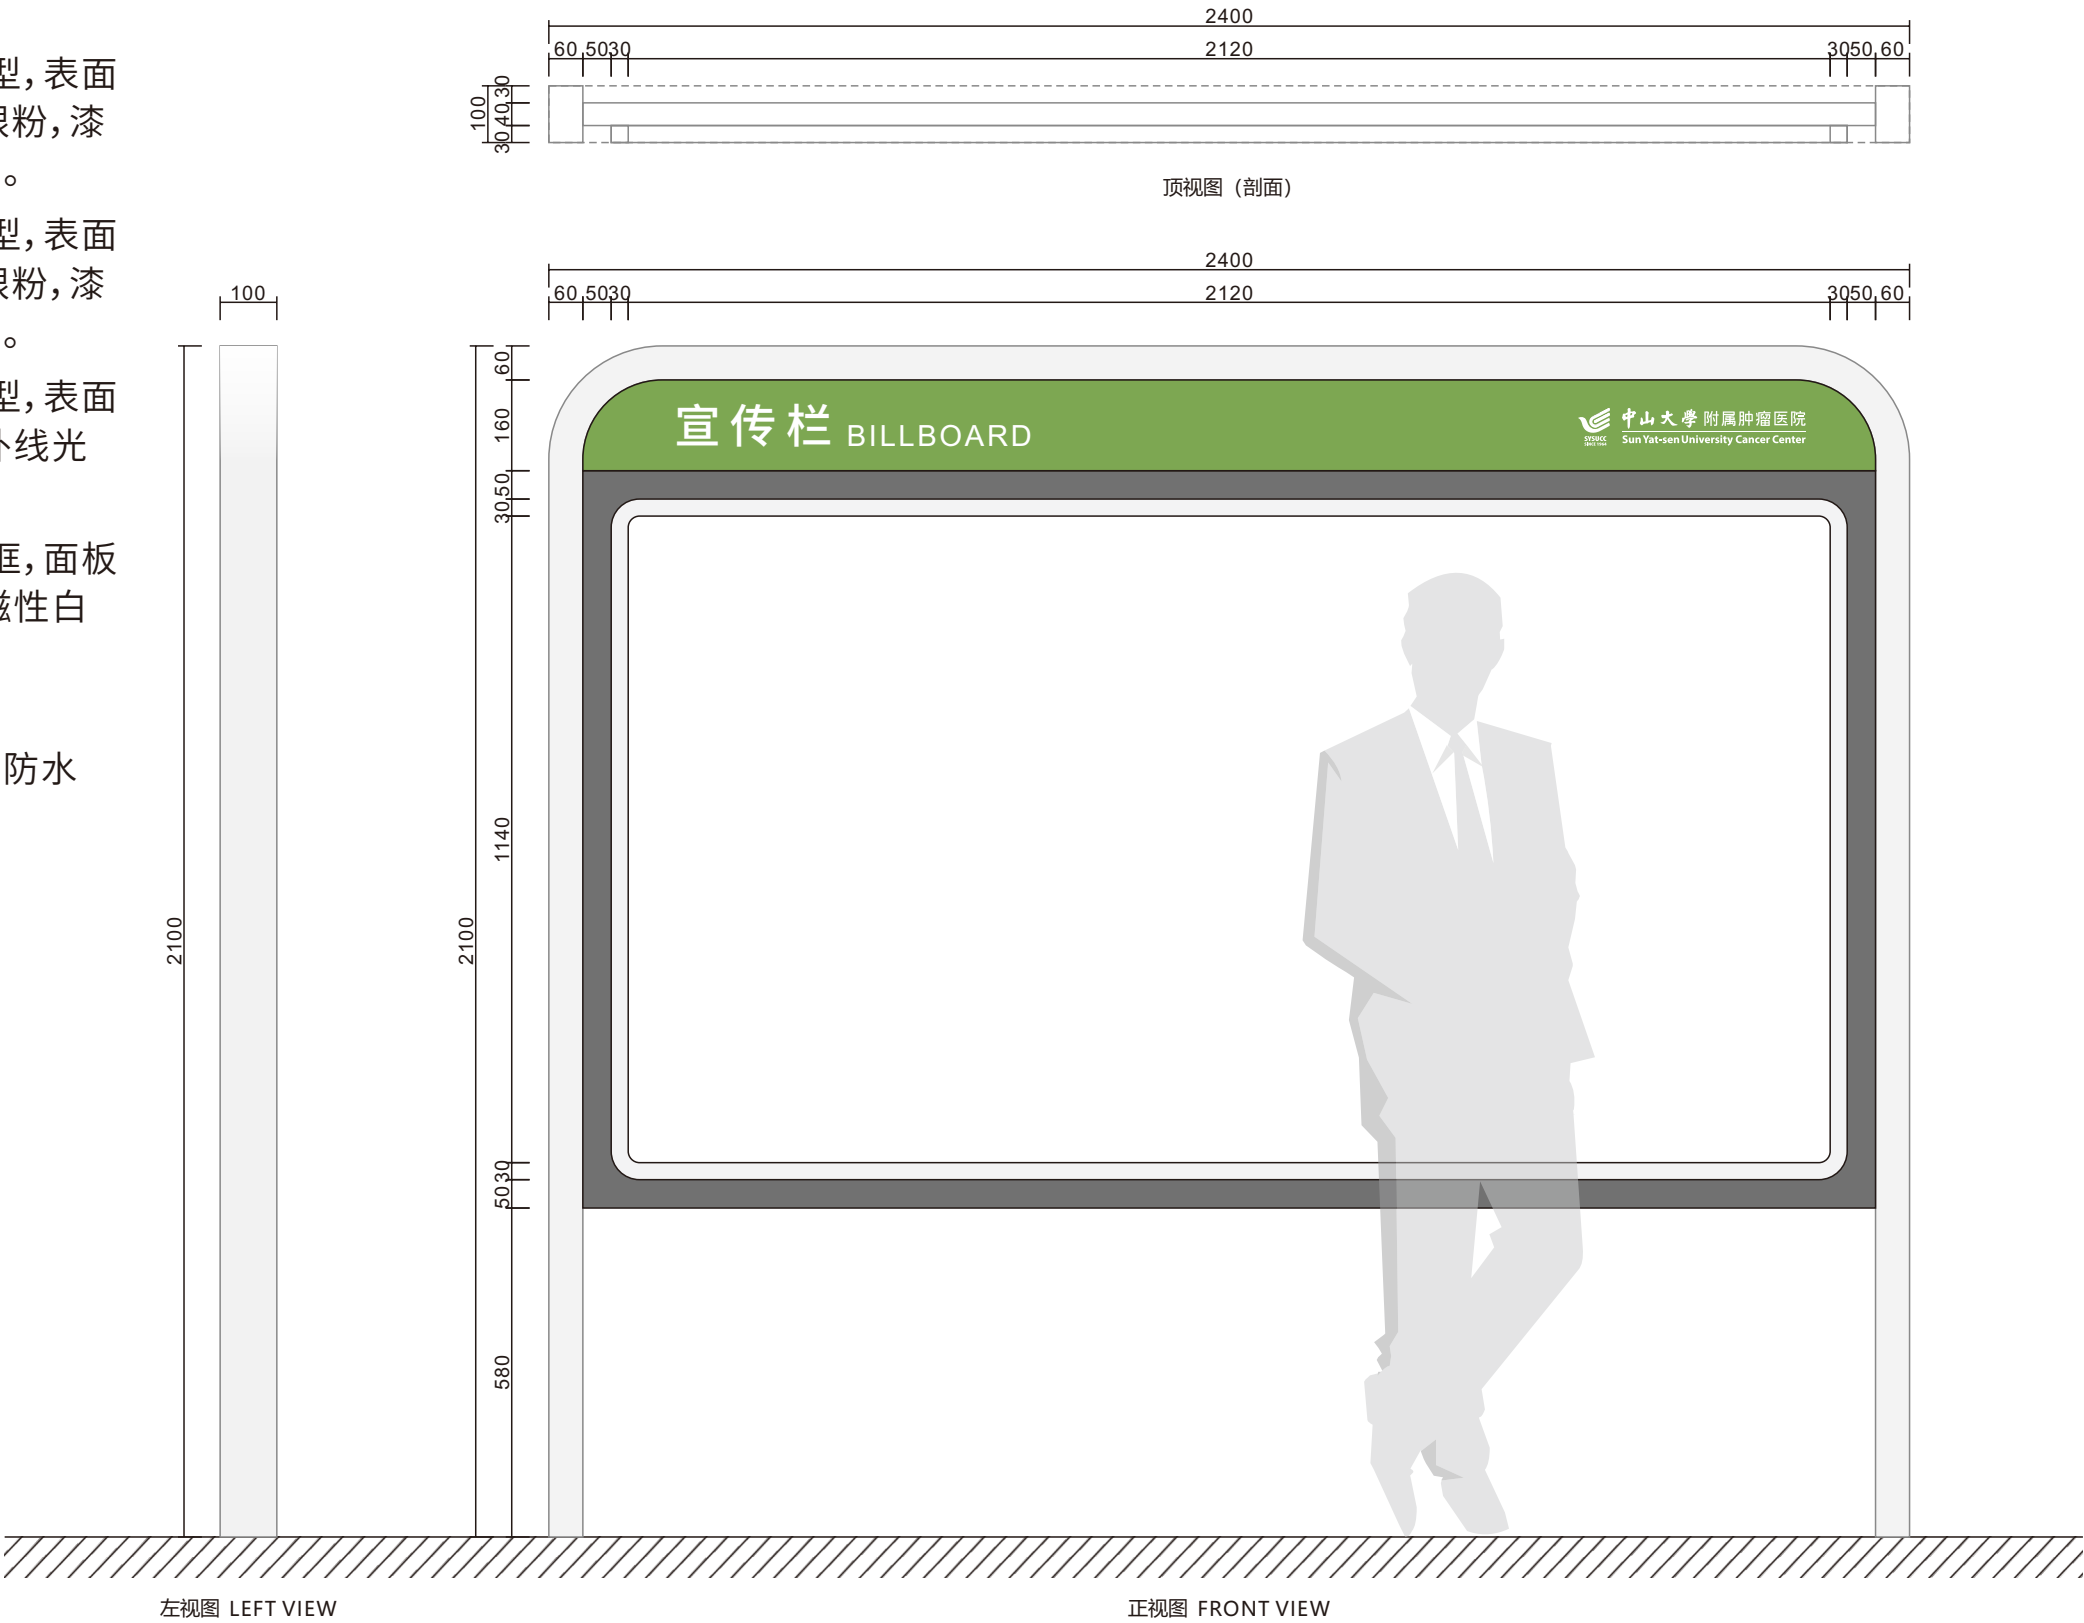

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




**A** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制箱体, 表面氟碳烤漆标准色A-01,油漆惨入银粉, 漆面细闪银效果, 面罩抗紫外线光油。

**B** 厚1.5mmGB304#不锈钢焊制箱体, 表面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗紫外线光油。

**C** 内容部分, 贴工程机反光膜。

中间层板样式

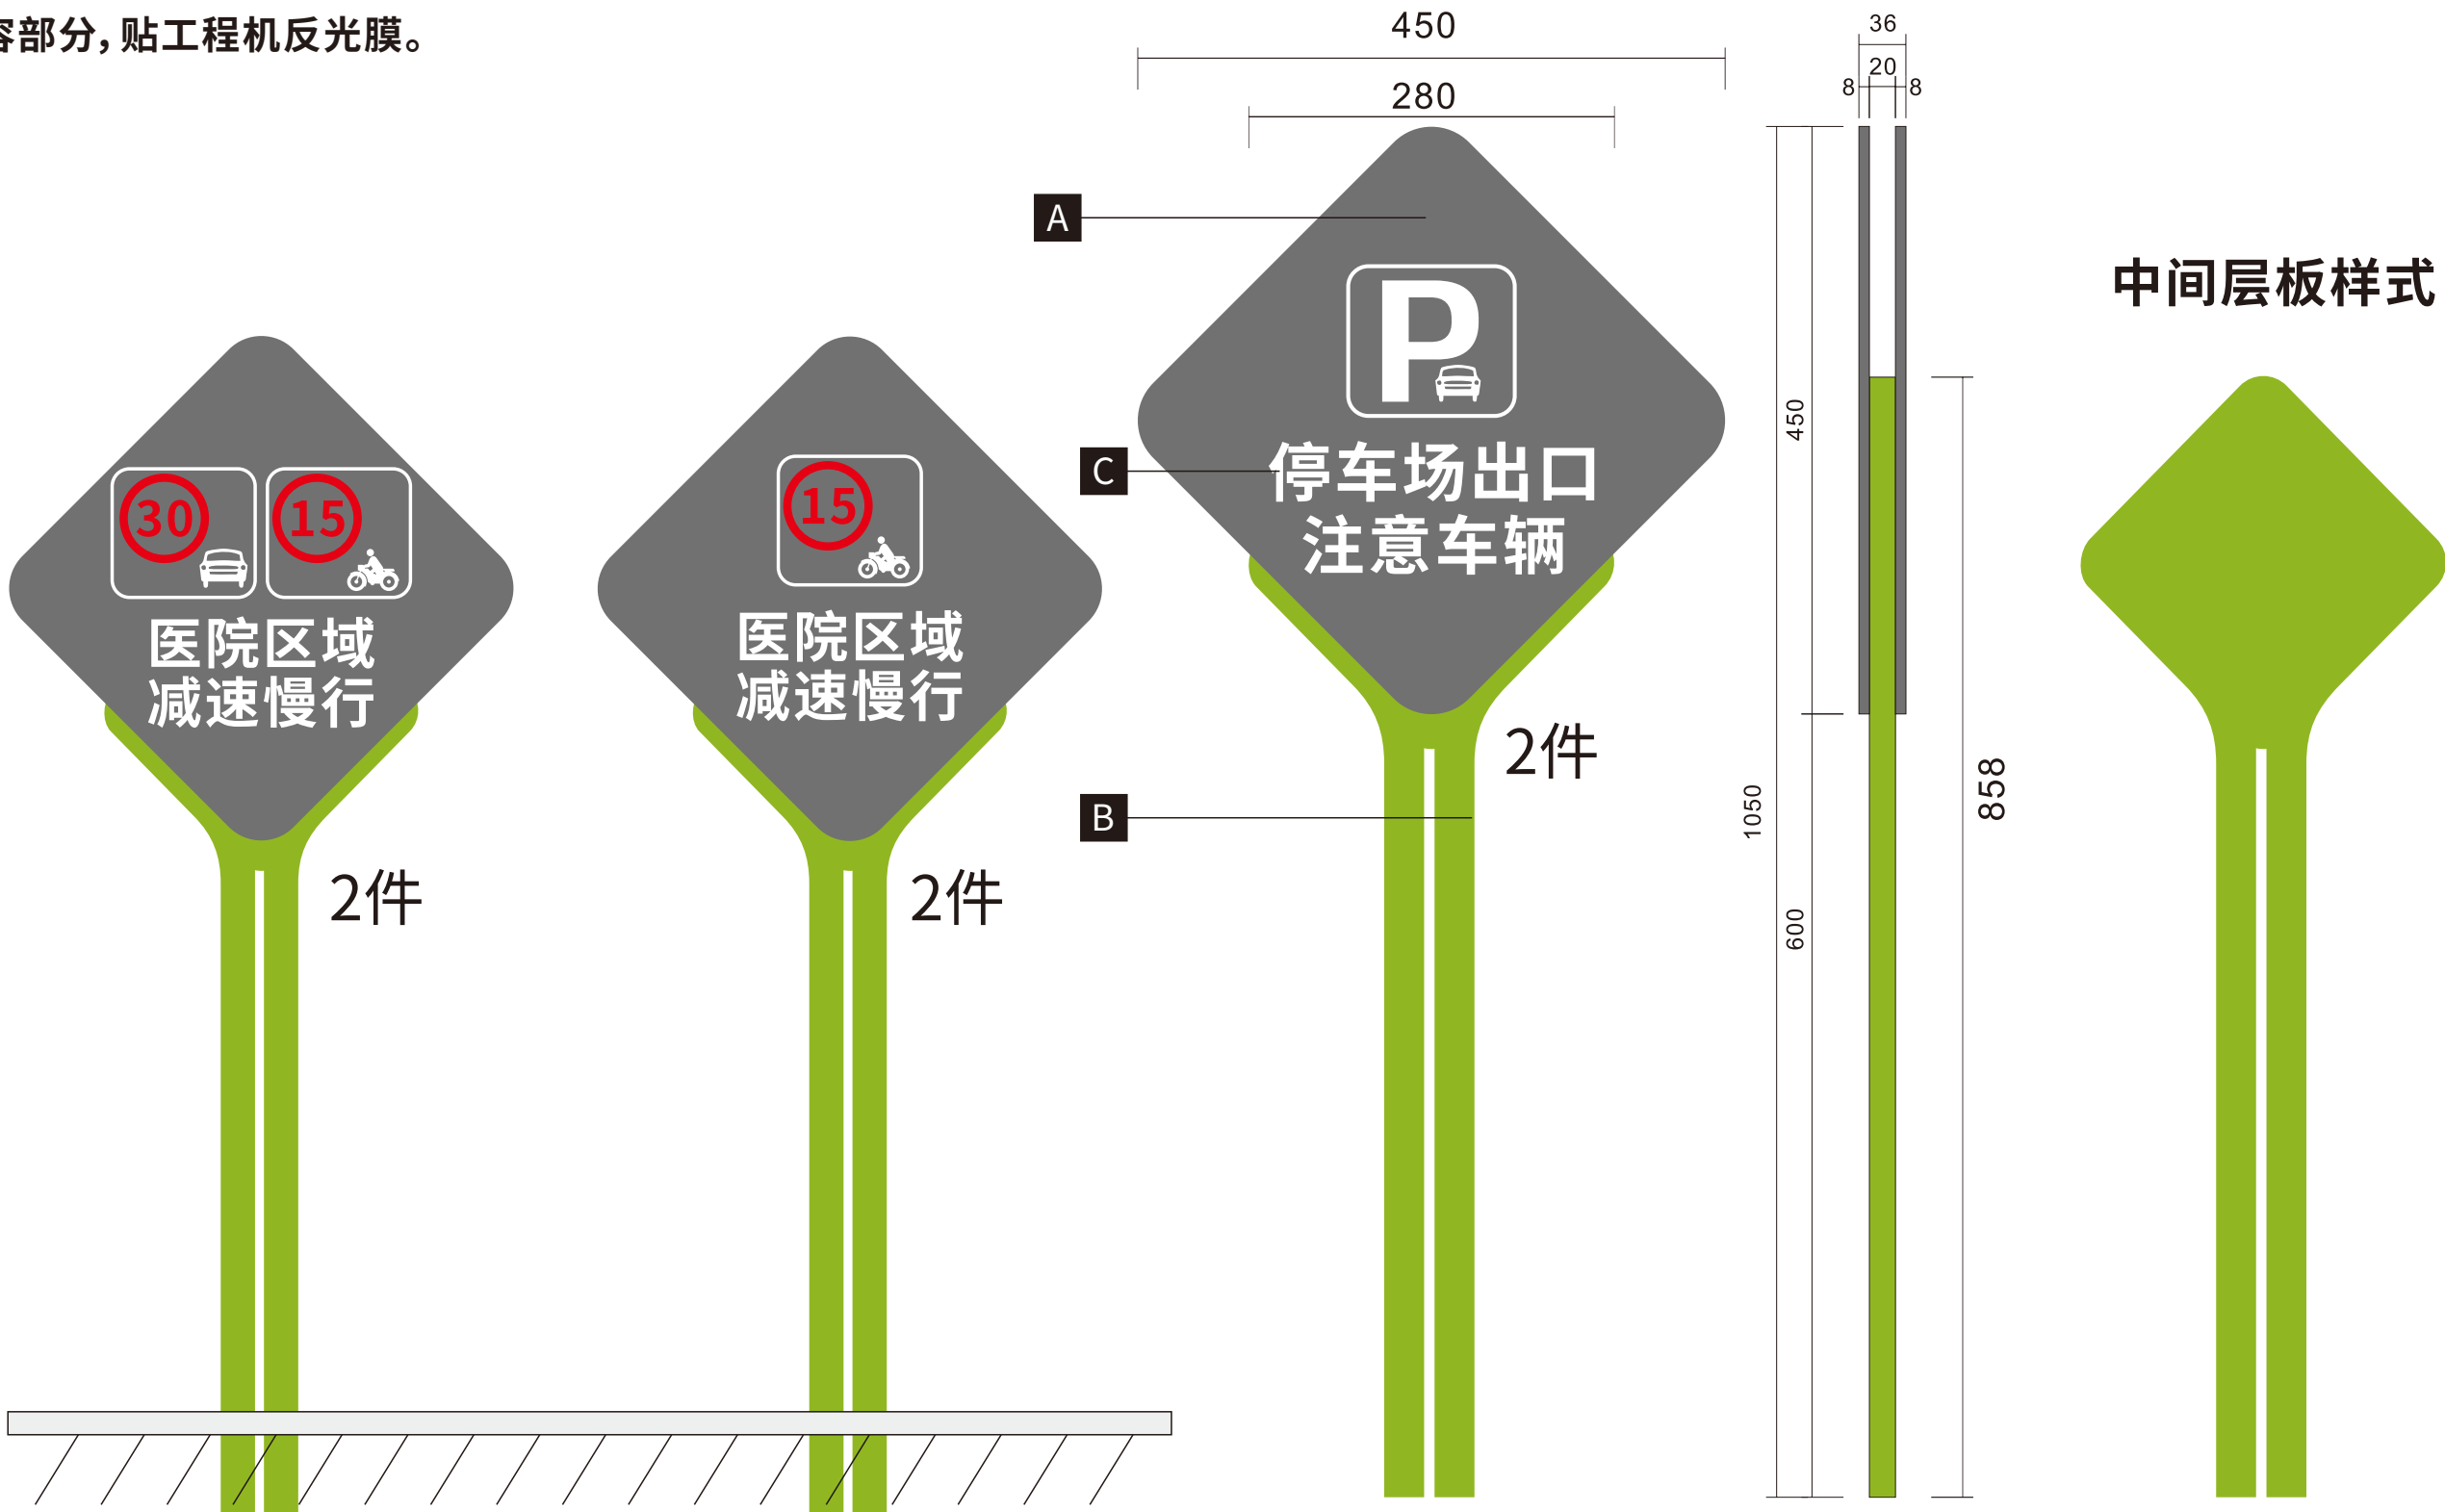

单位:mm

出图日期

设 计

使用科室审核

主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期




名称：精神堡垒

尺寸：3000\*1280\*400mm

材质工艺：如图

安装：嵌入式安装

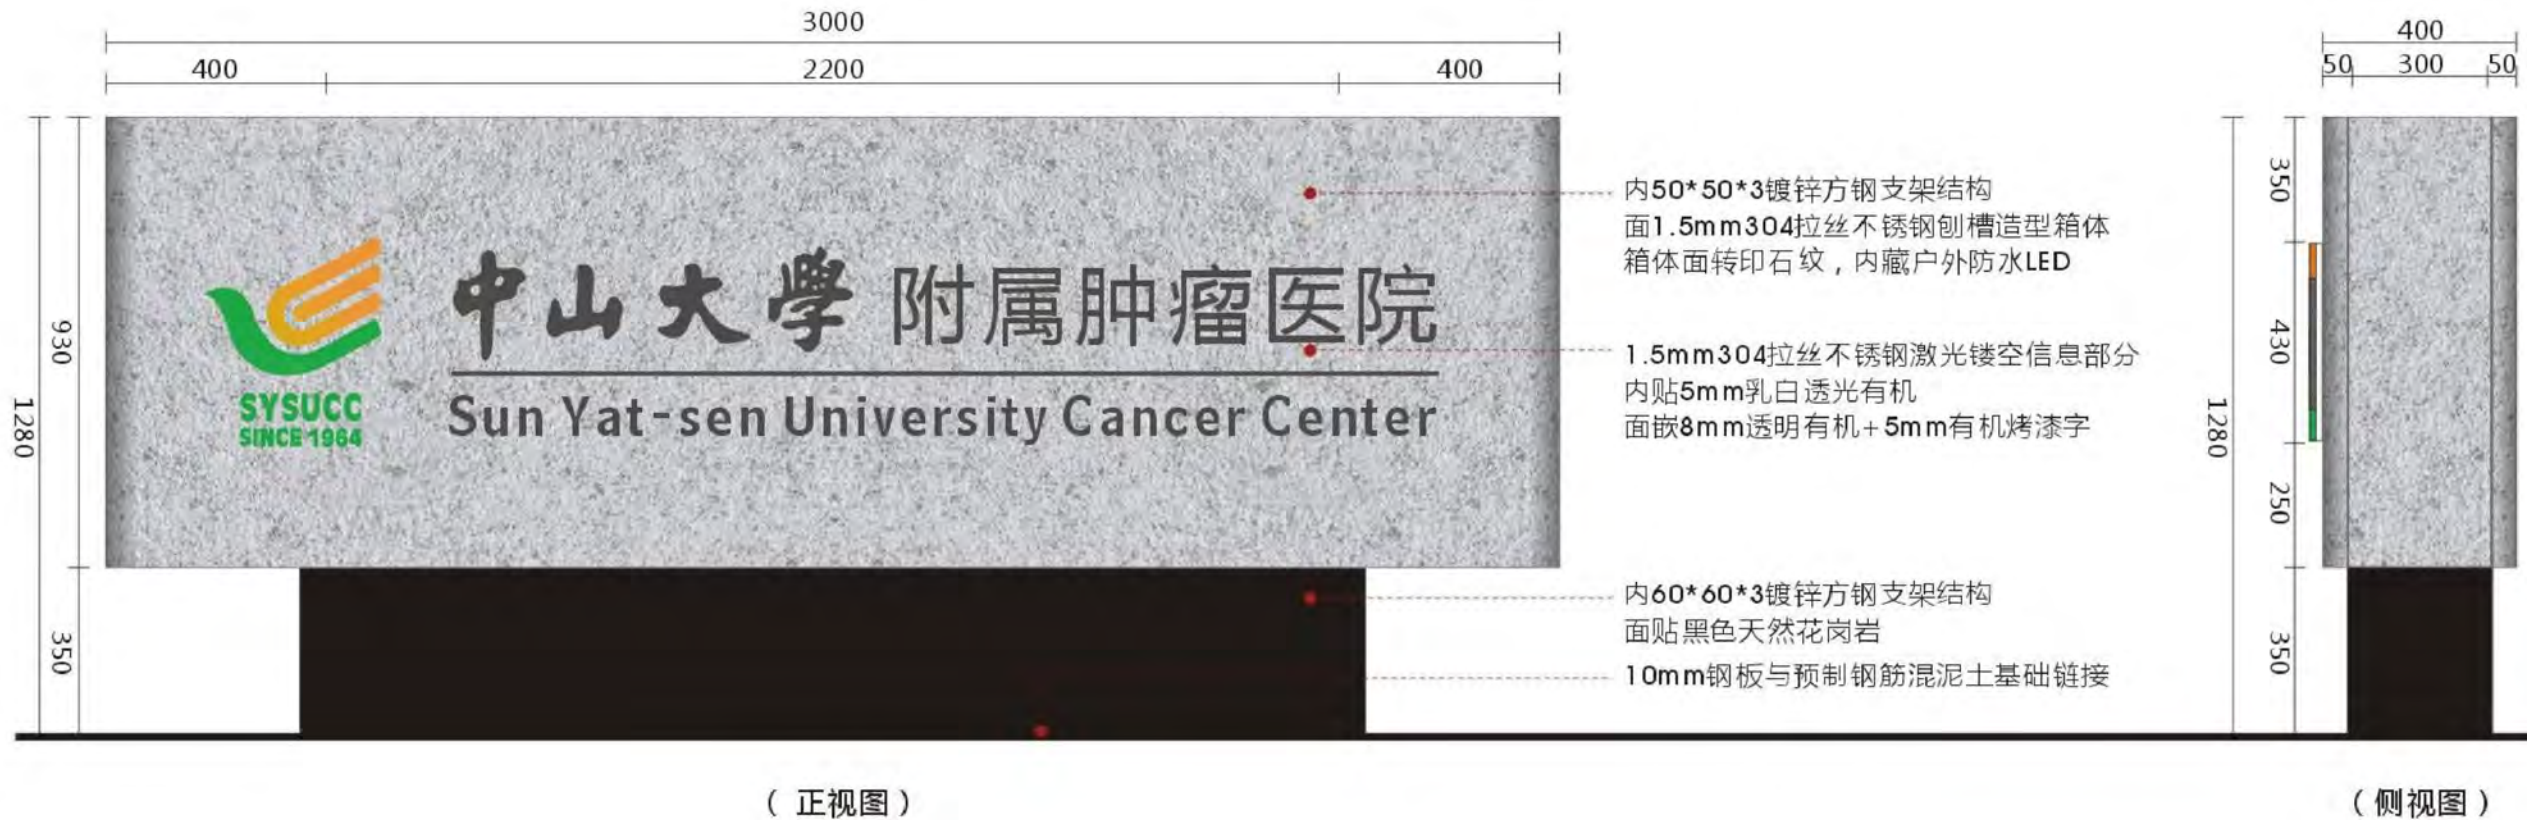


名称：户外宣传栏

尺寸：2700\*2330\*650

材质工艺：如图

安装：嵌入式安装

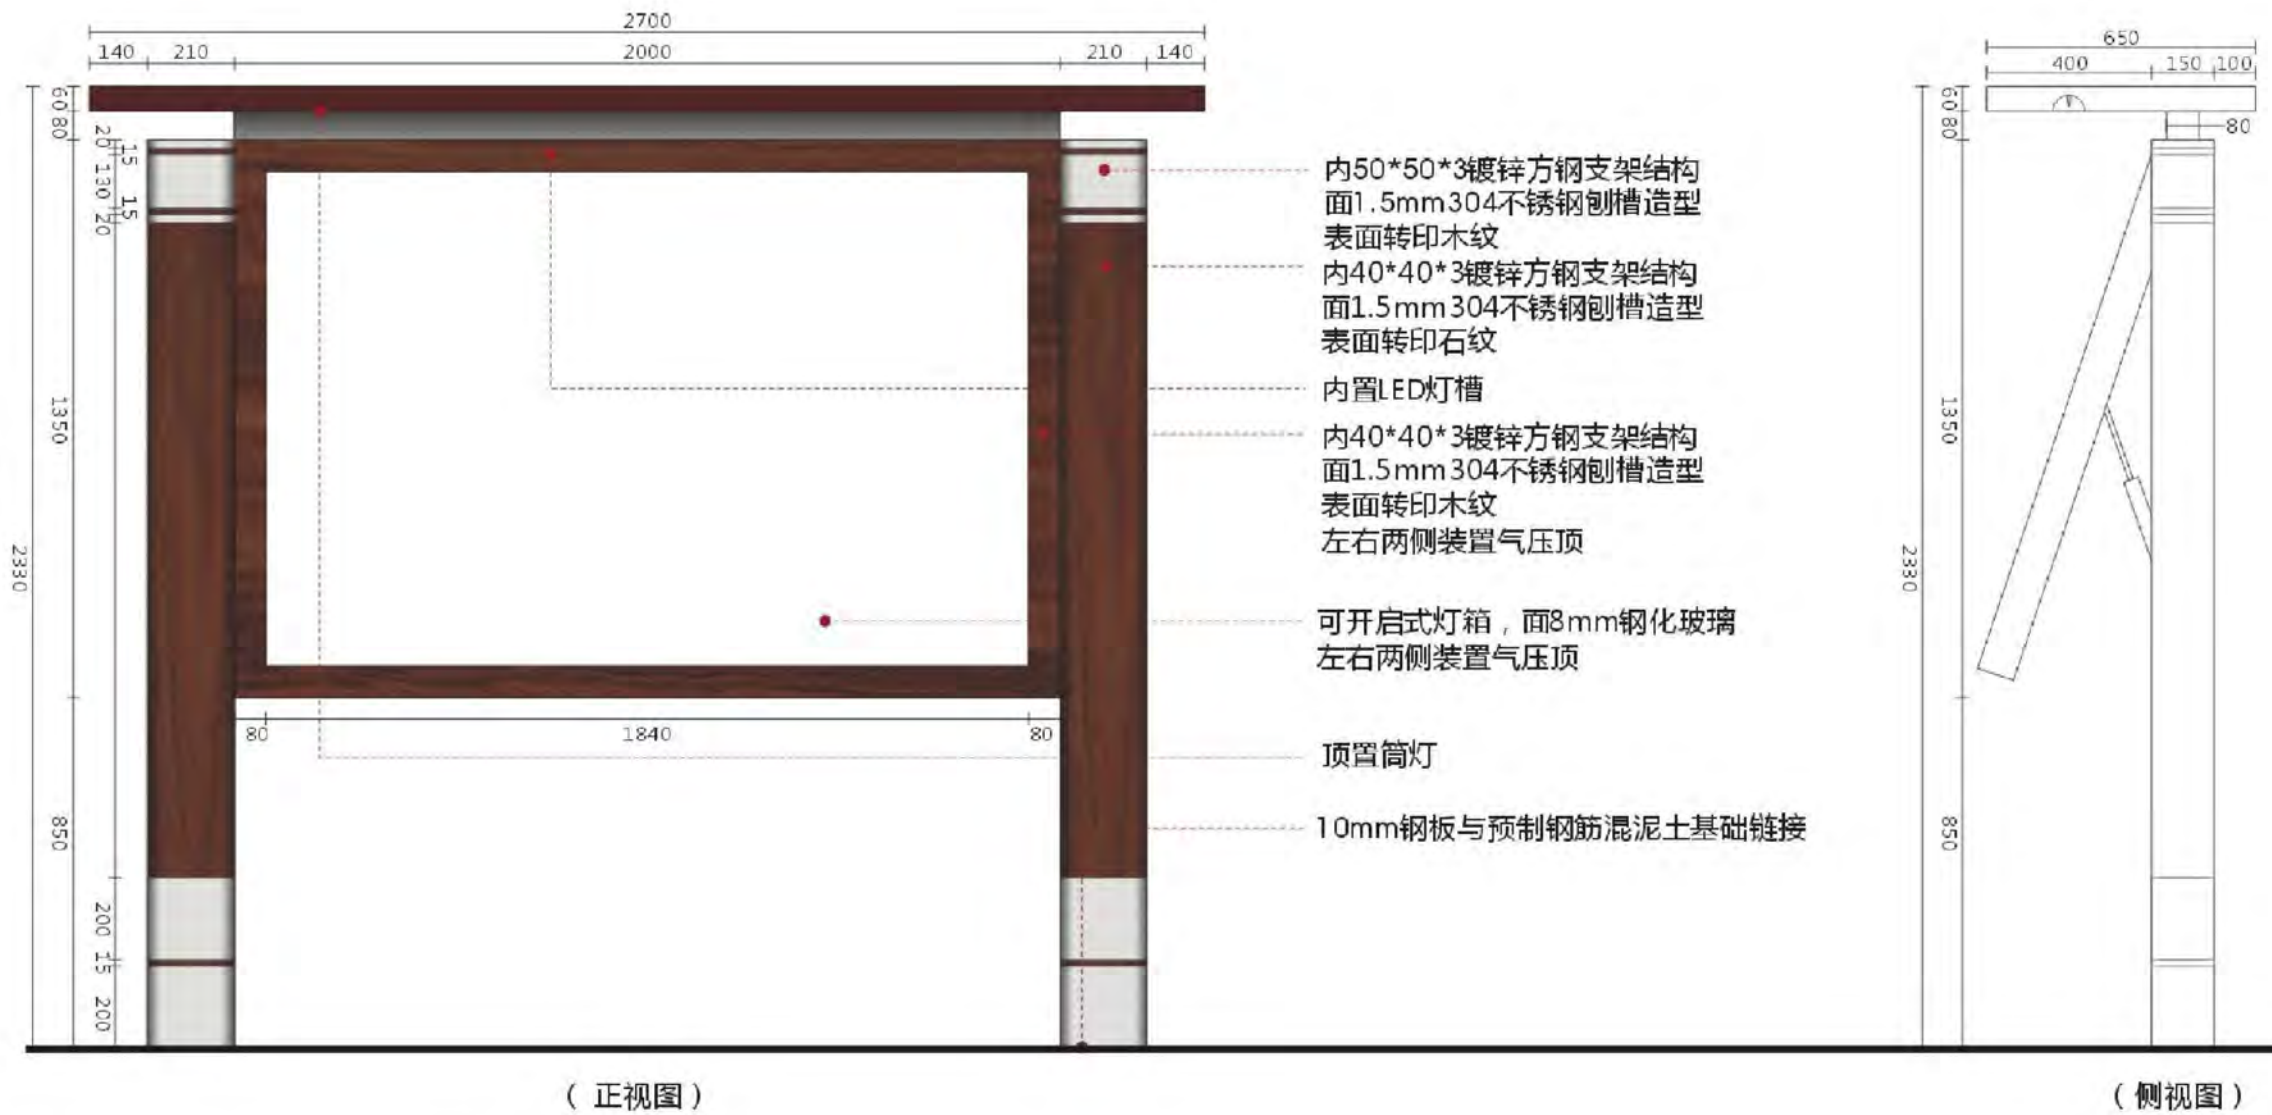

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核

主管科室审核


主管处室审核

分管院长审核

完工日期



名称：户外导向指引  
尺寸：2000\*450\*250mm  
材质工艺：如图  
安装：嵌入式安装

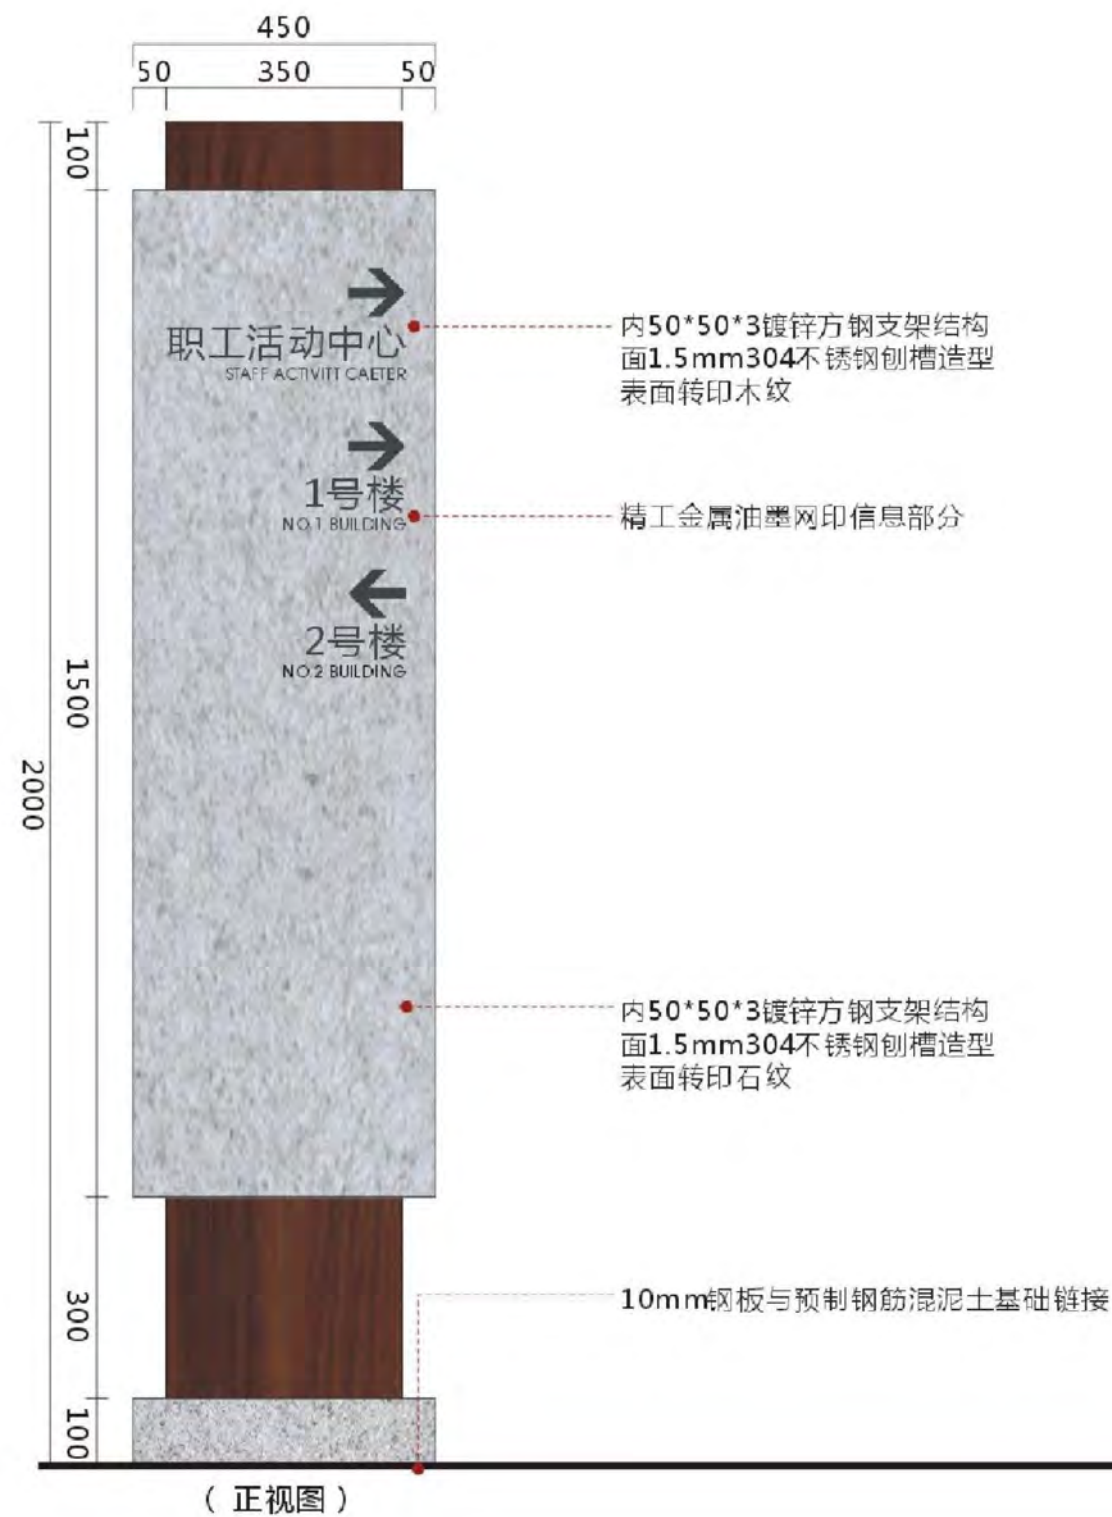

铝板表面真石漆



铝板木纹热转印



精工油墨网印信息

单位:mm

出图日期

设计

使用科室审核


主管科室审核

主管处室审核

分管院长审核

完工日期

名称：户外导向指引  
尺寸：1530\*3000mm  
材质工艺：如图  
安装：嵌入式安装

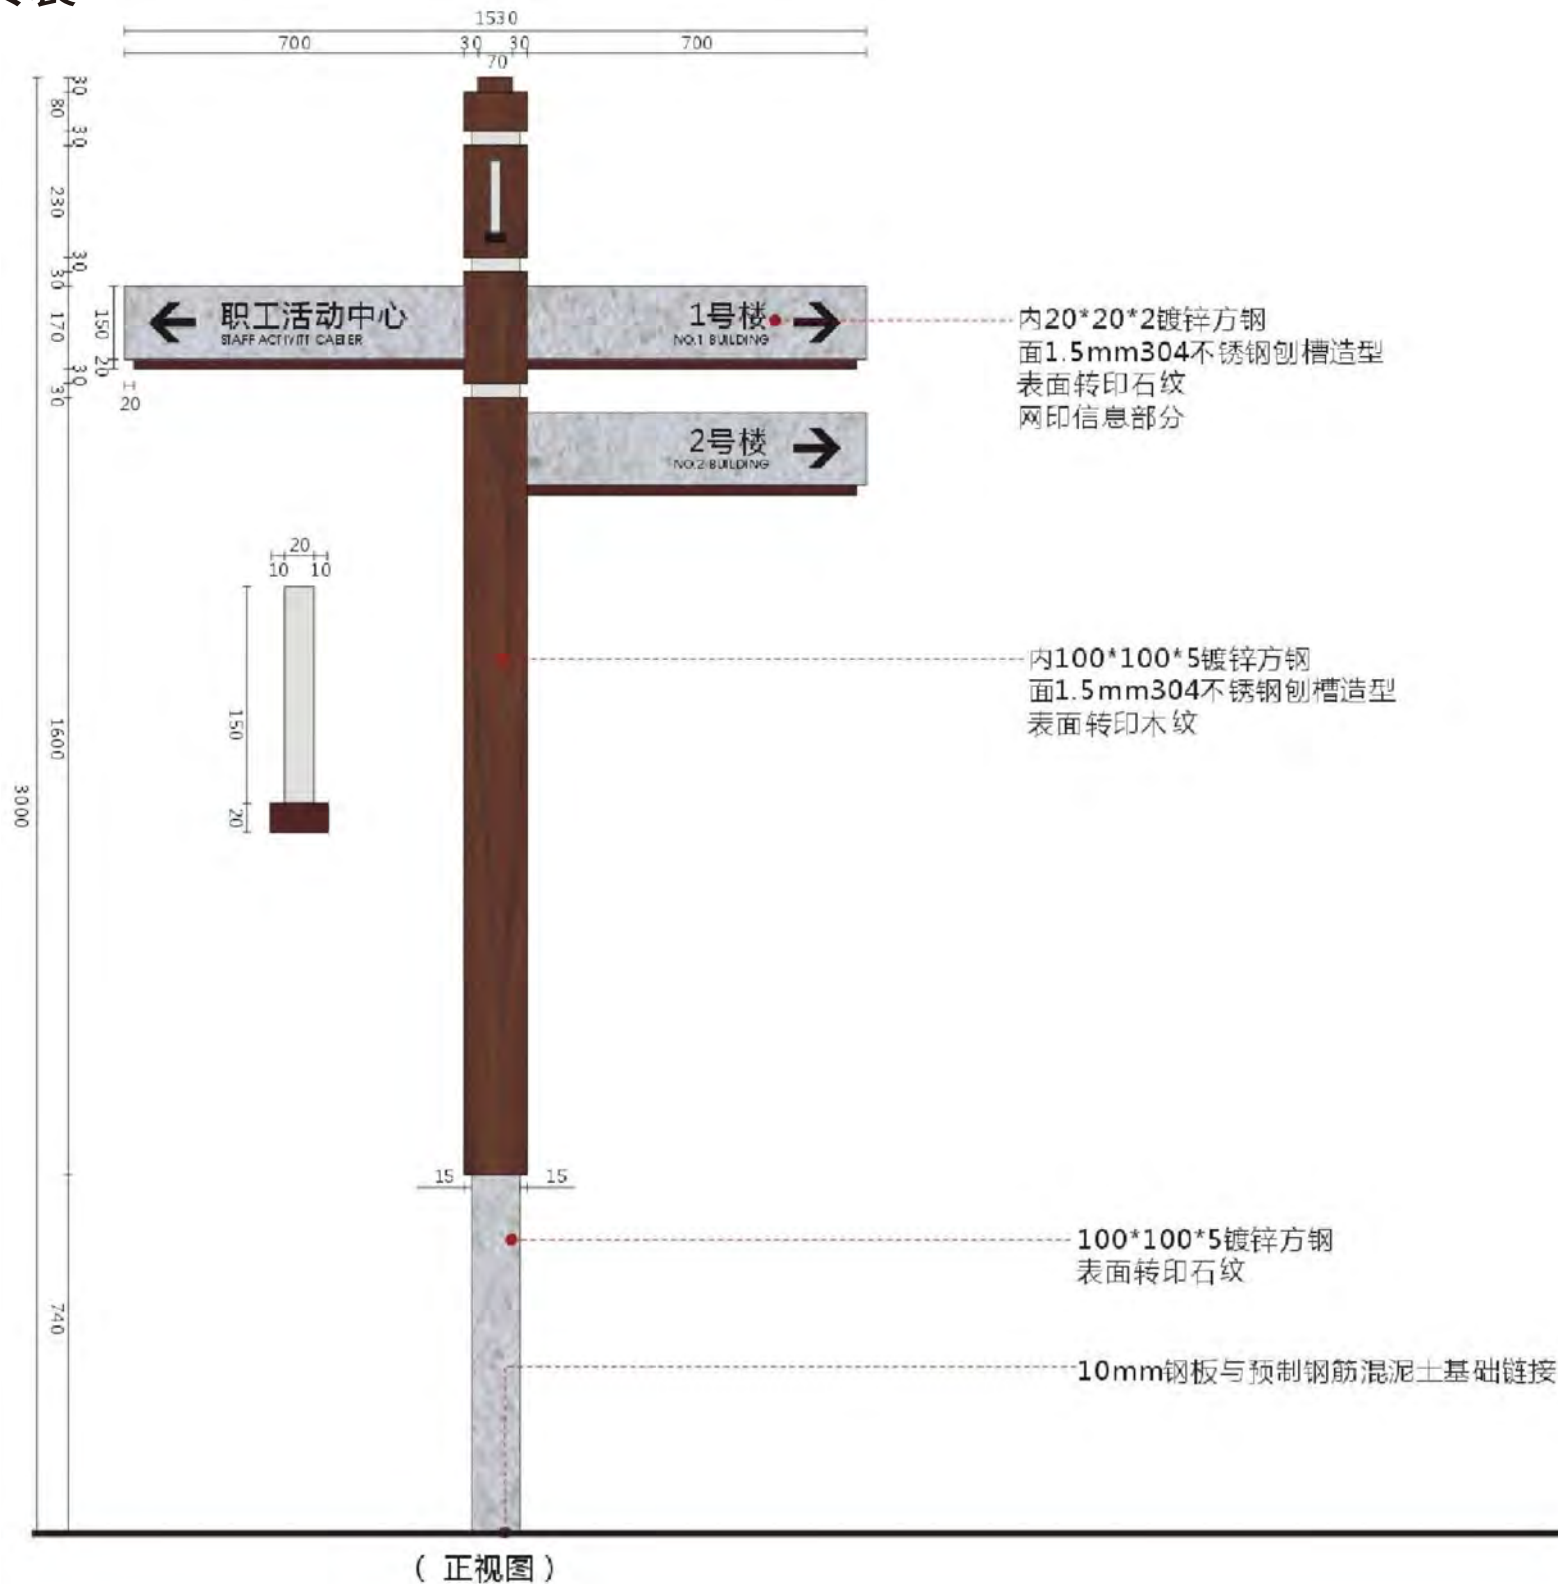

铝板表面真石漆



铝板木纹热转印



精工油墨网印信息

名称：花草文化牌  
尺寸：400\*600\*80mm  
材质工艺：如图  
安装：嵌入式安装



| 标识设计·方案 |              |
|---------|--------------|
| 制作单号    | D9           |
| 项目名称    | 中大附属肿瘤医院     |
| 图纸名称    | 花草文化牌        |
| 工序负责    | 结构设计         |
| 外 加 工   |              |
| 五 金     |              |
| 喷 漆     |              |
| 标 识 A   | (有机类、型材、铝塑板) |
| 丝 印     |              |
| 标 识 B   | (粘贴、打磨、包装)   |
| 光 电 源   |              |
| 合同项目    |              |
| 产品单价    |              |
| 产品数量    |              |
| 产品总价    |              |

|       |      |     |        |        |        |        |      |
|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|------|
| 单位:mm | 出图日期 | 设 计 | 使用科室审核 | 主管科室审核 | 主管处室审核 | 分管院长审核 | 完工日期 |
|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|------|