


医院新医疗器械购置/使用之前
医院再处理风险评估与放行

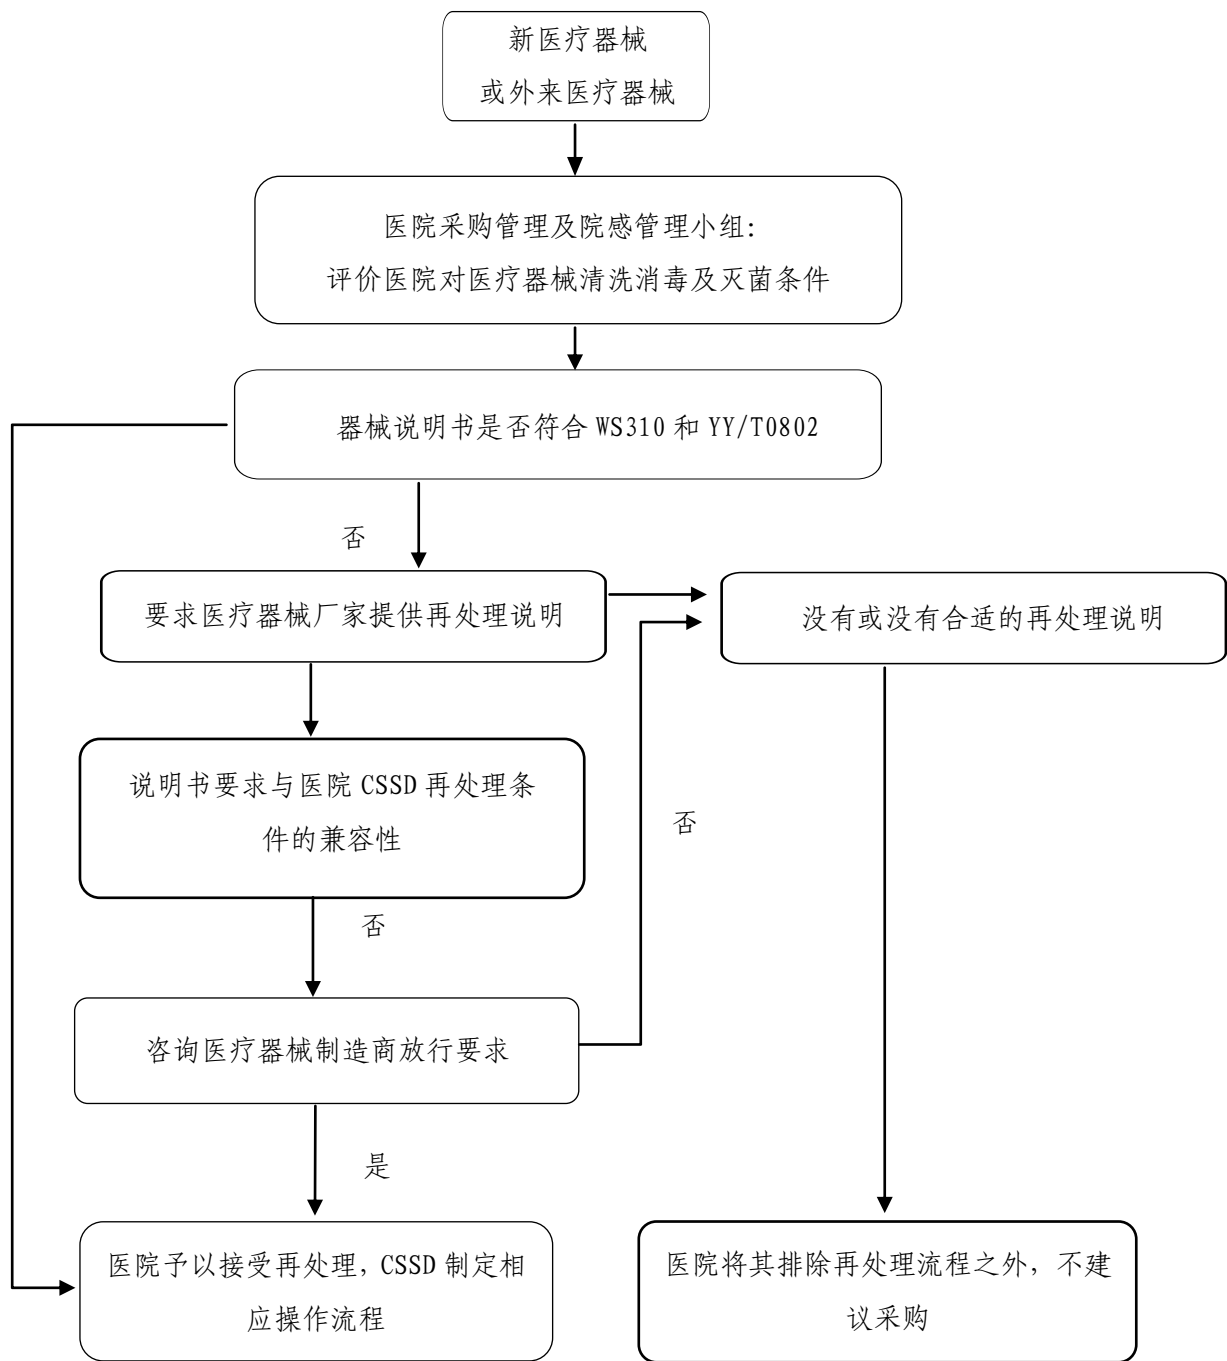

备注：

- 1. YY/T 0802 医疗器械的灭菌 制造商提供的处理可重复灭菌医疗器械的信息。
- 2. WS310.1 医院消毒供应中心 第一部分 管理规范。
- 3. WS310.2 医院消毒供应中心 第二部分 清洗消毒及灭菌技术操作规范。
- 4. WS310.3 医院消毒供应中心 第三部分 清洗消毒及灭菌效果监测标准。